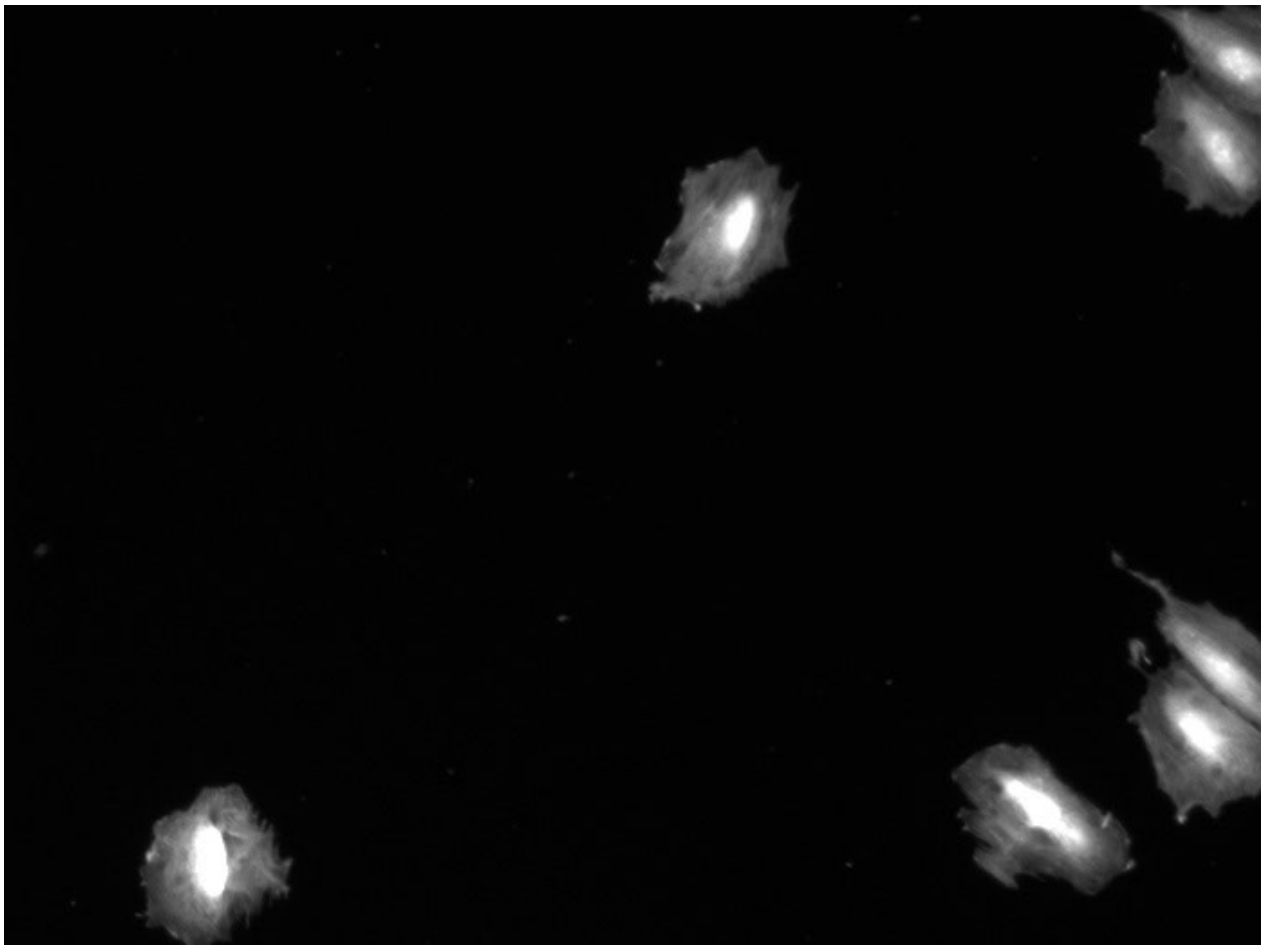

IWFCE_A10MedOptWell3_0001.png

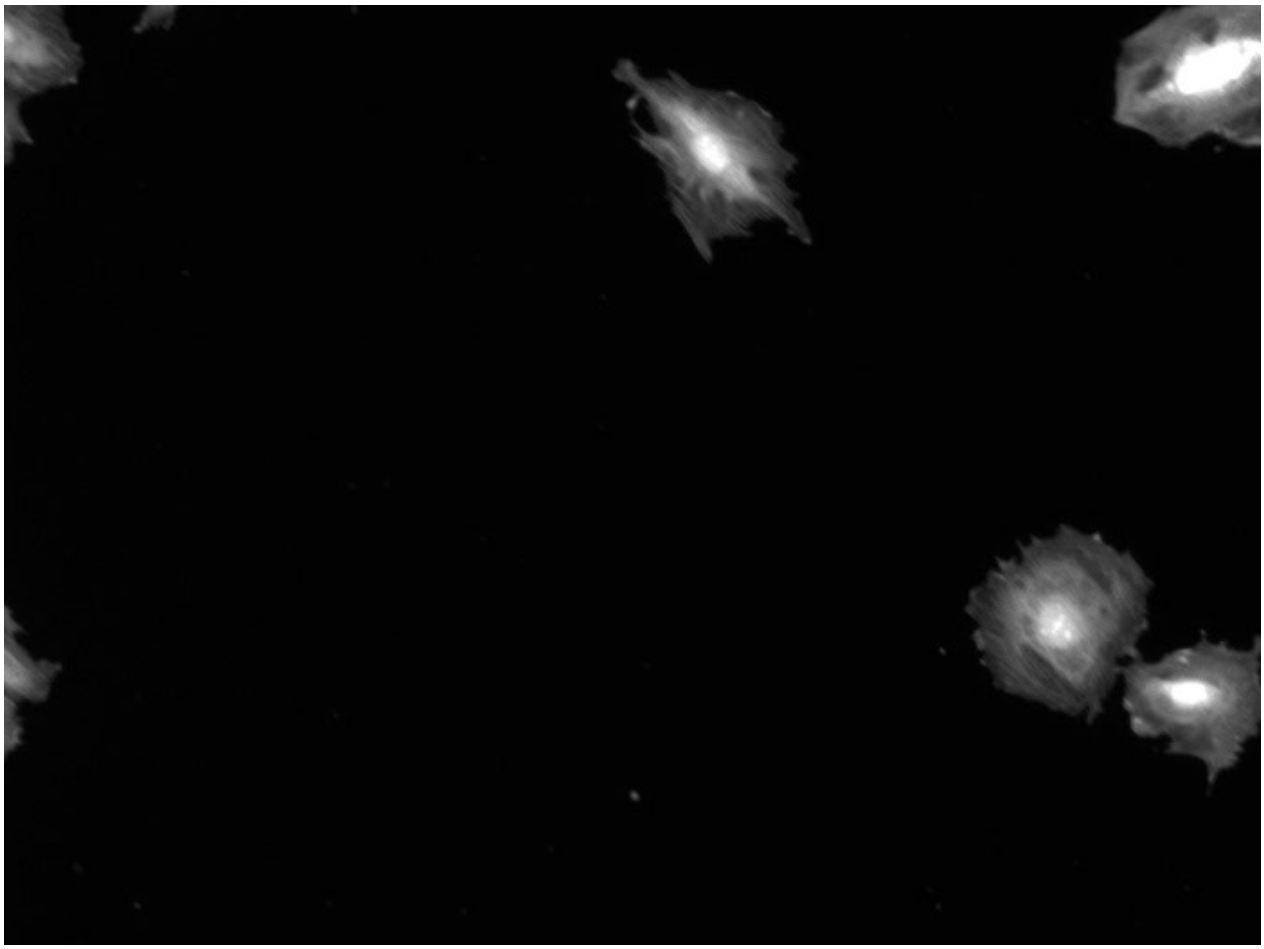

IWFCE_A10MedOptWell3_0002.png

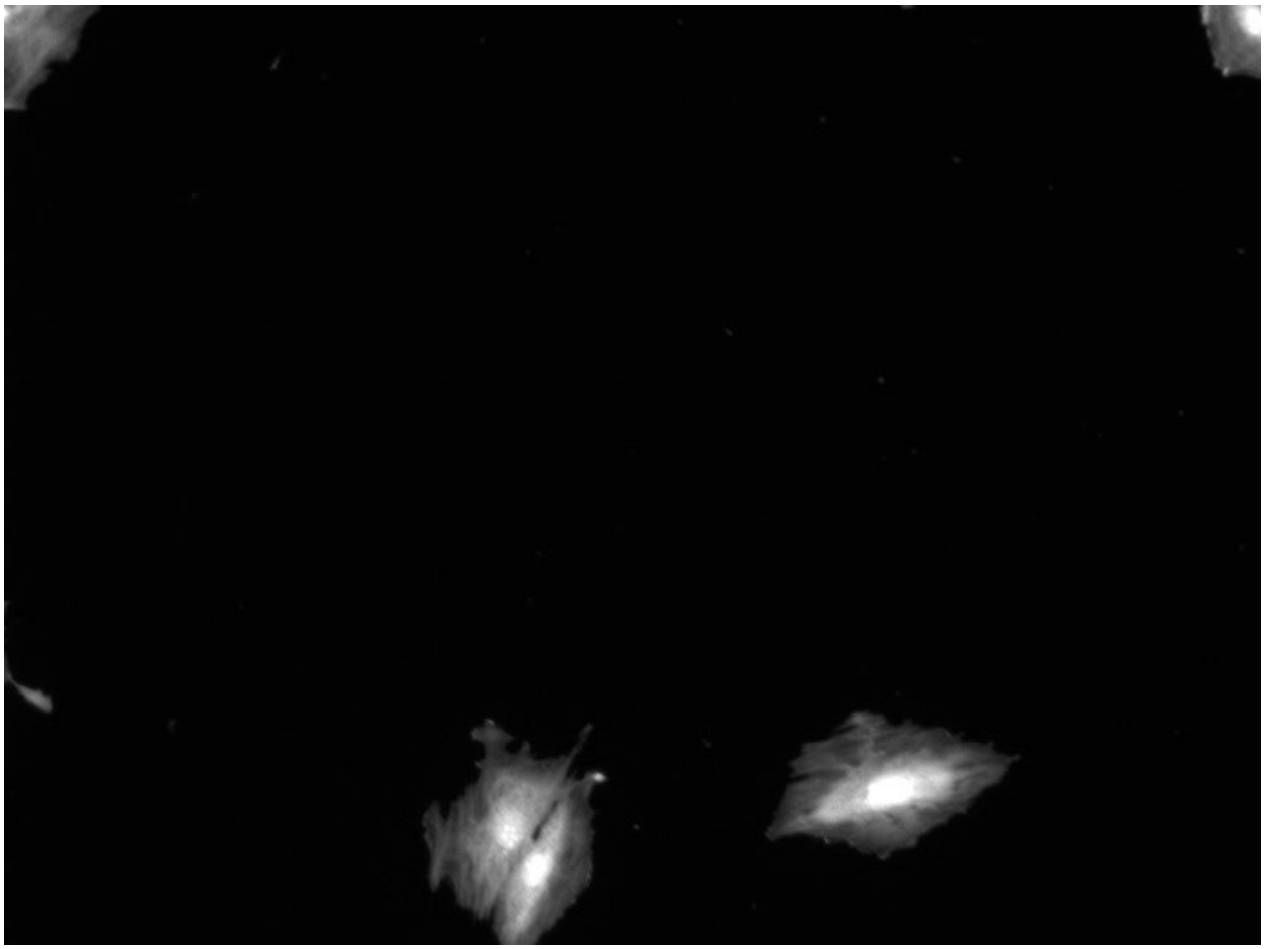

IWFCE_A10MedOptWell3_0003.png

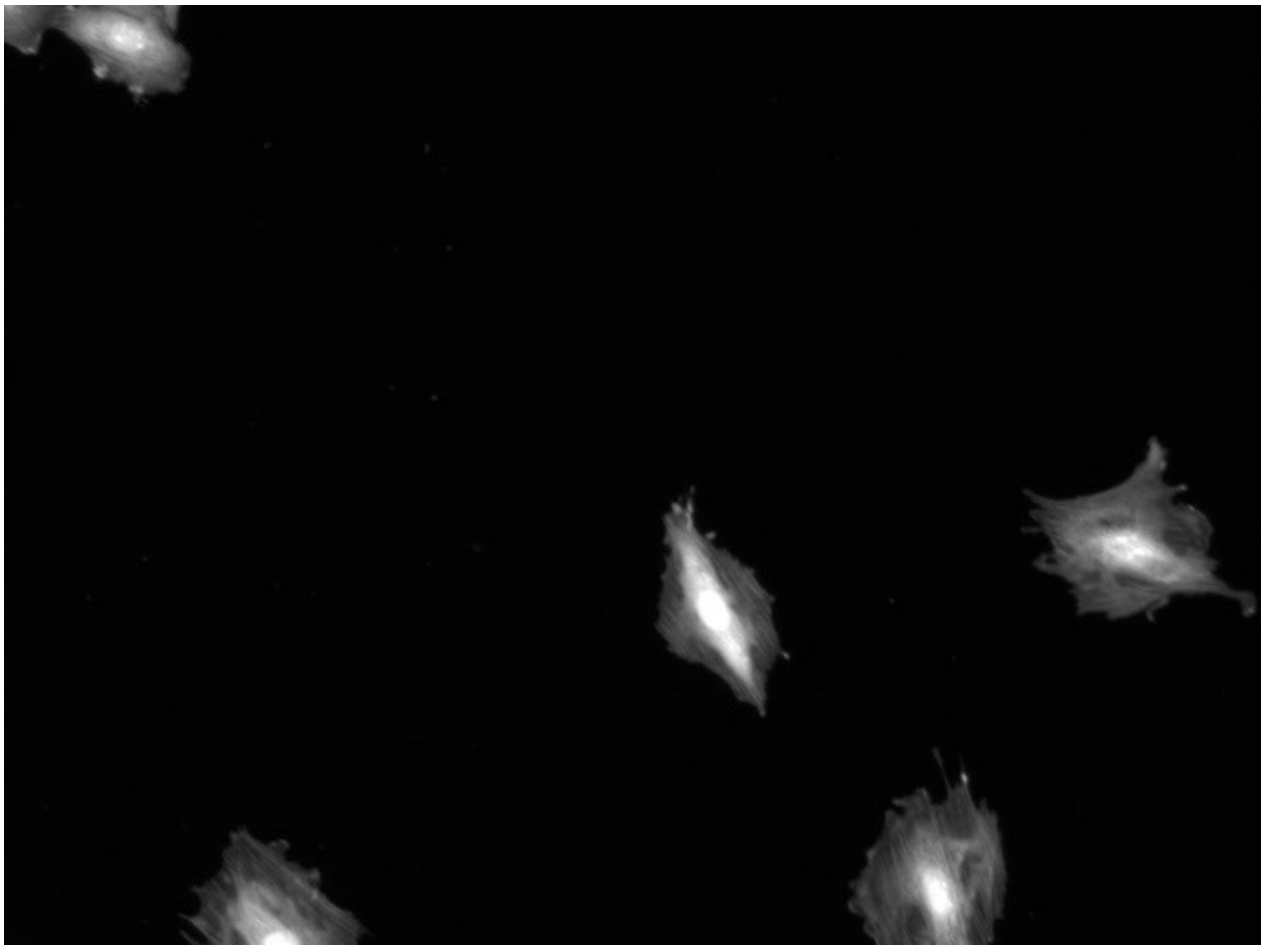

IWFCE_A10MedOptWell3_0004.png

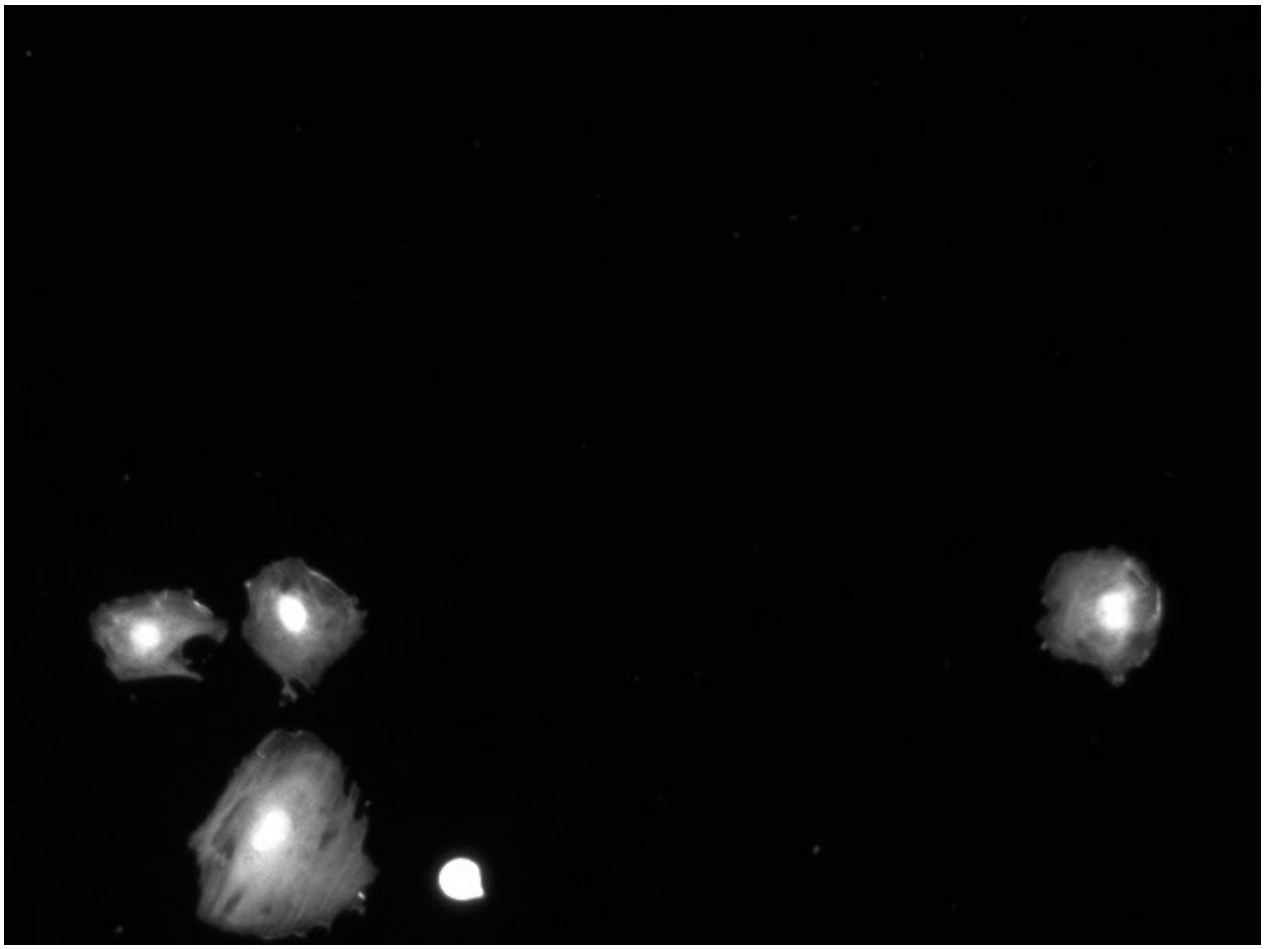

IWFCE_A10MedOptWell3_0005.png

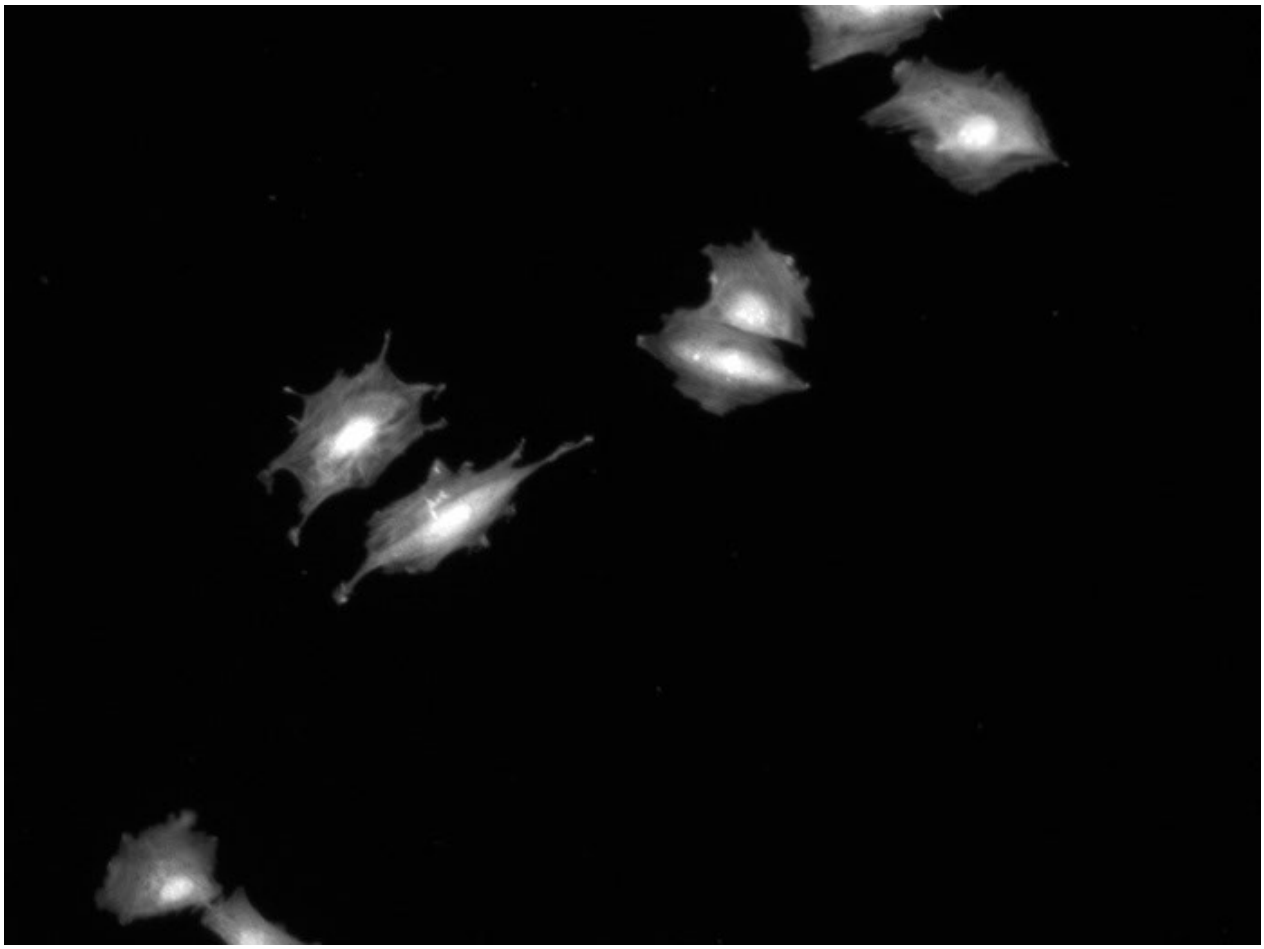

IWFCE_A10MedOptWell3_0006.png

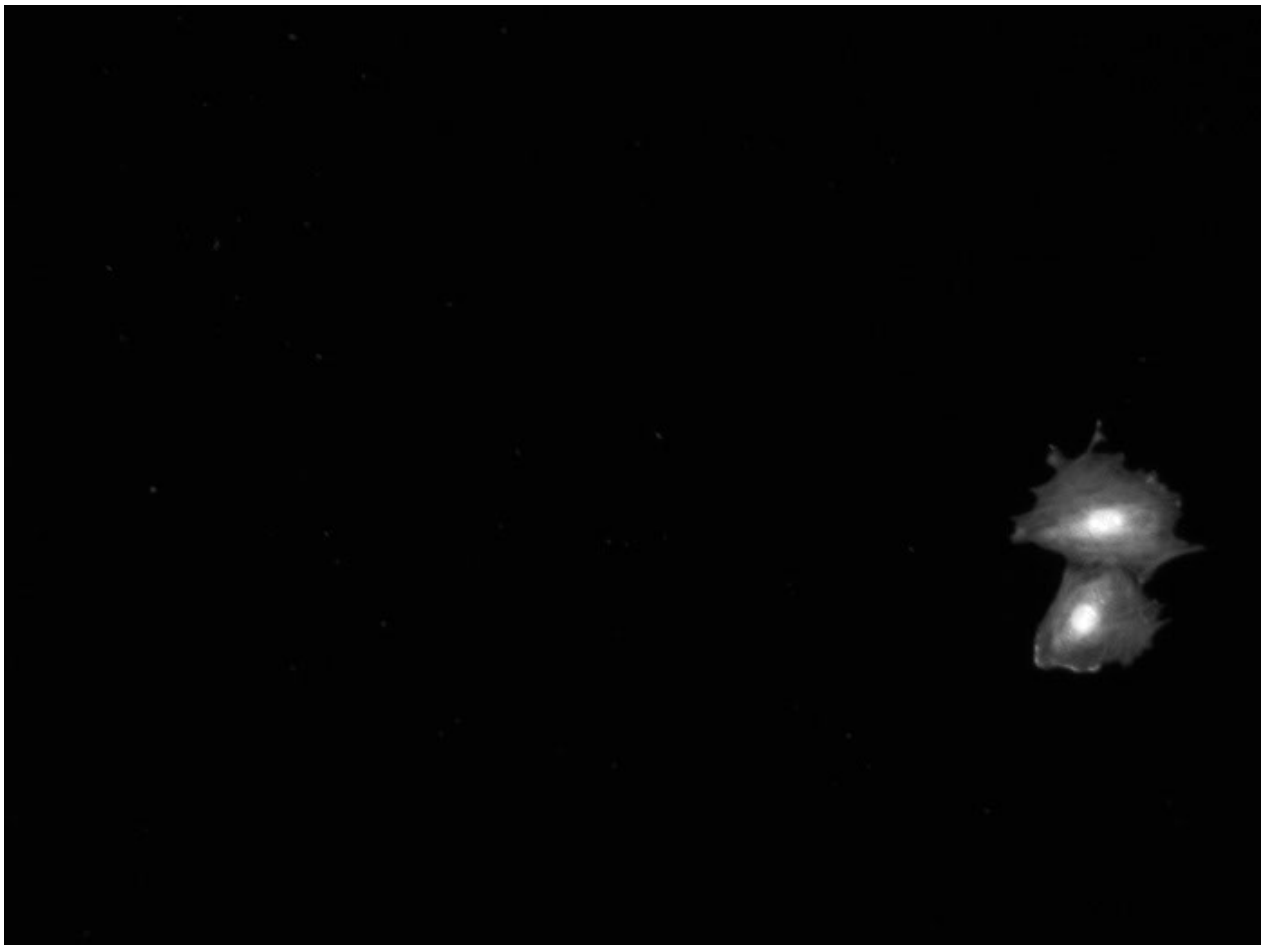

IWFCE_A10MedOptWell3_0007.png

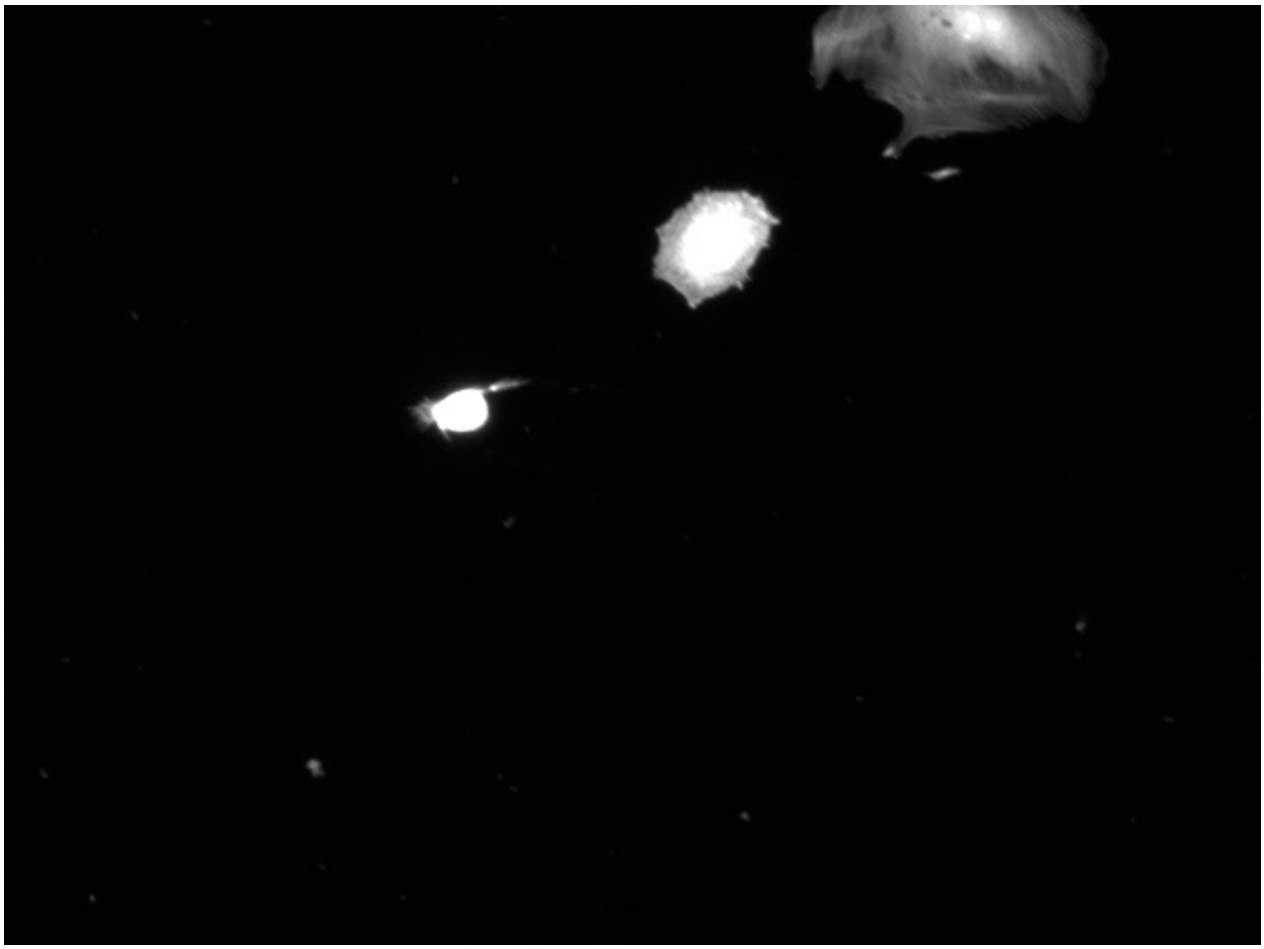

IWFCE_A10MedOptWell3_0008.png

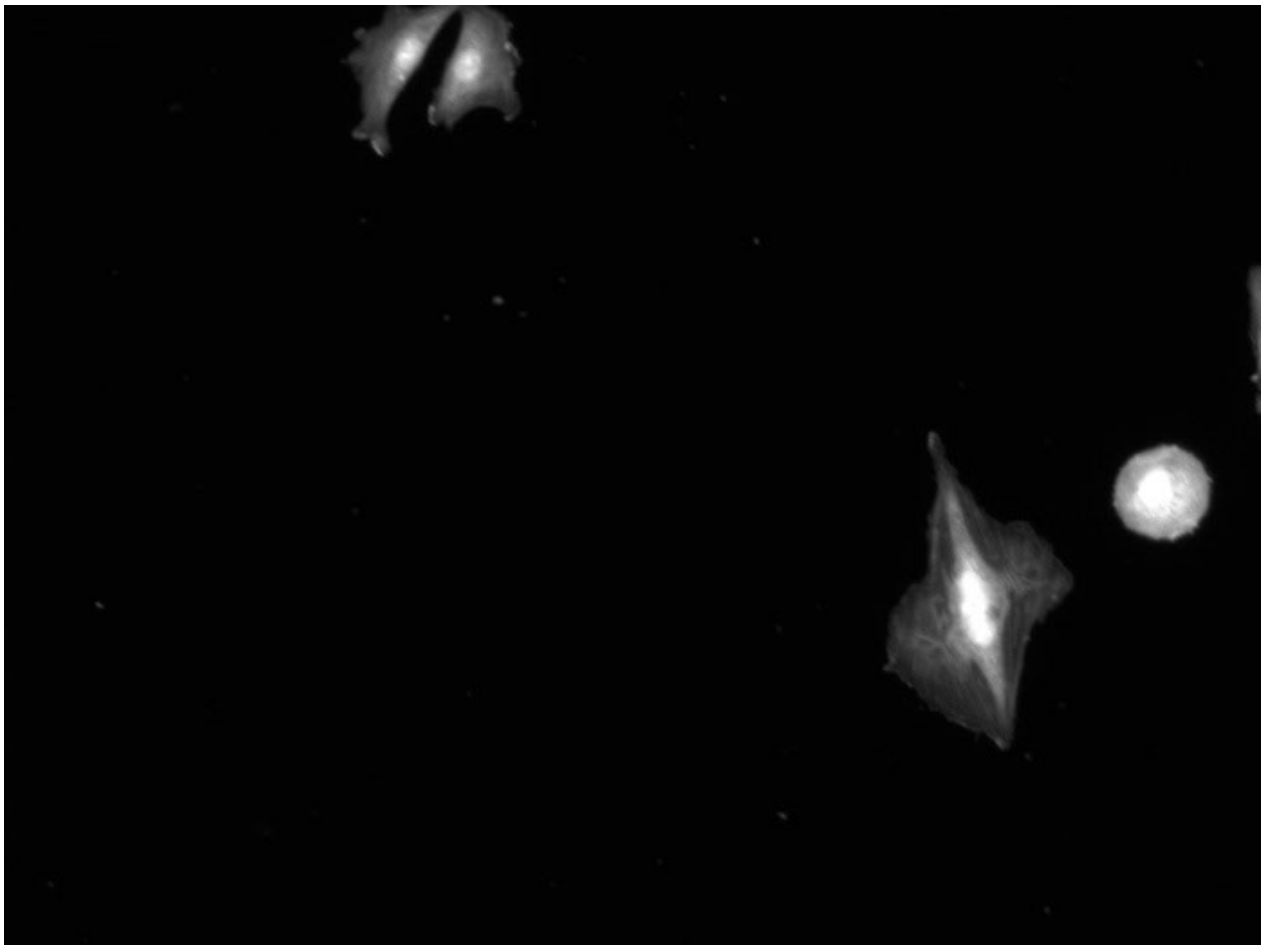

IWFCE_A10MedOptWell3_0009.png

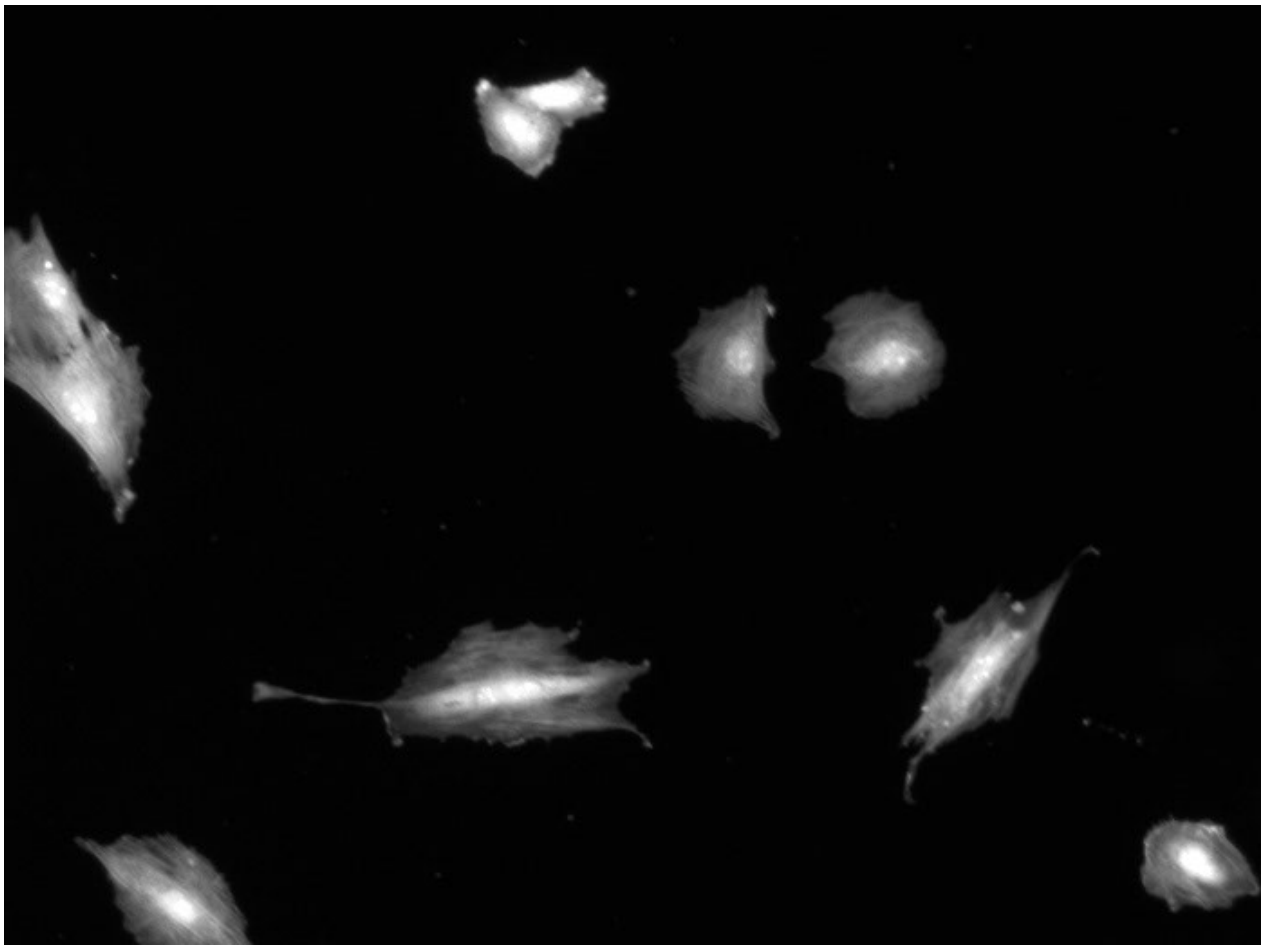

IWFCE_A10MedOptWell3_0010.png

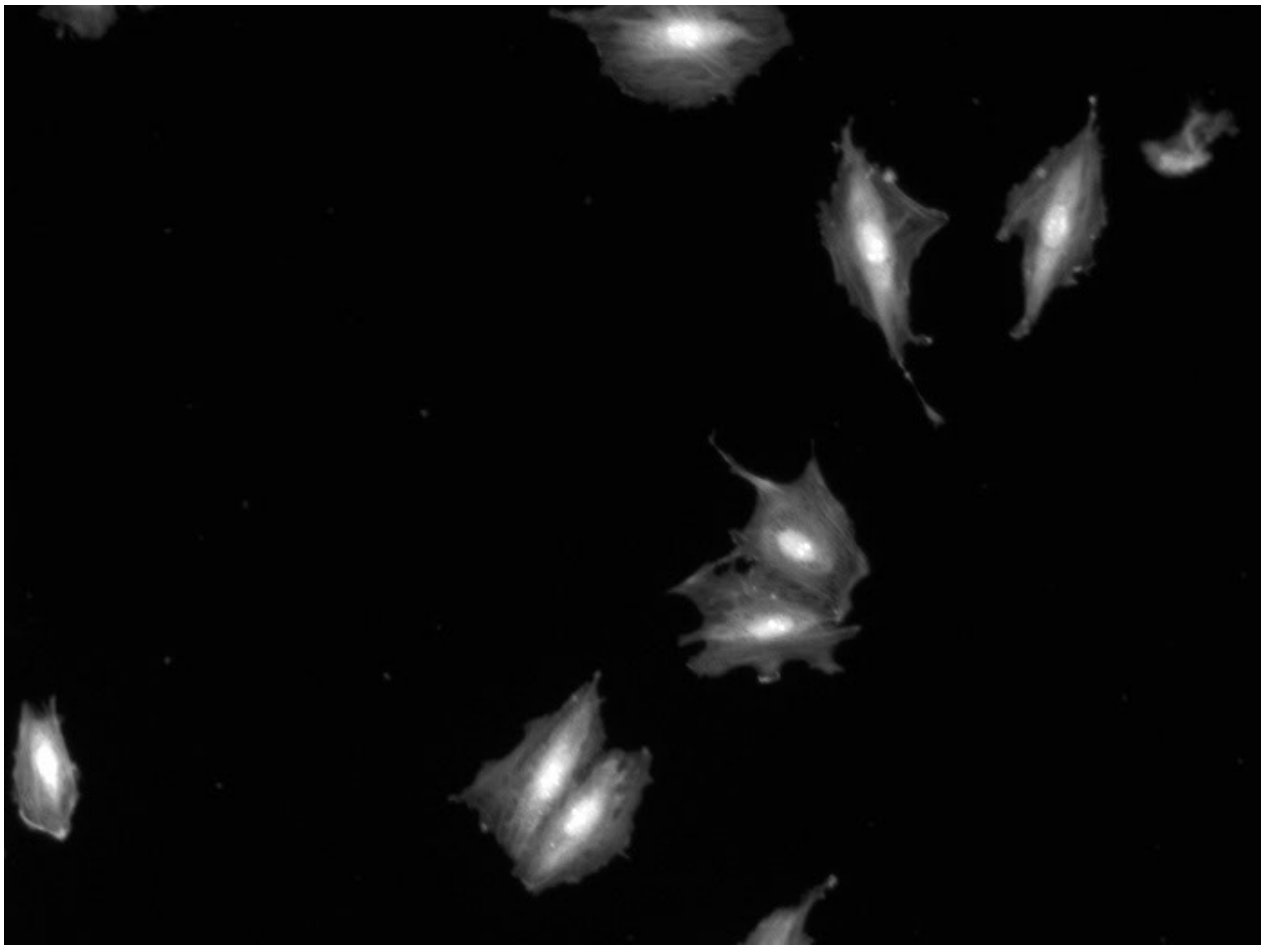

IWFCE_A10MedOptWell3_0011.png

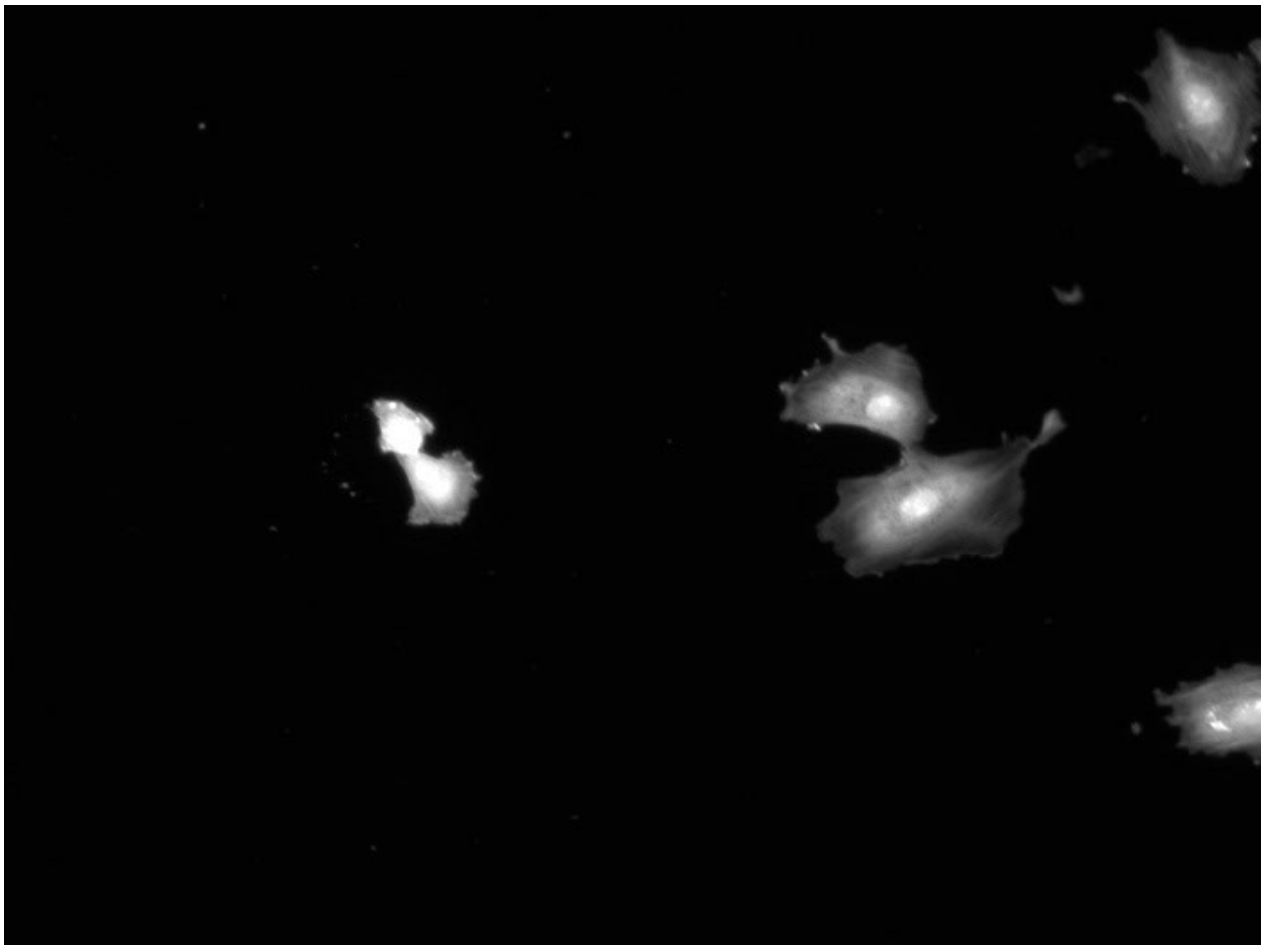

IWFCE_A10MedOptWell3_0012.png

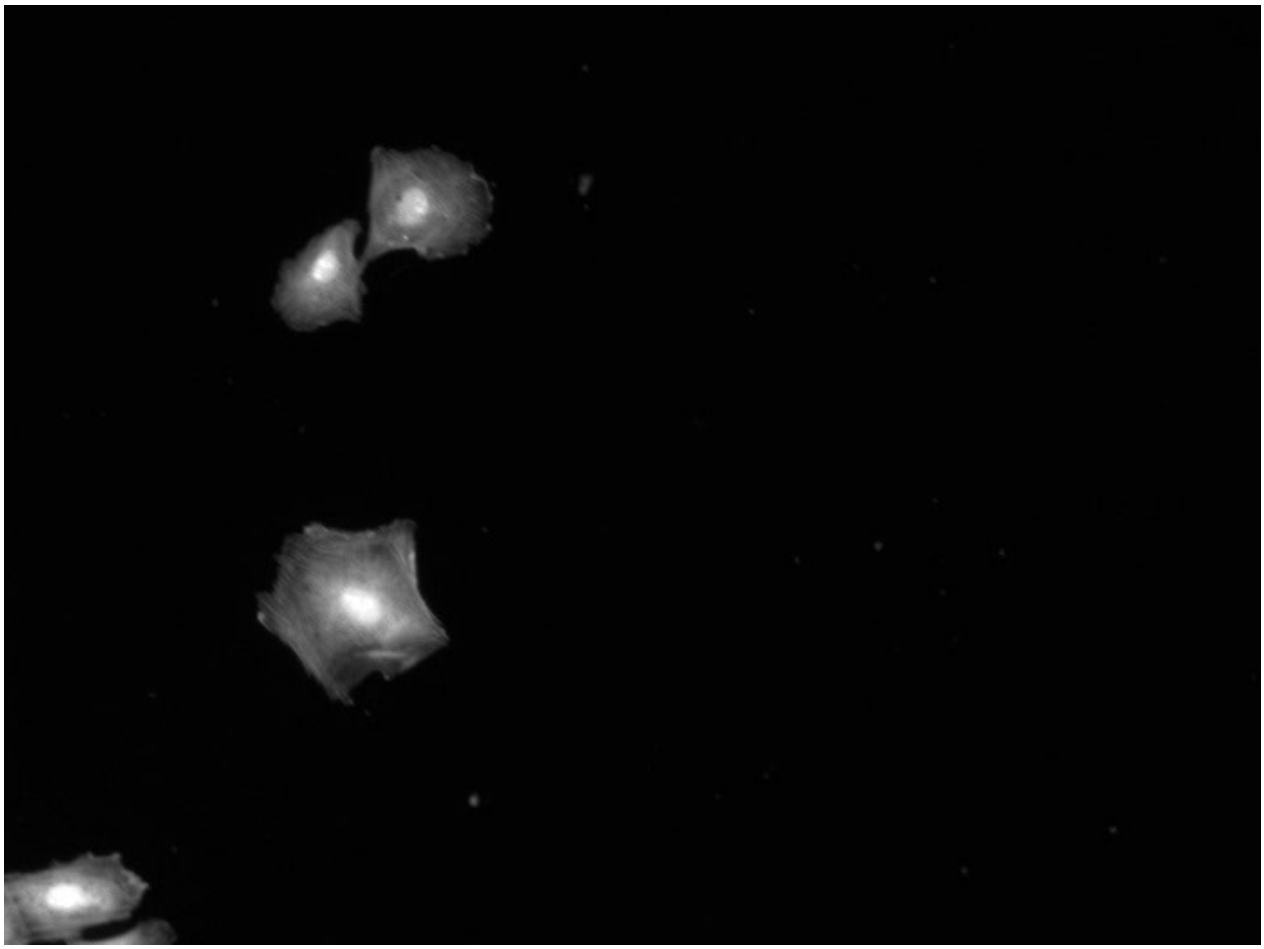

IWFCE_A10MedOptWell3_0013.png

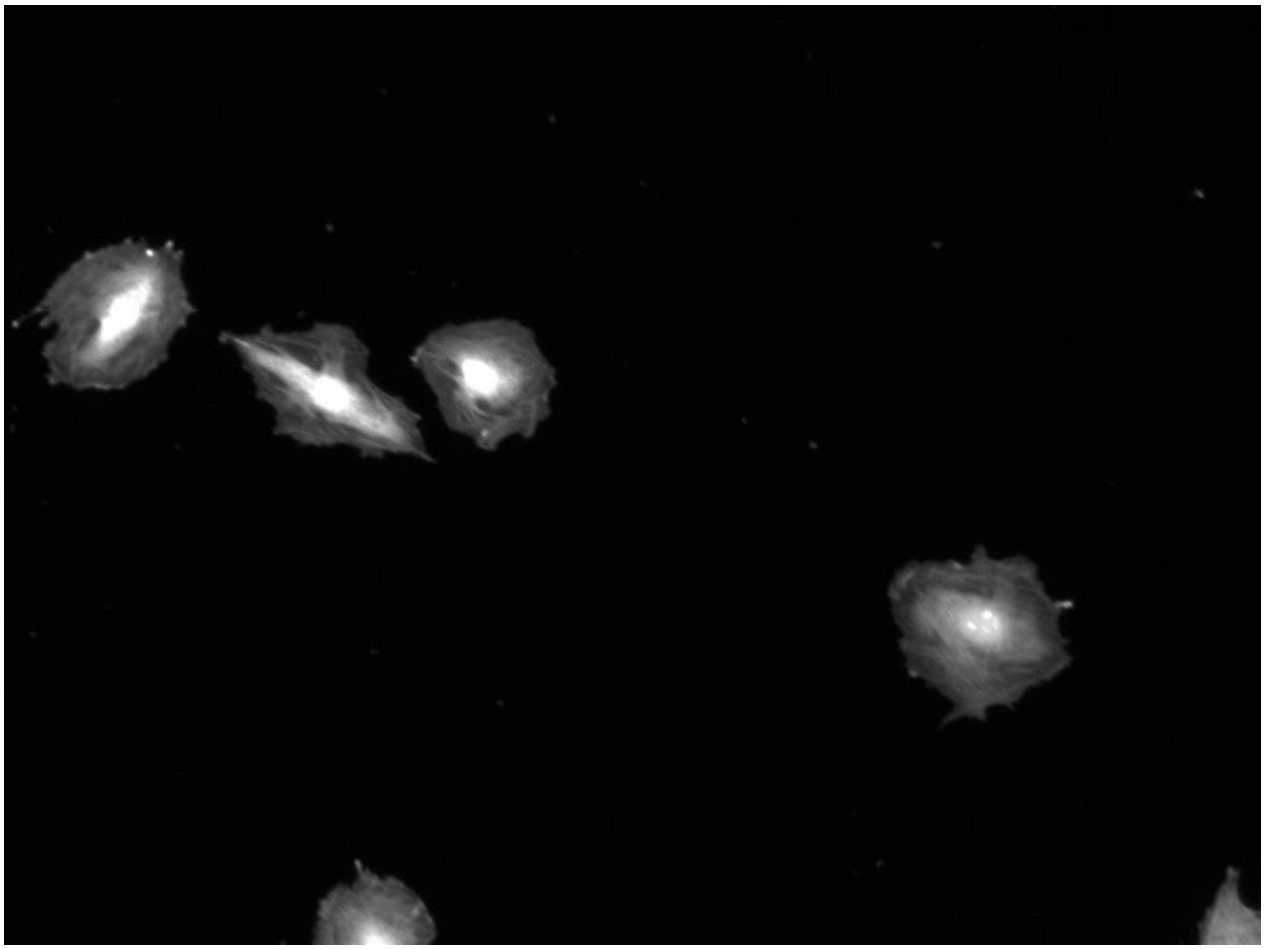

IWFCE_A10MedOptWell3_0014.png

IWFCE_A10MedOptWell3_0015.png

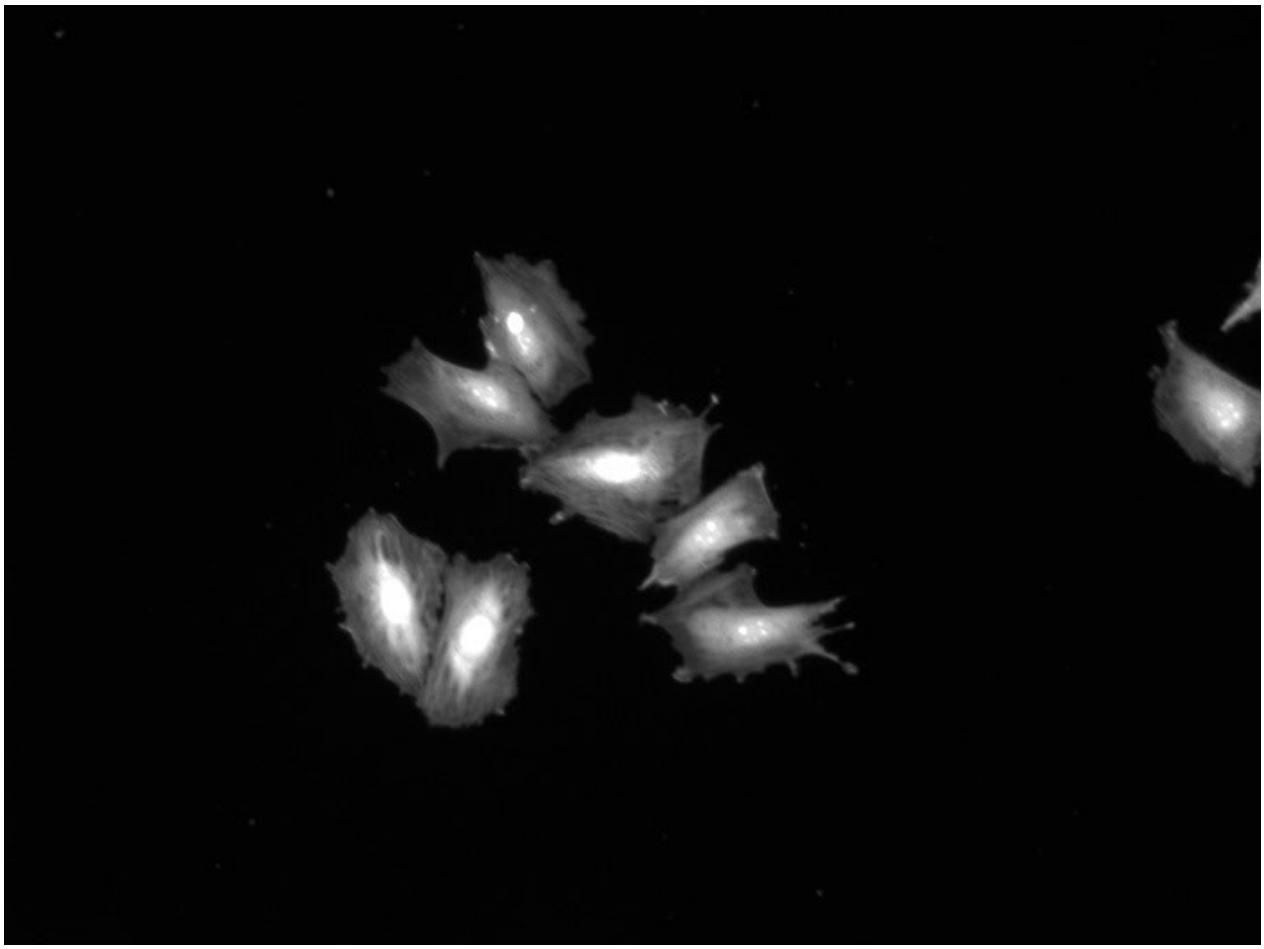

IWFCE_A10MedOptWell3_0016.png

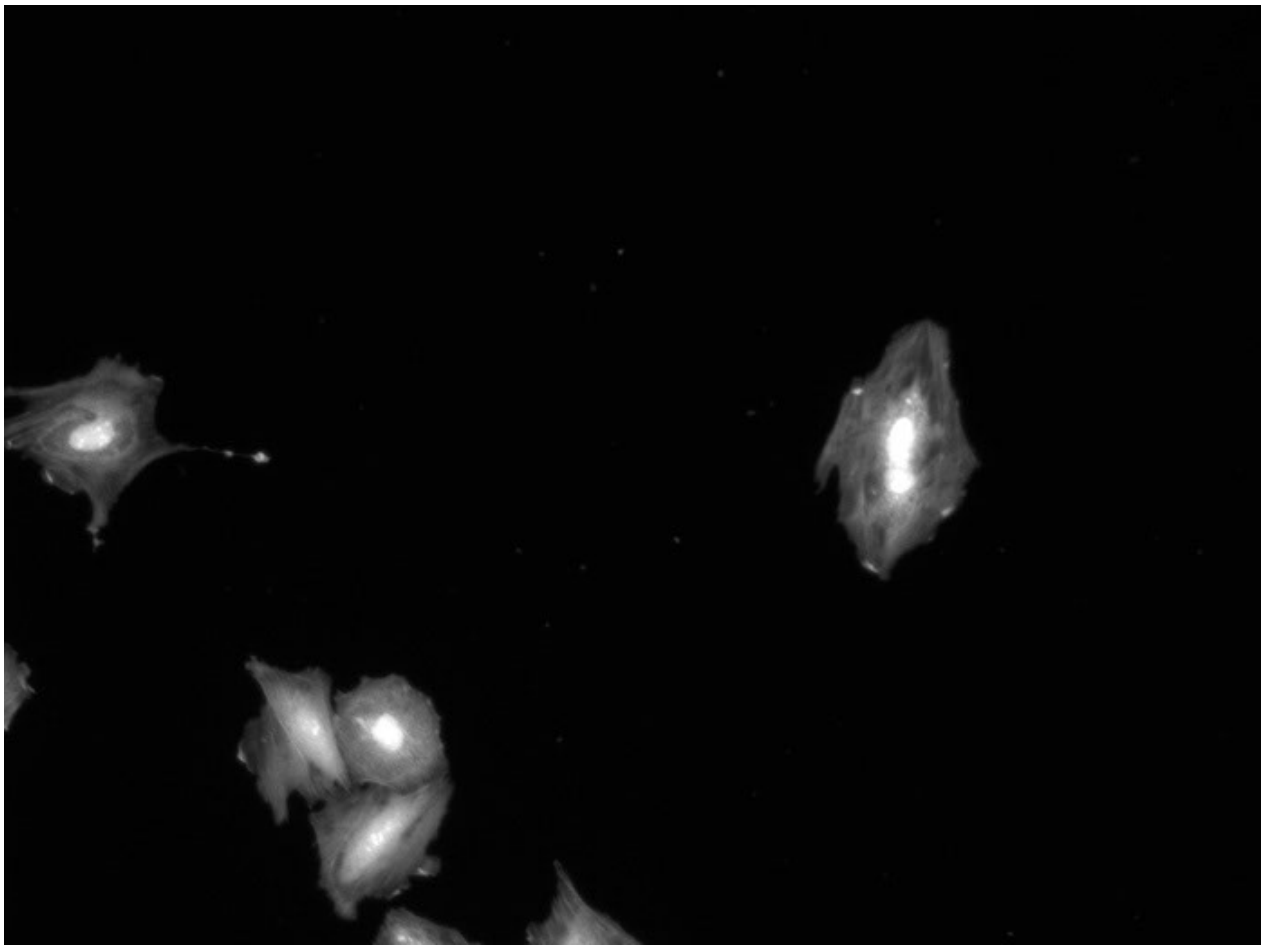

IWFCE_A10MedOptWell3_0017.png

IWFCE_A10MedOptWell3_0018.png

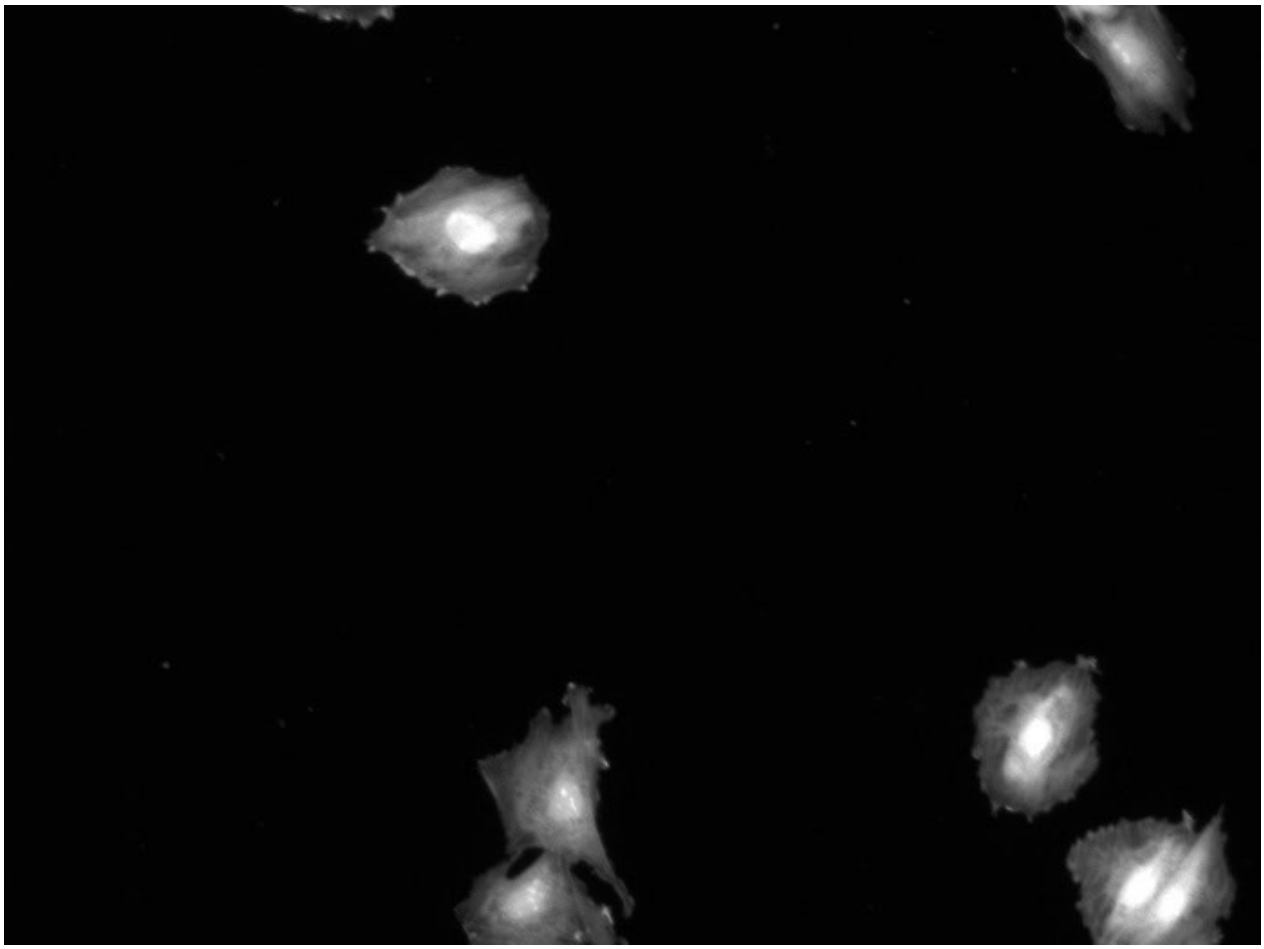

IWFCE_A10MedOptWell3_0019.png

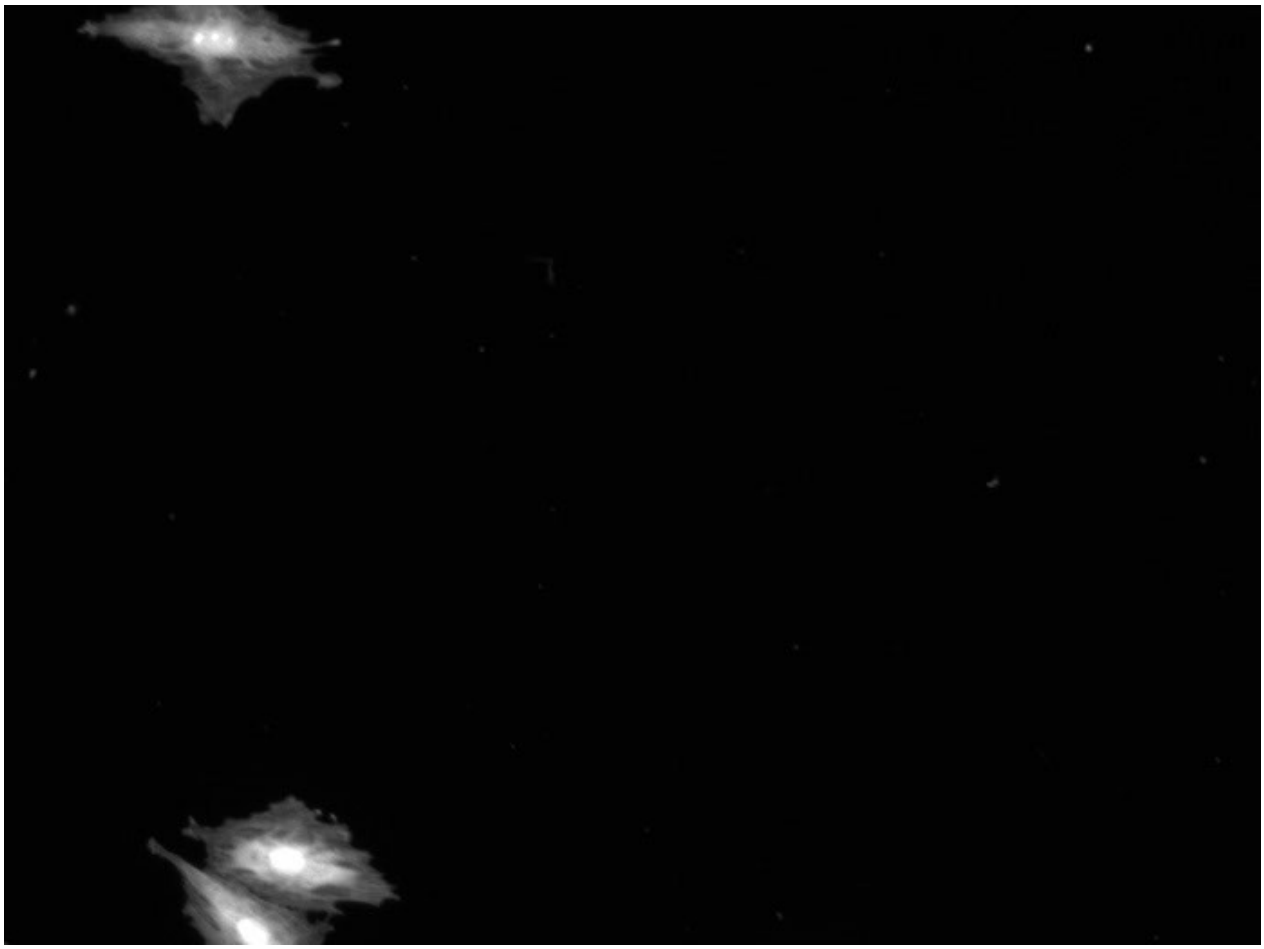

IWFCE_A10MedOptWell3_0020.png

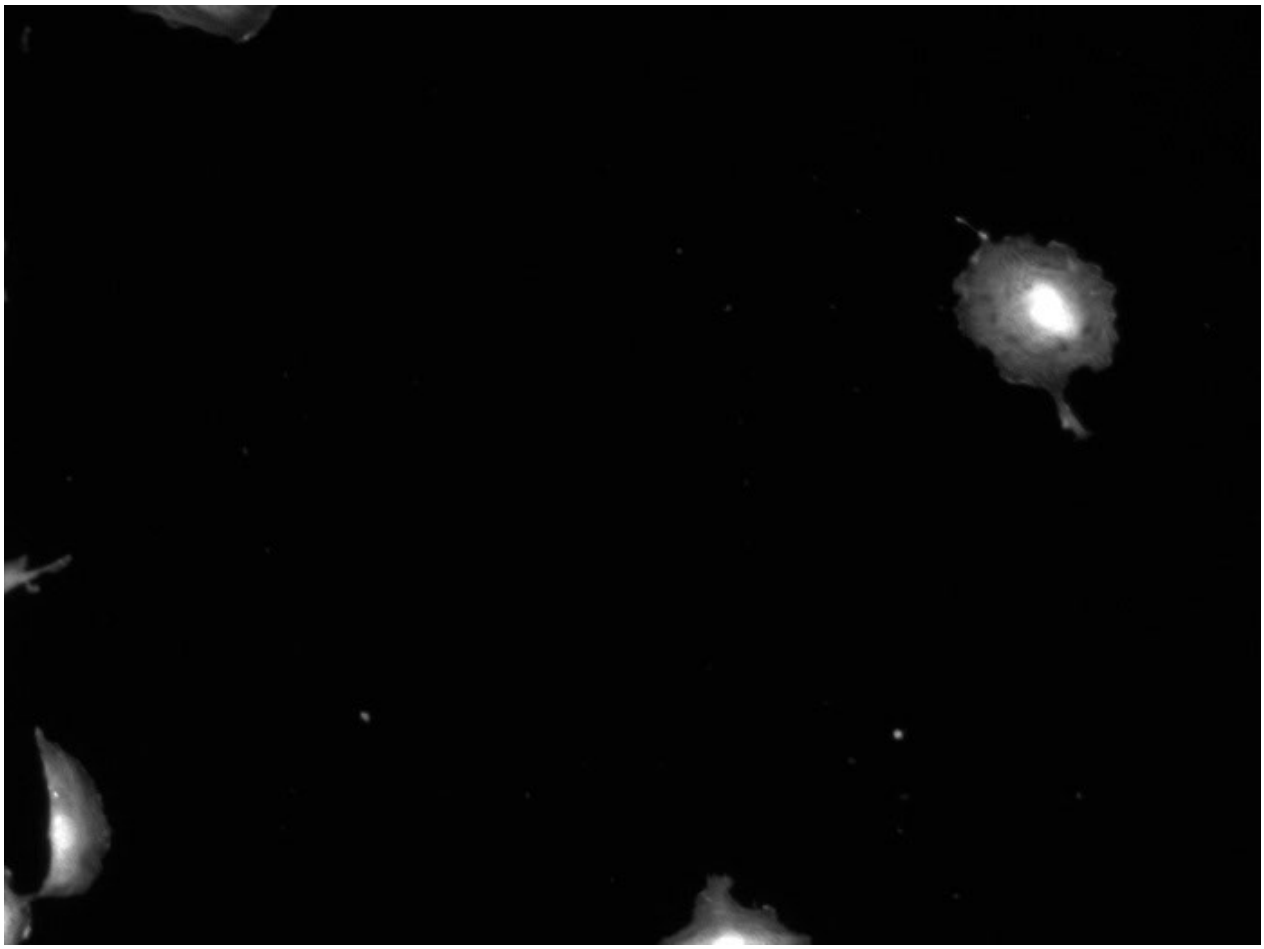

IWFCE_A10MedOptWell3_0021.png

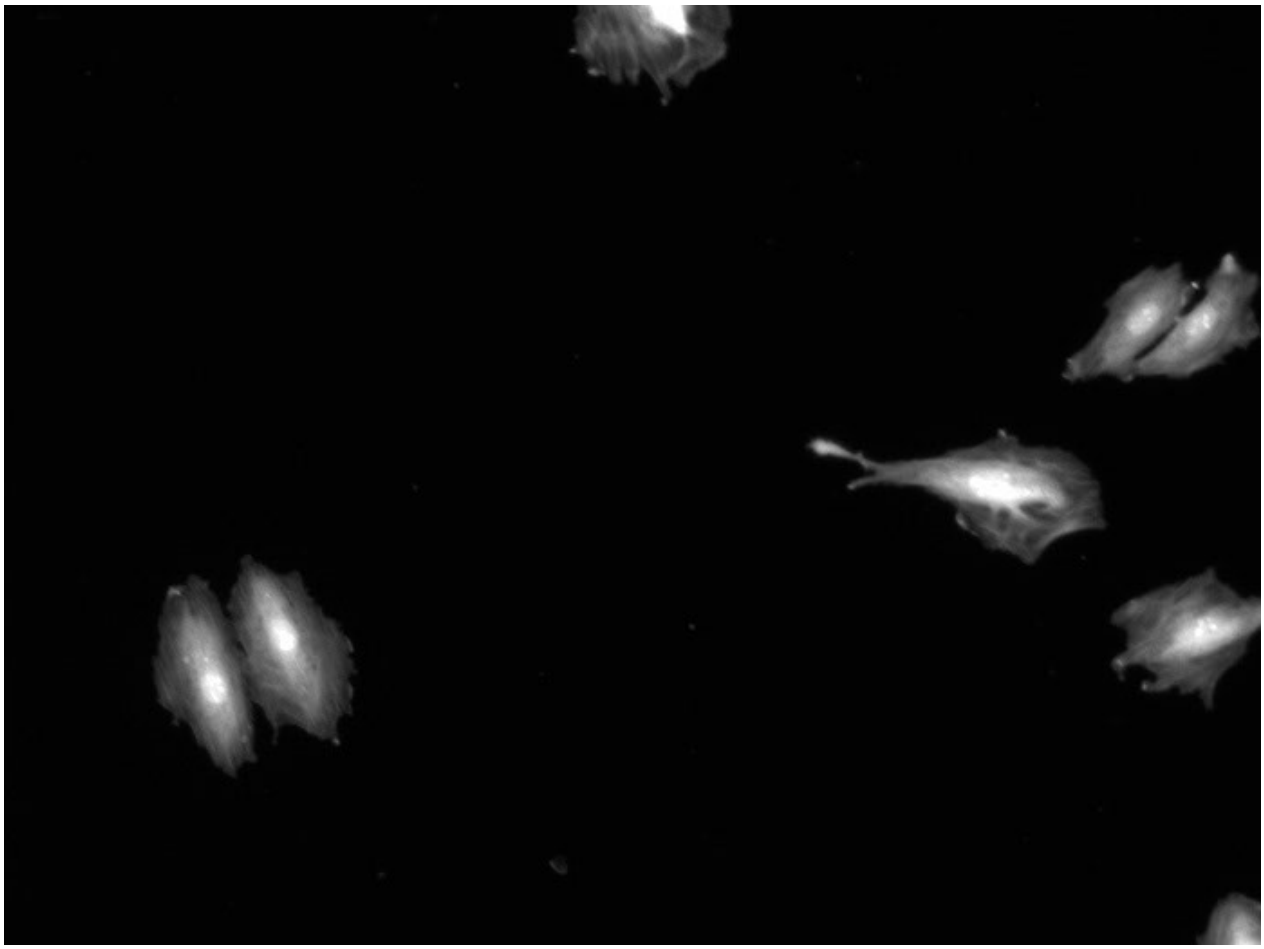

IWFCE_A10MedOptWell3_0022.png

IWFCE_A10MedOptWell3_0023.png

IWFCE_A10MedOptWell3_0024.png

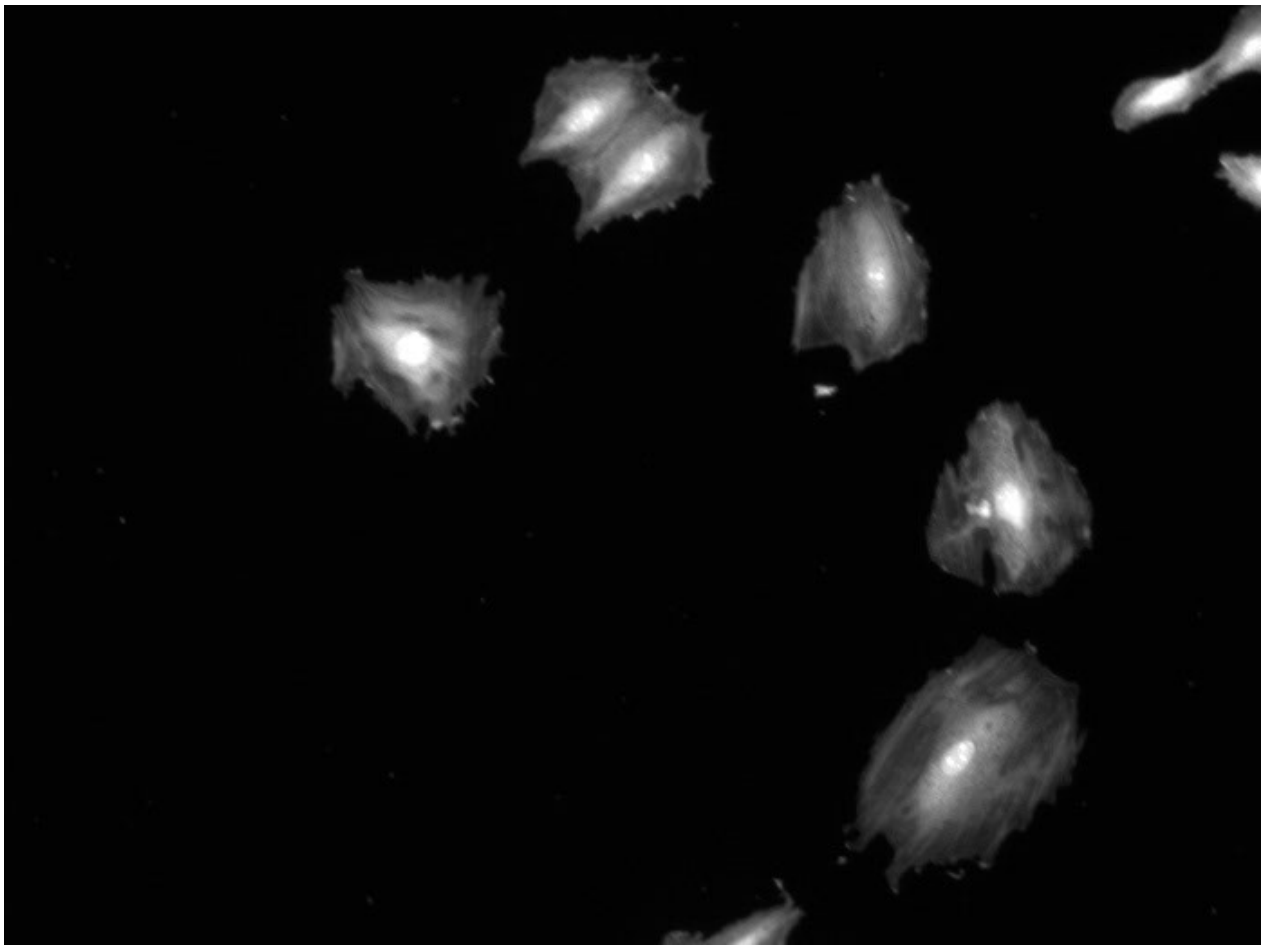

IWFCE_A10MedOptWell3_0025.png

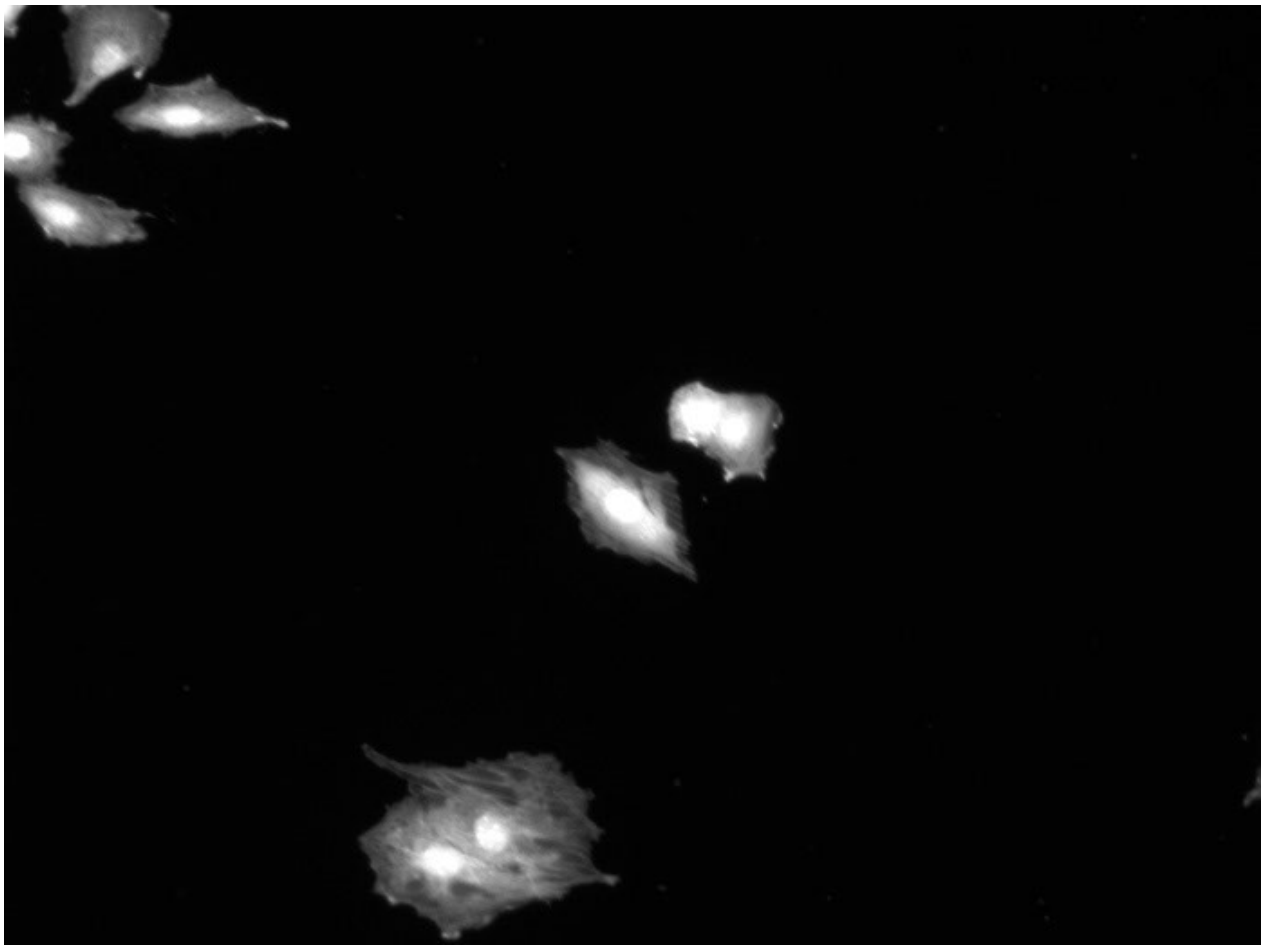

IWFCE_A10MedOptWell3_0026.png

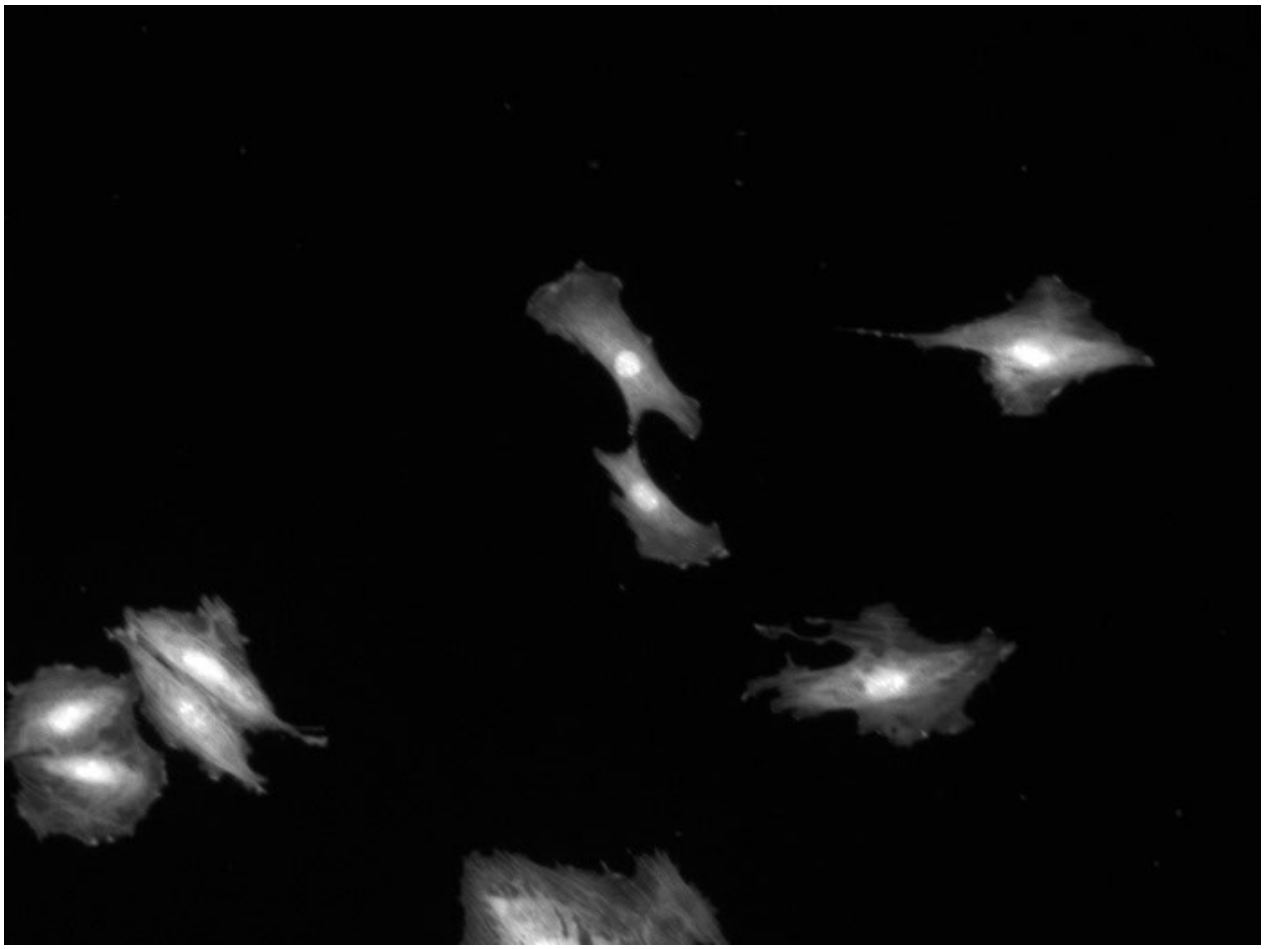

IWFCE_A10MedOptWell3_0027.png

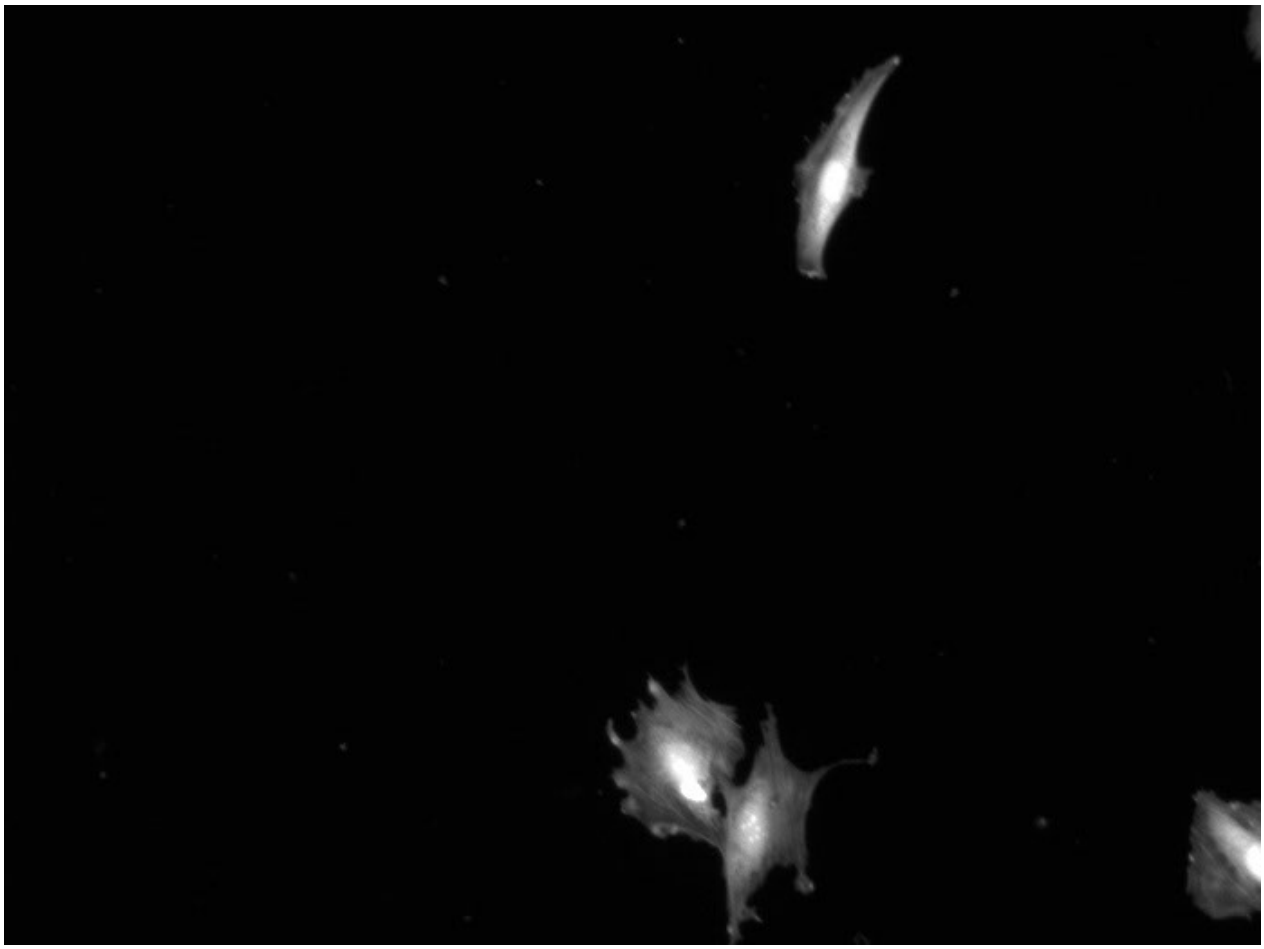

IWFCE_A10MedOptWell3_0028.png

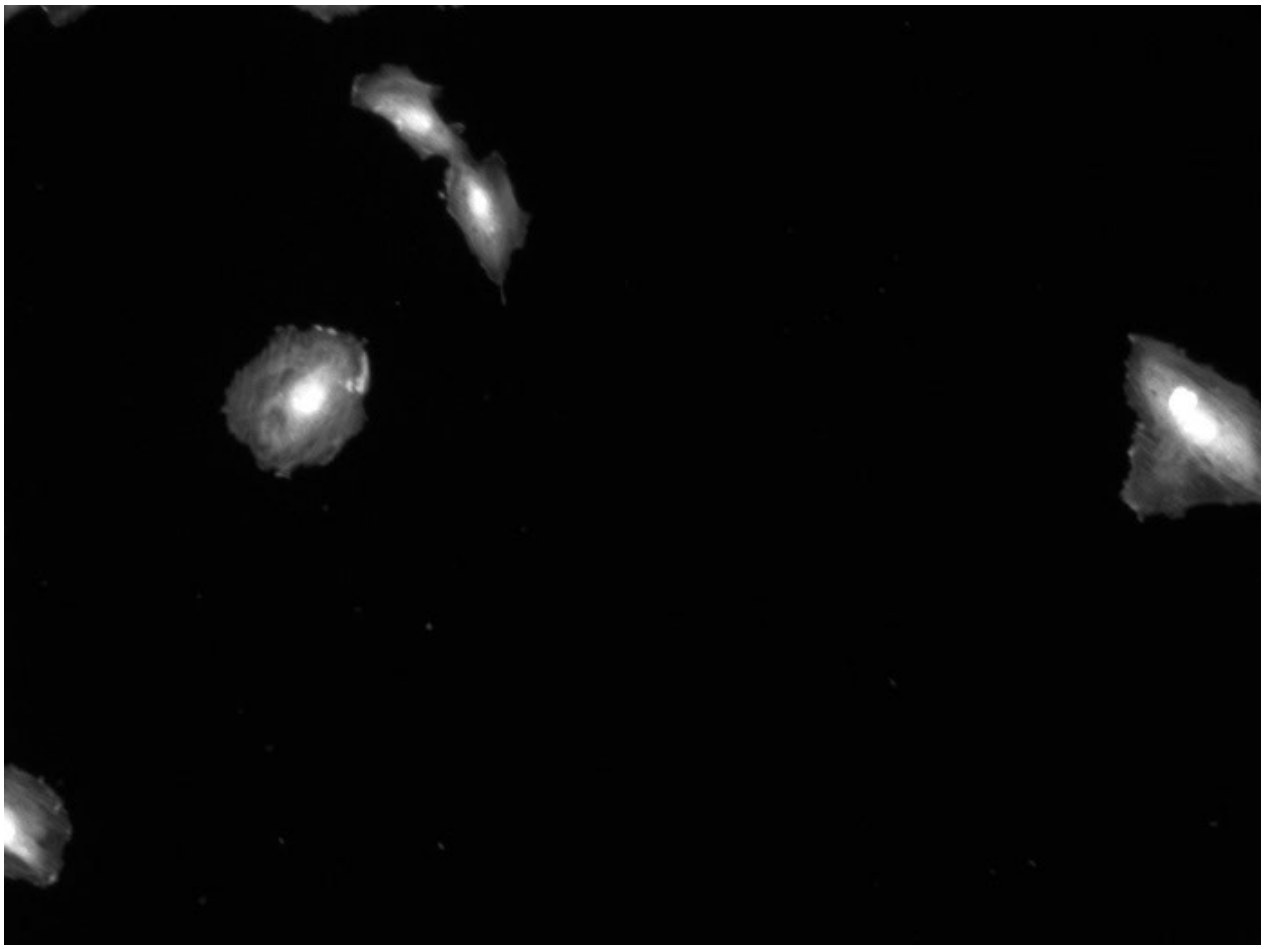

IWFCE_A10MedOptWell3_0029.png

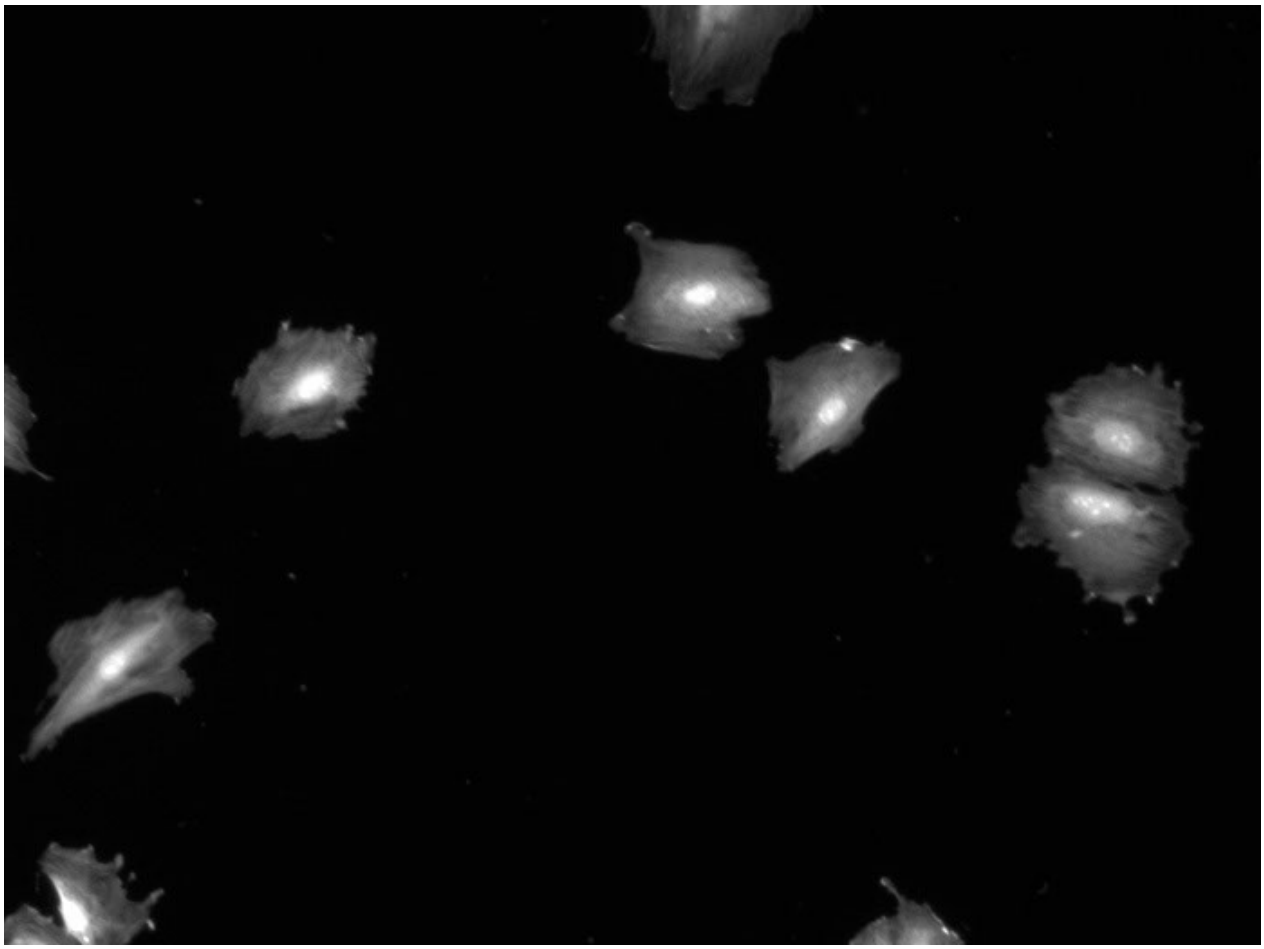

IWFCE_A10MedOptWell3_0030.png

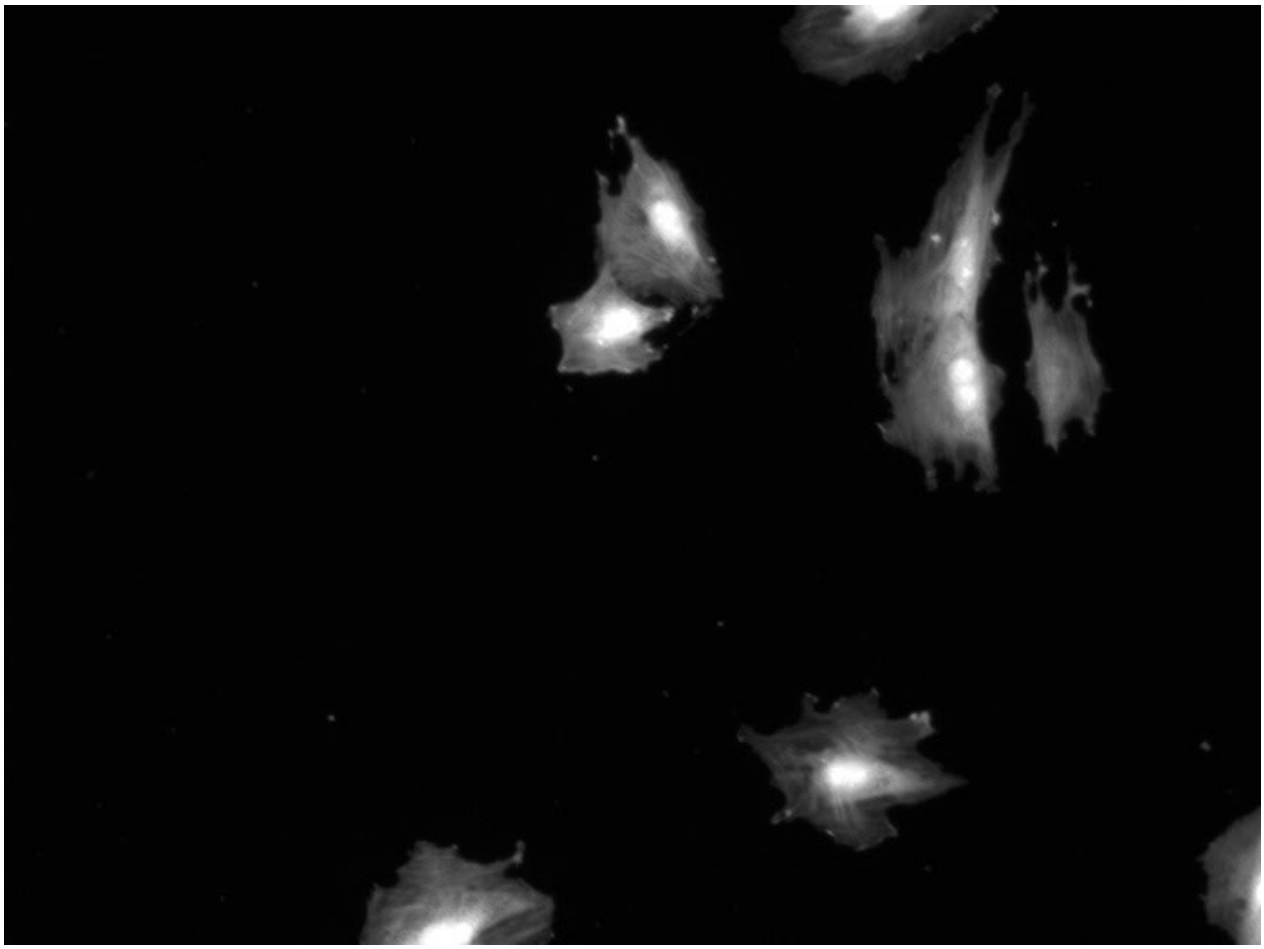

IWFCE_A10MedOptWell3_0031.png

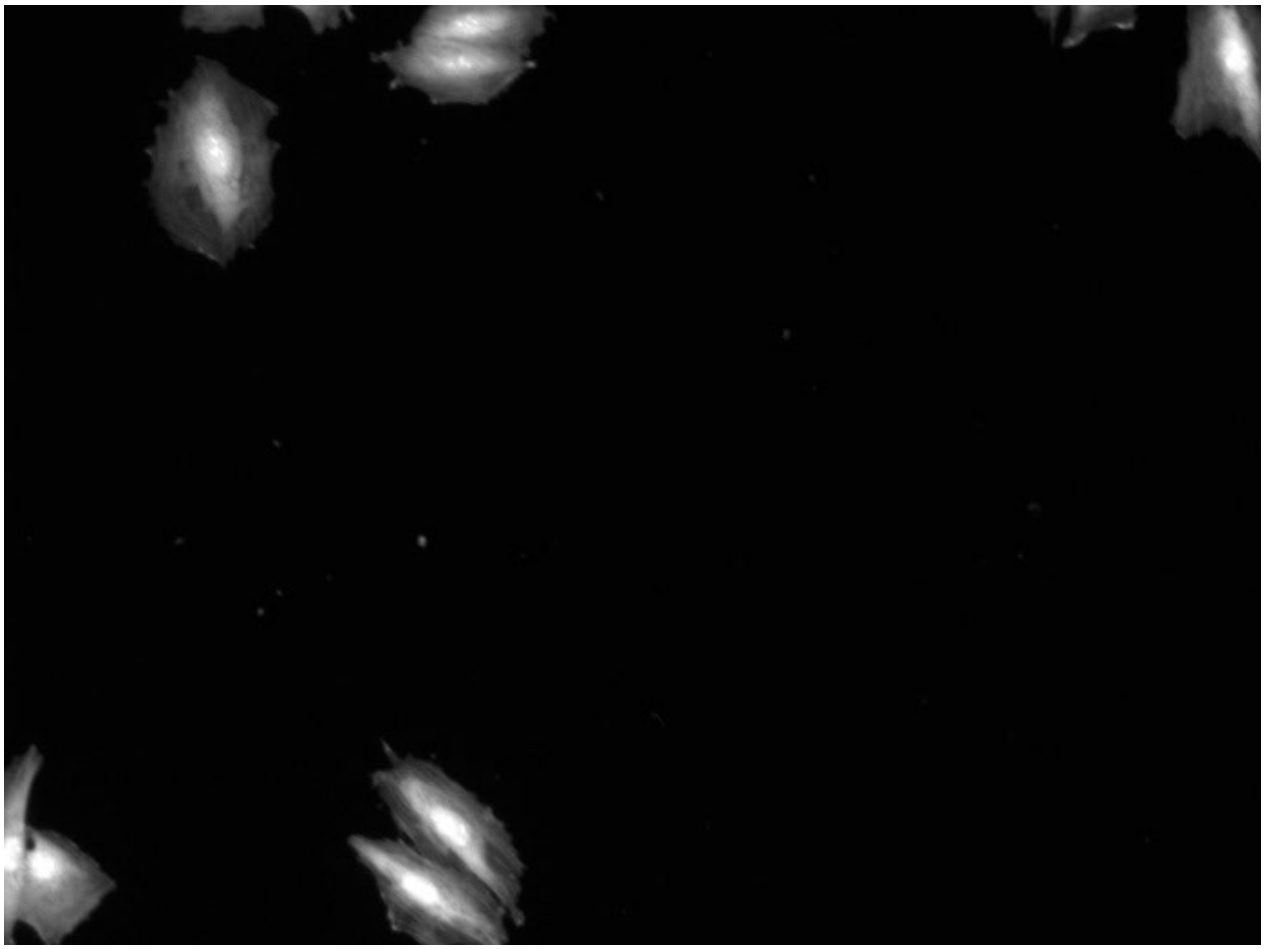

IWFCE_A10MedOptWell3_0032.png

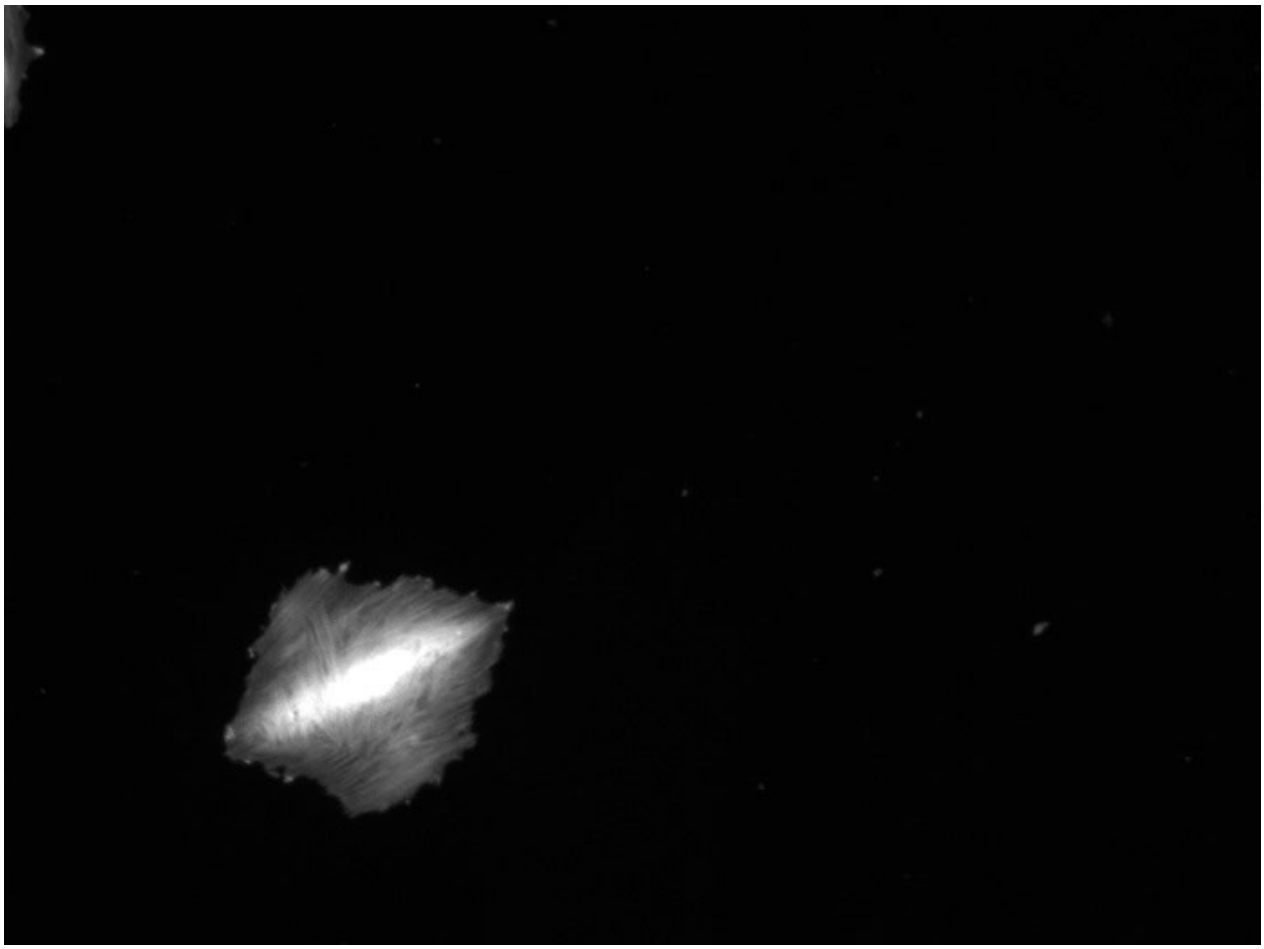

IWFCE_A10MedOptWell3_0033.png

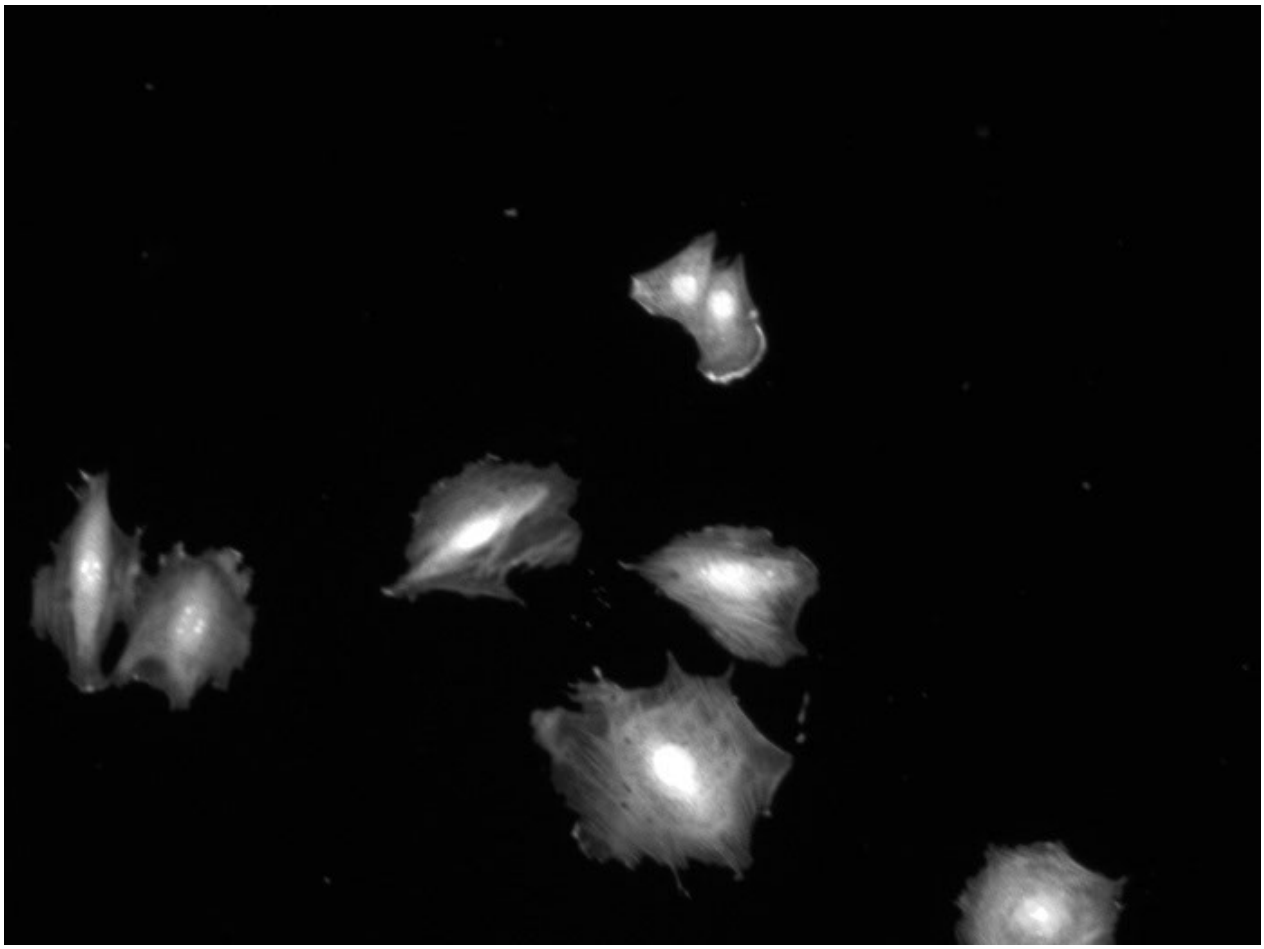

IWFCE_A10MedOptWell3_0034.png

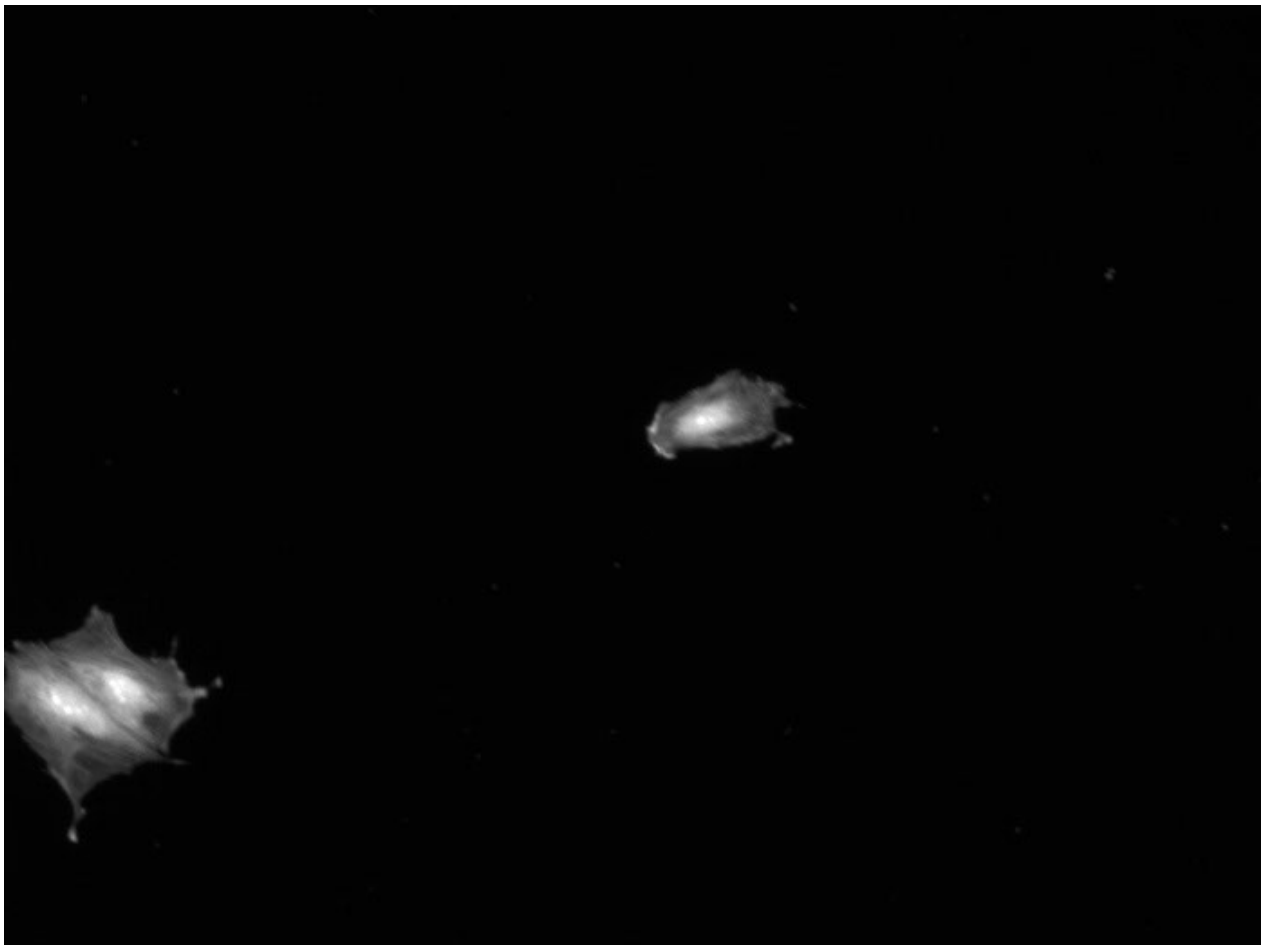

IWFCE_A10MedOptWell3_0035.png

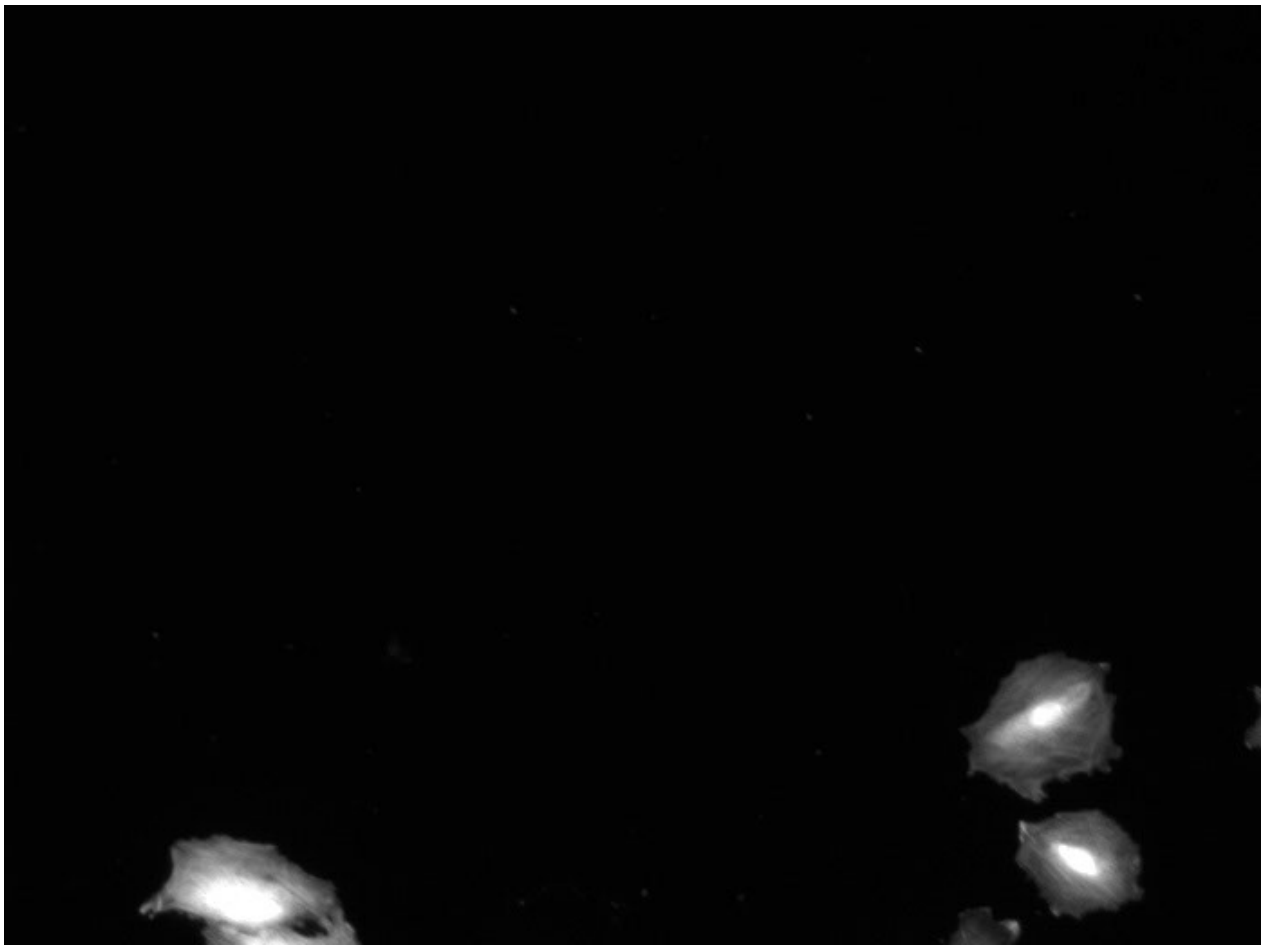

IWFCE_A10MedOptWell3_0036.png

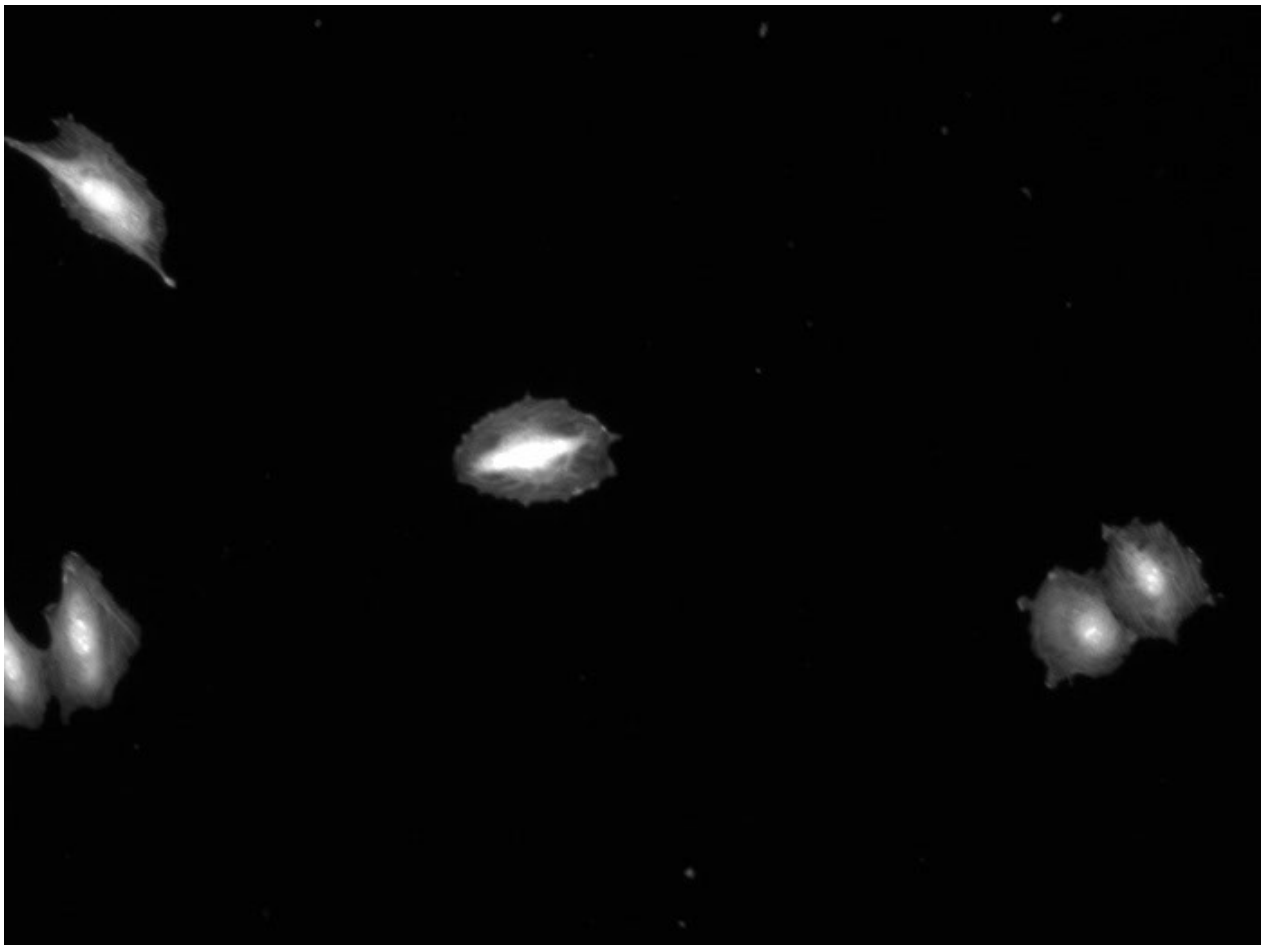

IWFCE_A10MedOptWell3_0037.png

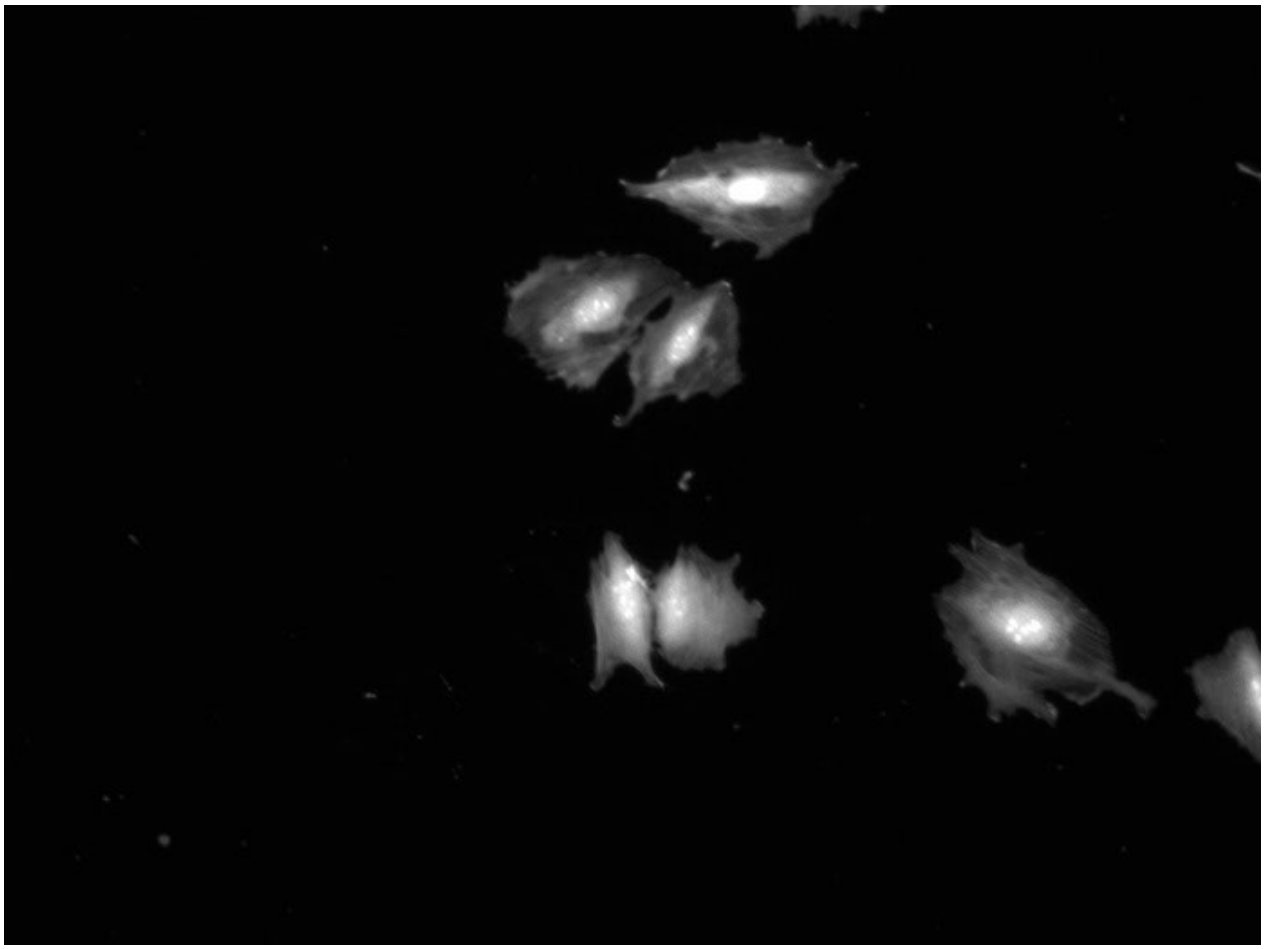

IWFCE_A10MedOptWell3_0038.png

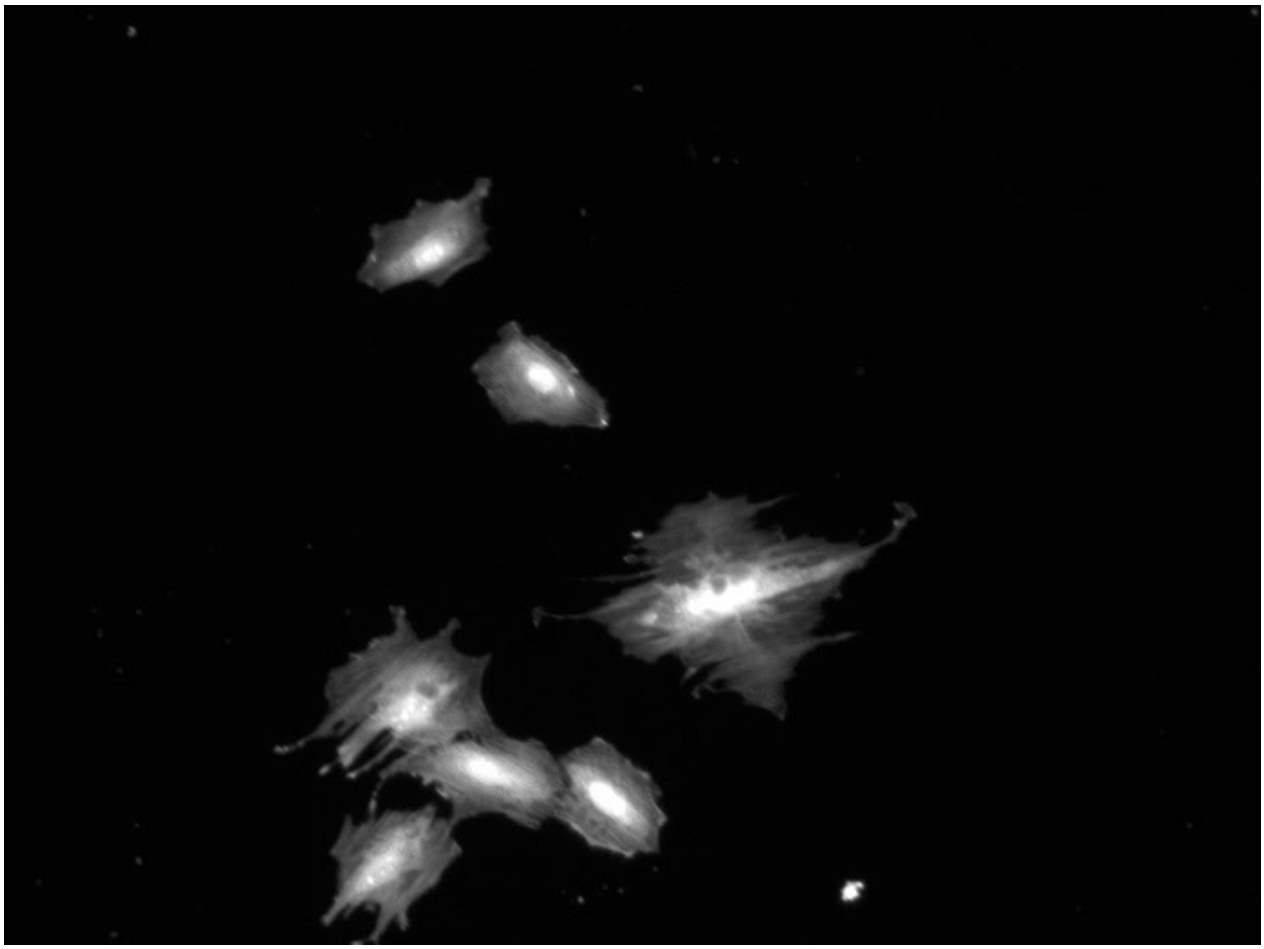

IWFCE_A10MedOptWell3_0039.png

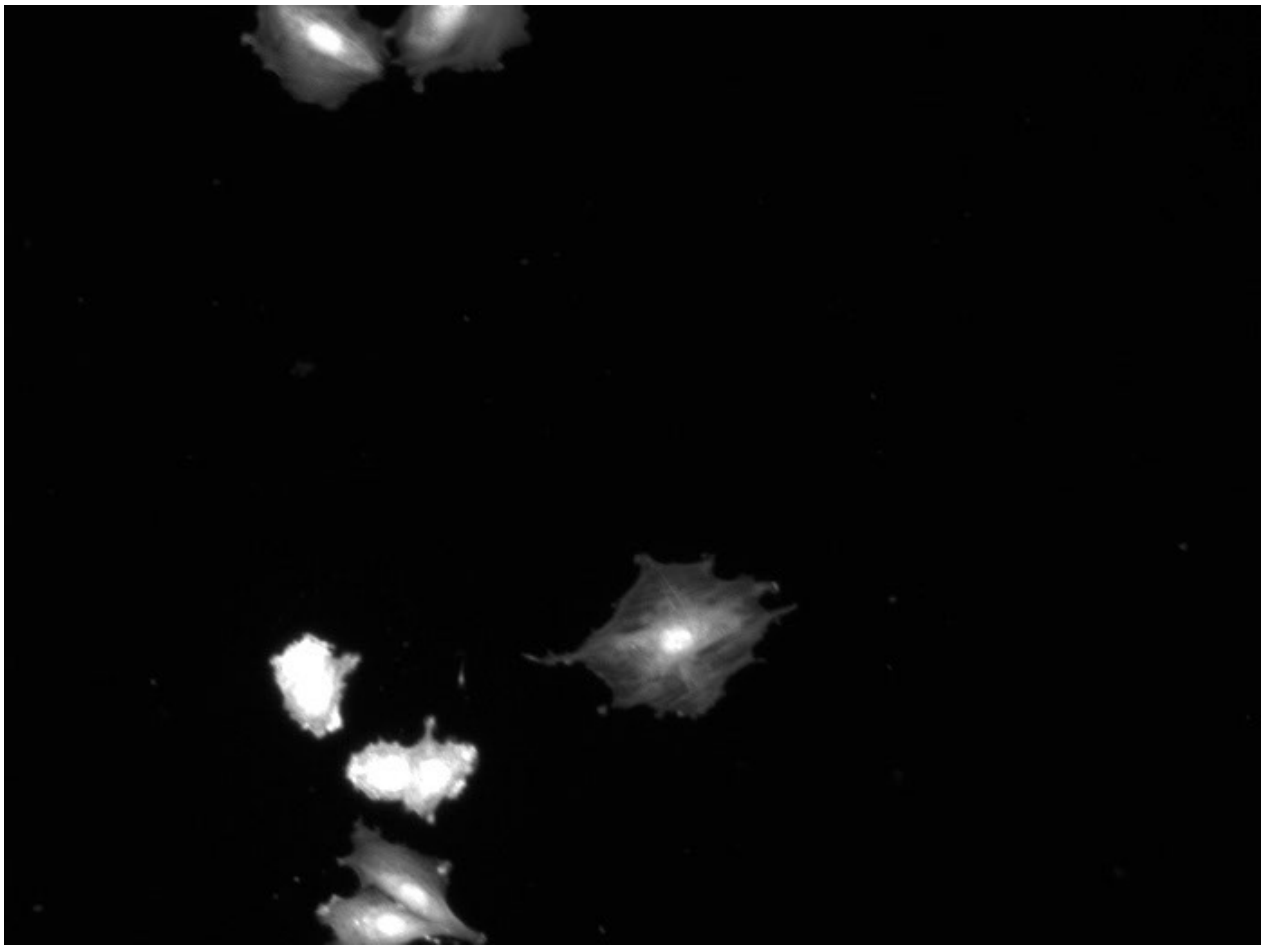

IWFCE_A10MedOptWell3_0040.png

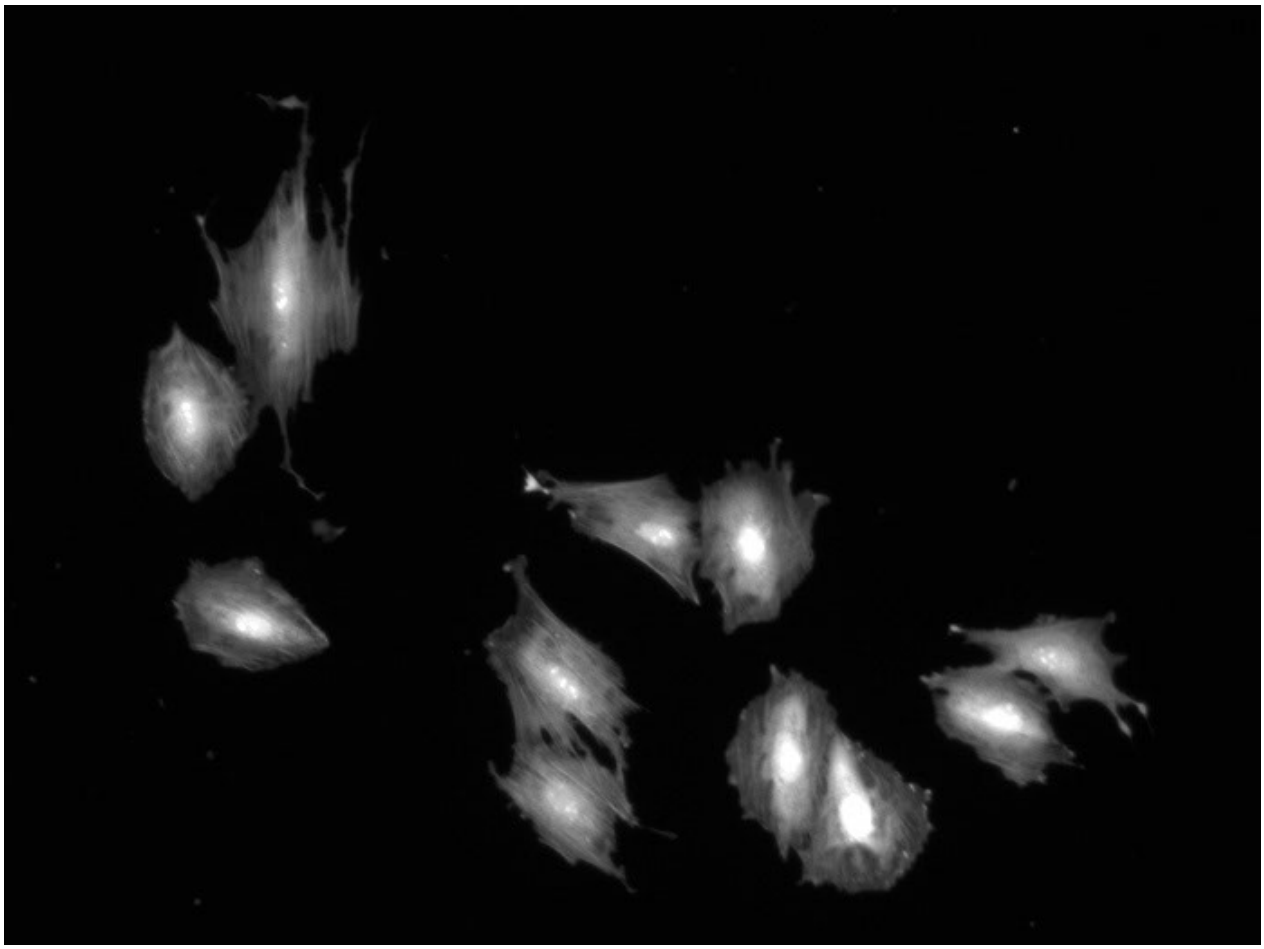

IWFCE_A10MedOptWell3_0041.png

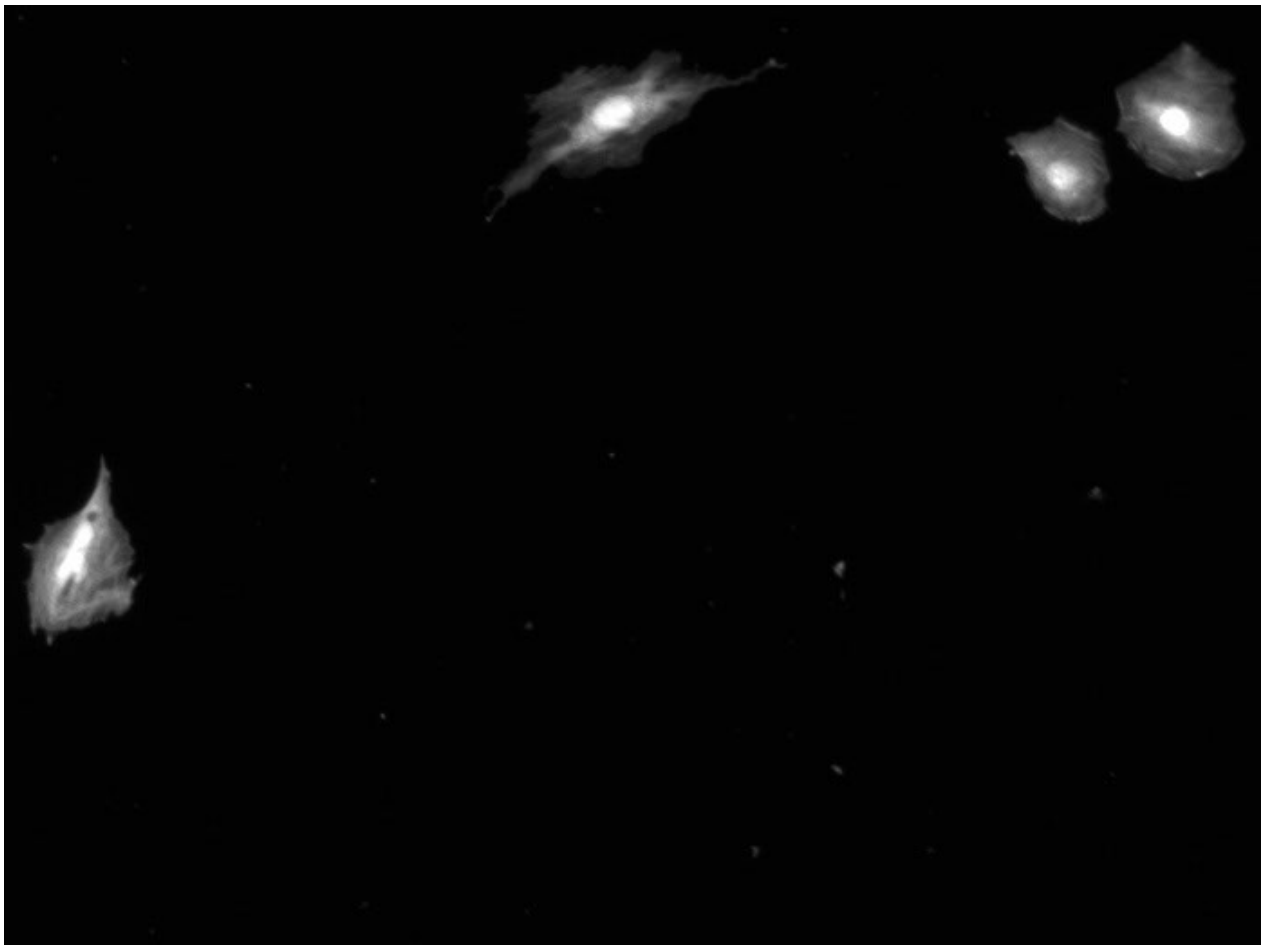

IWFCE_A10MedOptWell3_0042.png

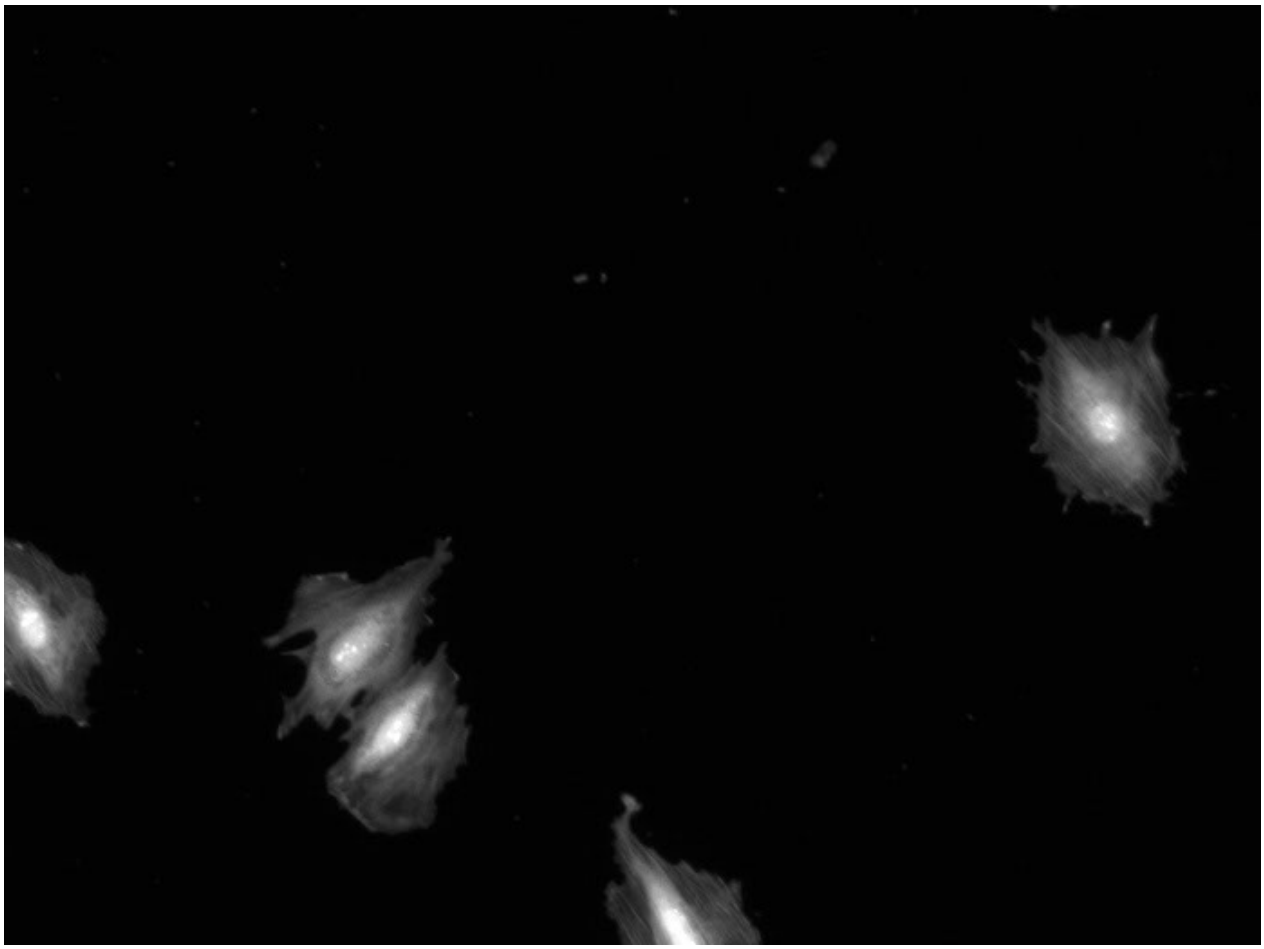

IWFCE_A10MedOptWell3_0043.png

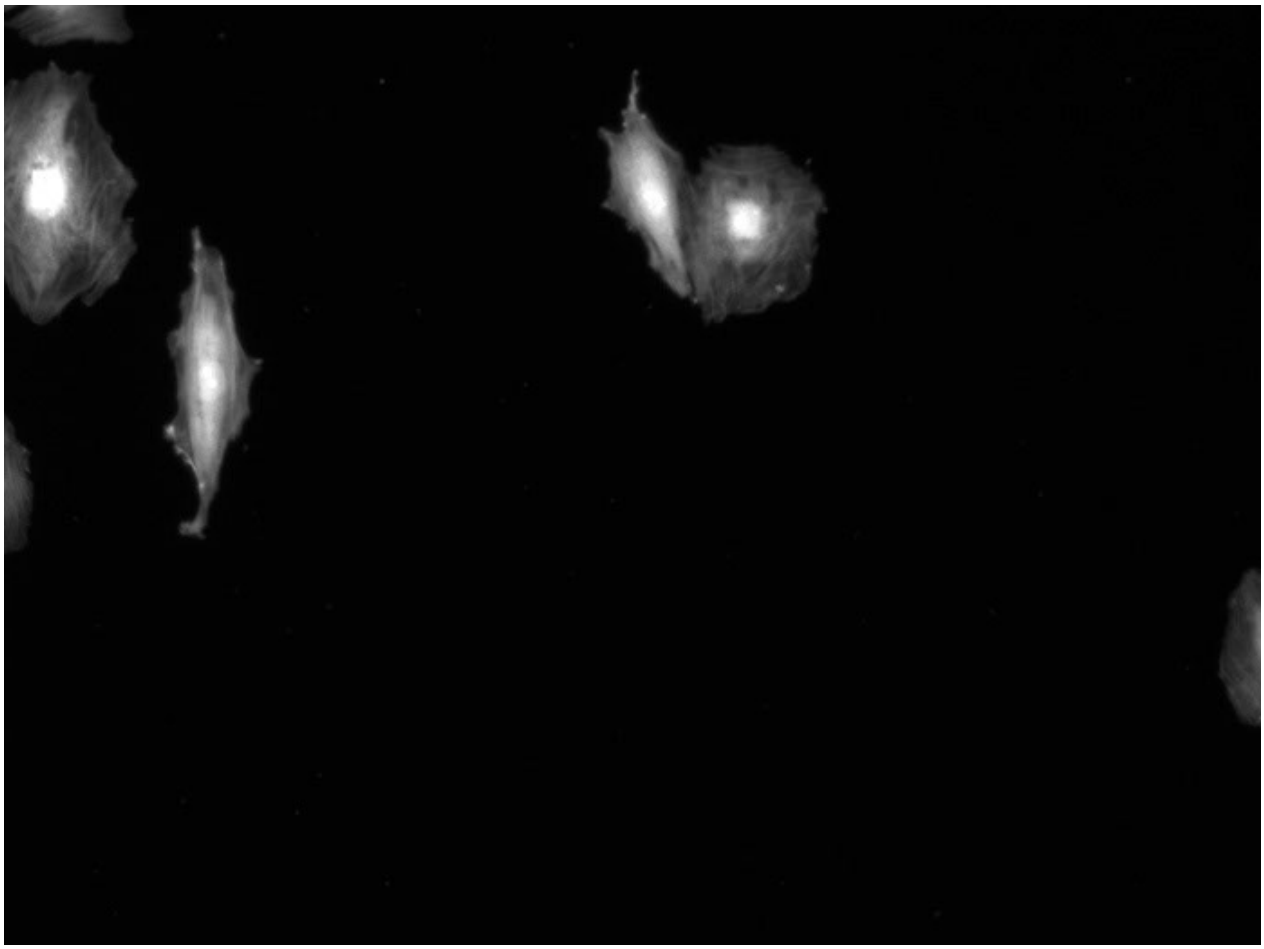

IWFCE_A10MedOptWell3_0044.png

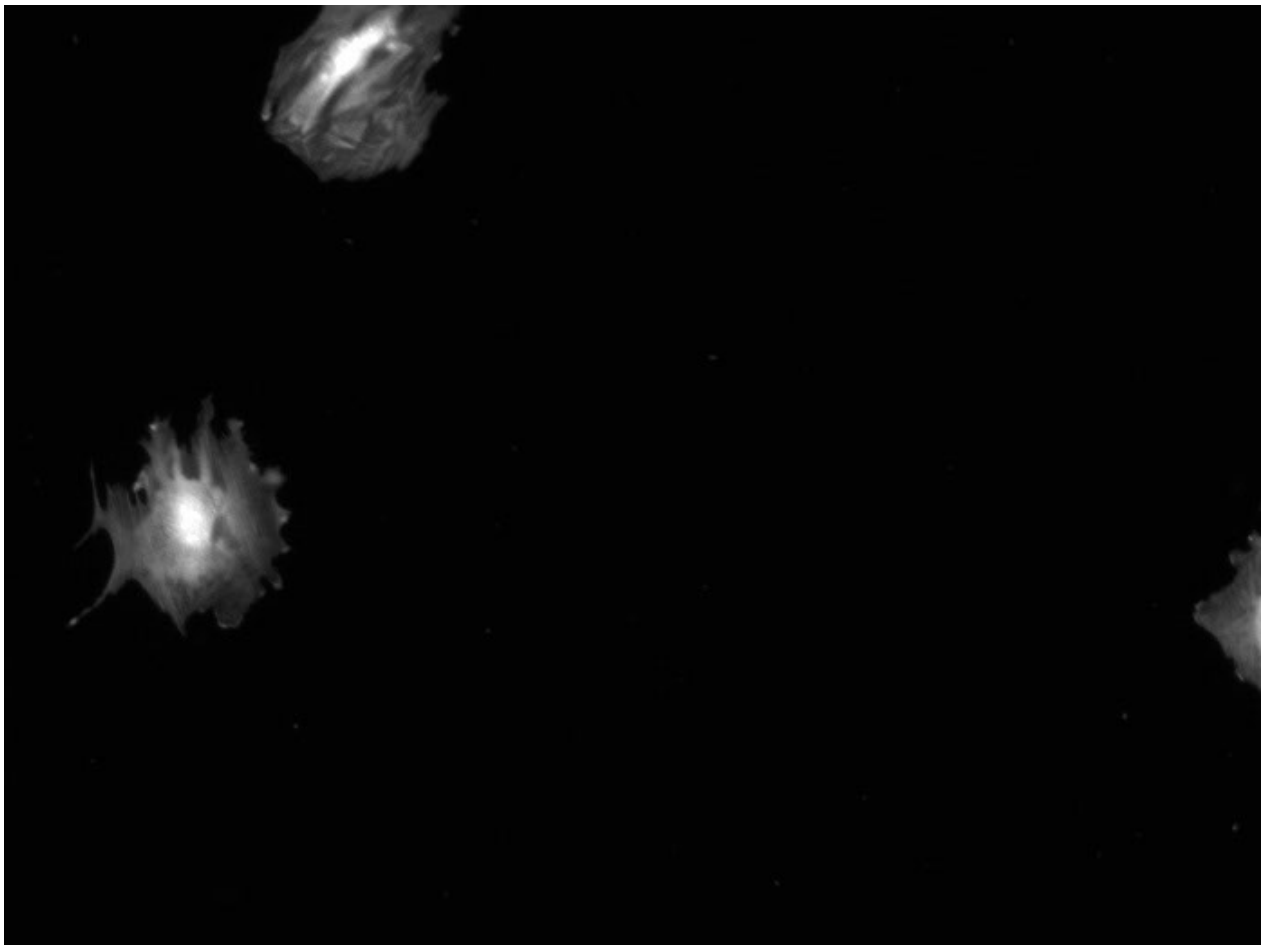

IWFCE_A10MedOptWell3_0045.png

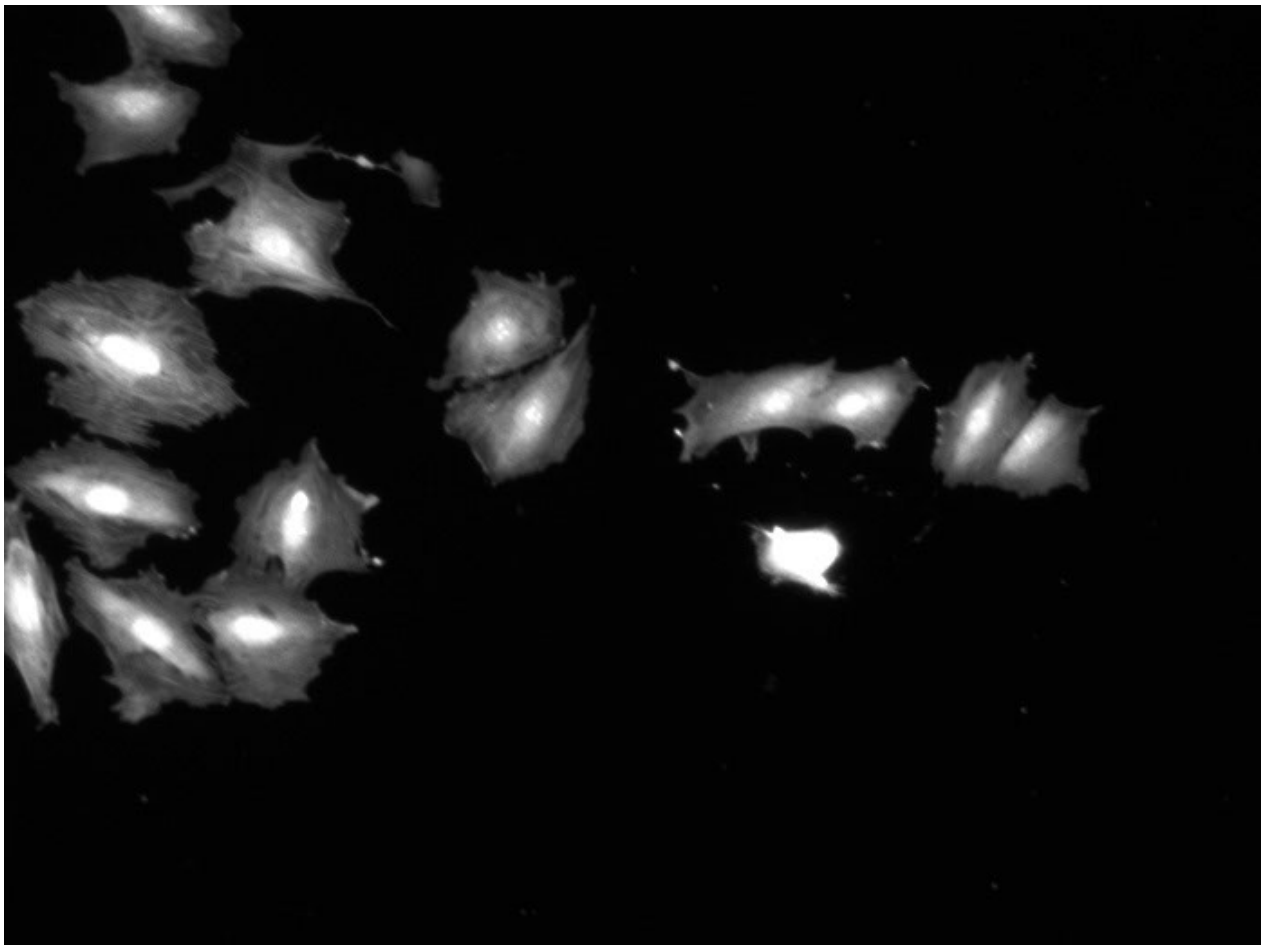

IWFCE_A10MedOptWell3_0046.png

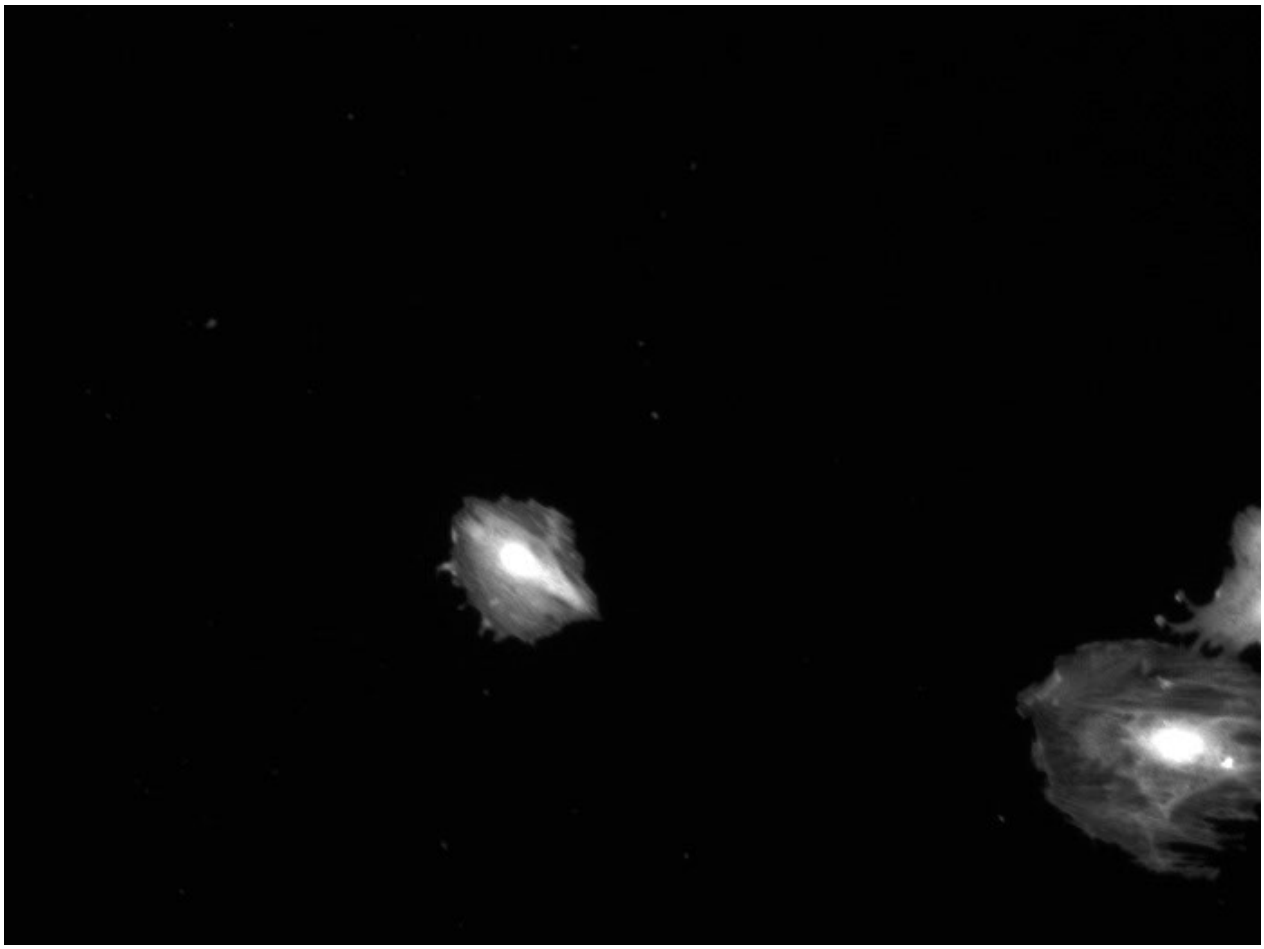

IWFCE_A10MedOptWell3_0047.png

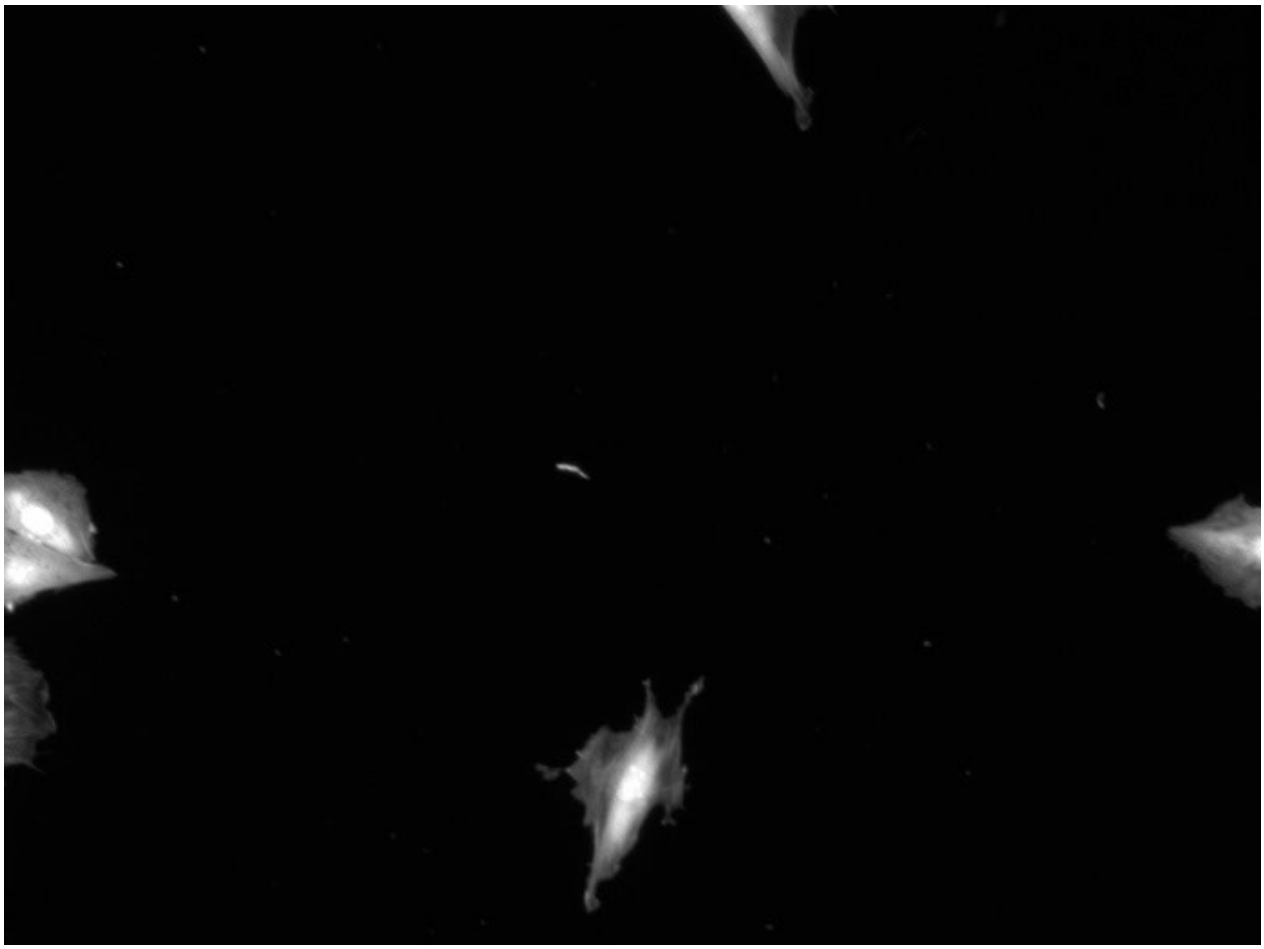

IWFCE_A10MedOptWell3_0048.png

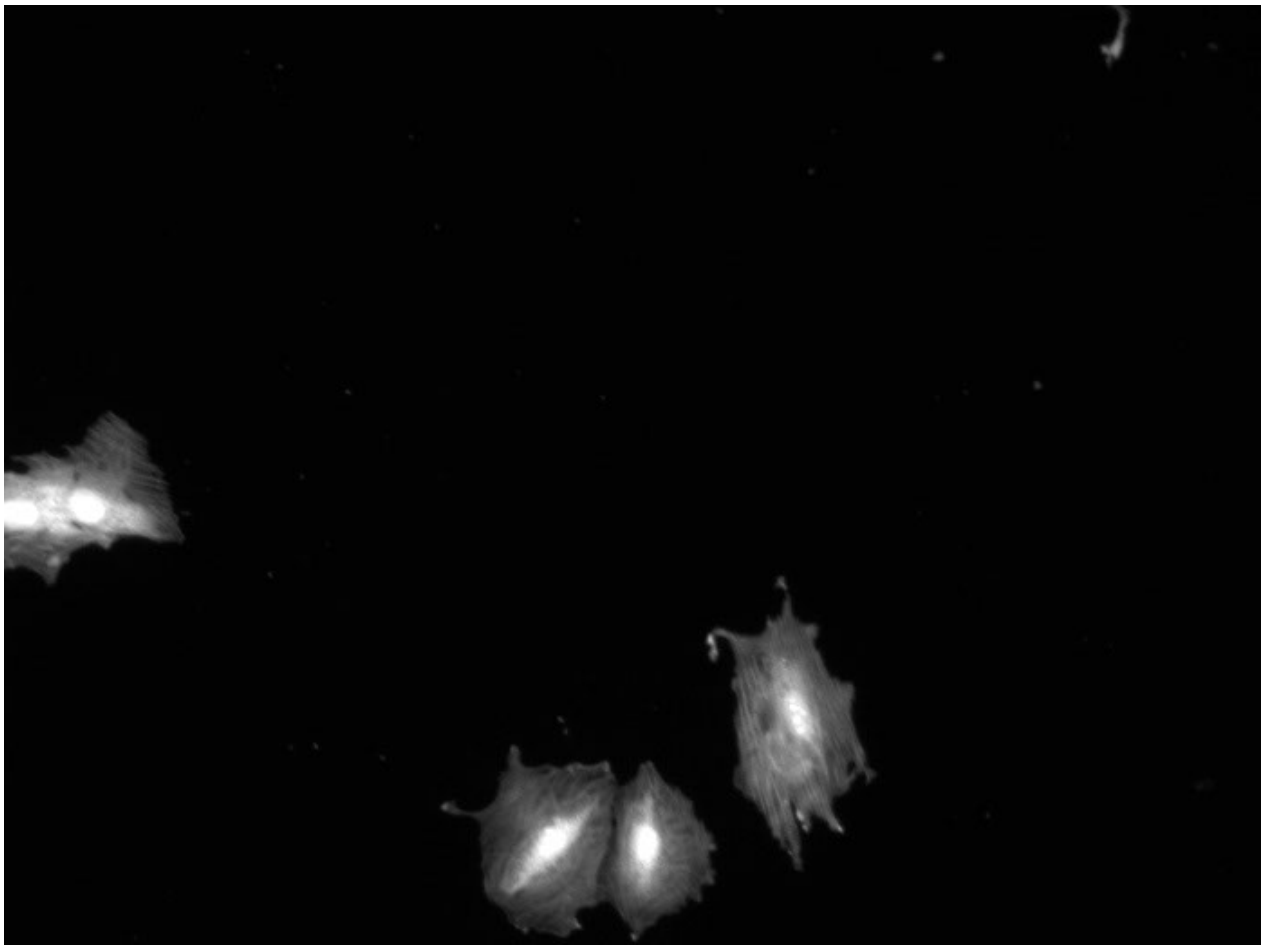

IWFCE_A10MedOptWell3_0049.png

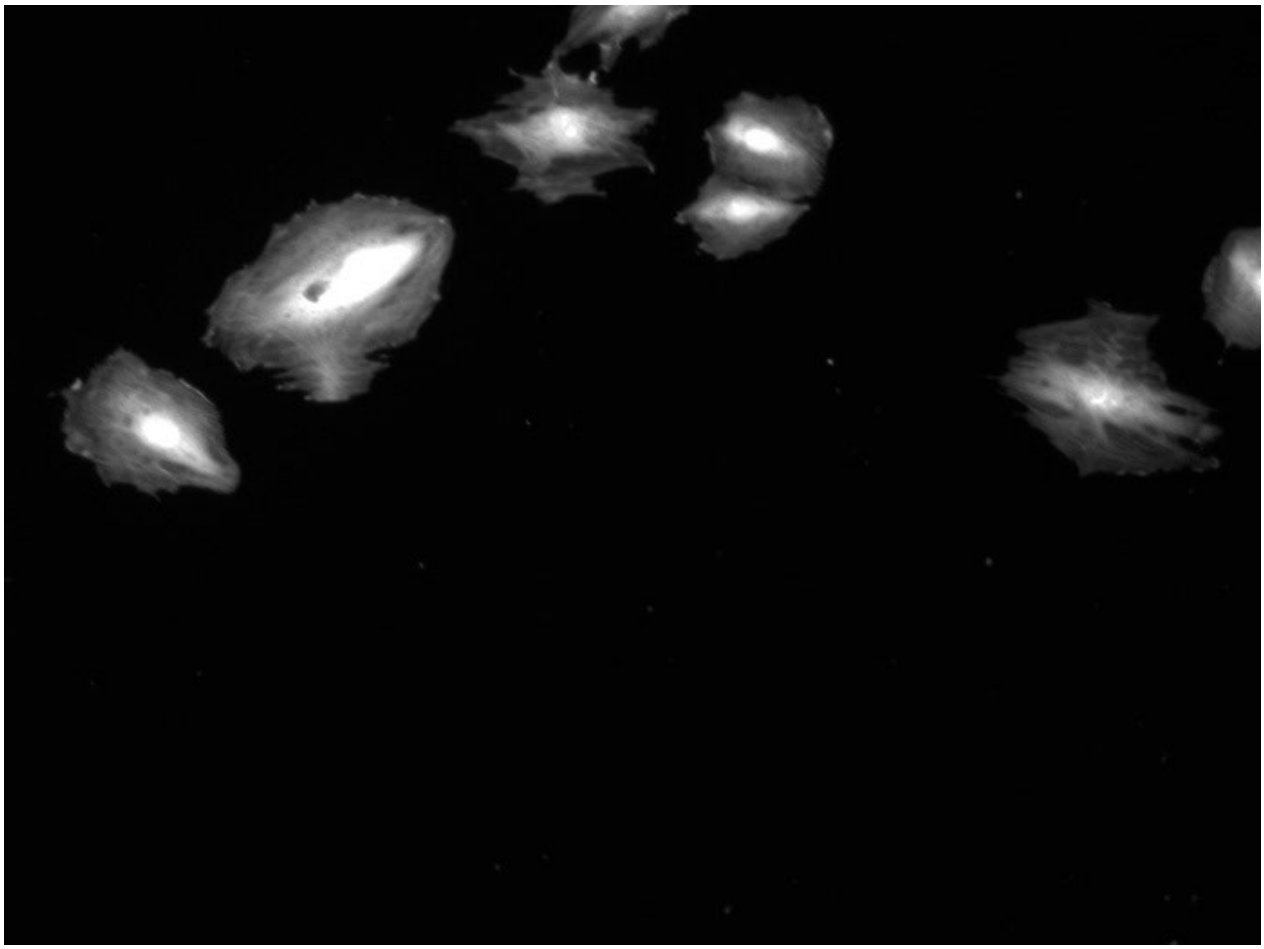

IWFCE_A10MedOptWell3_0050.png