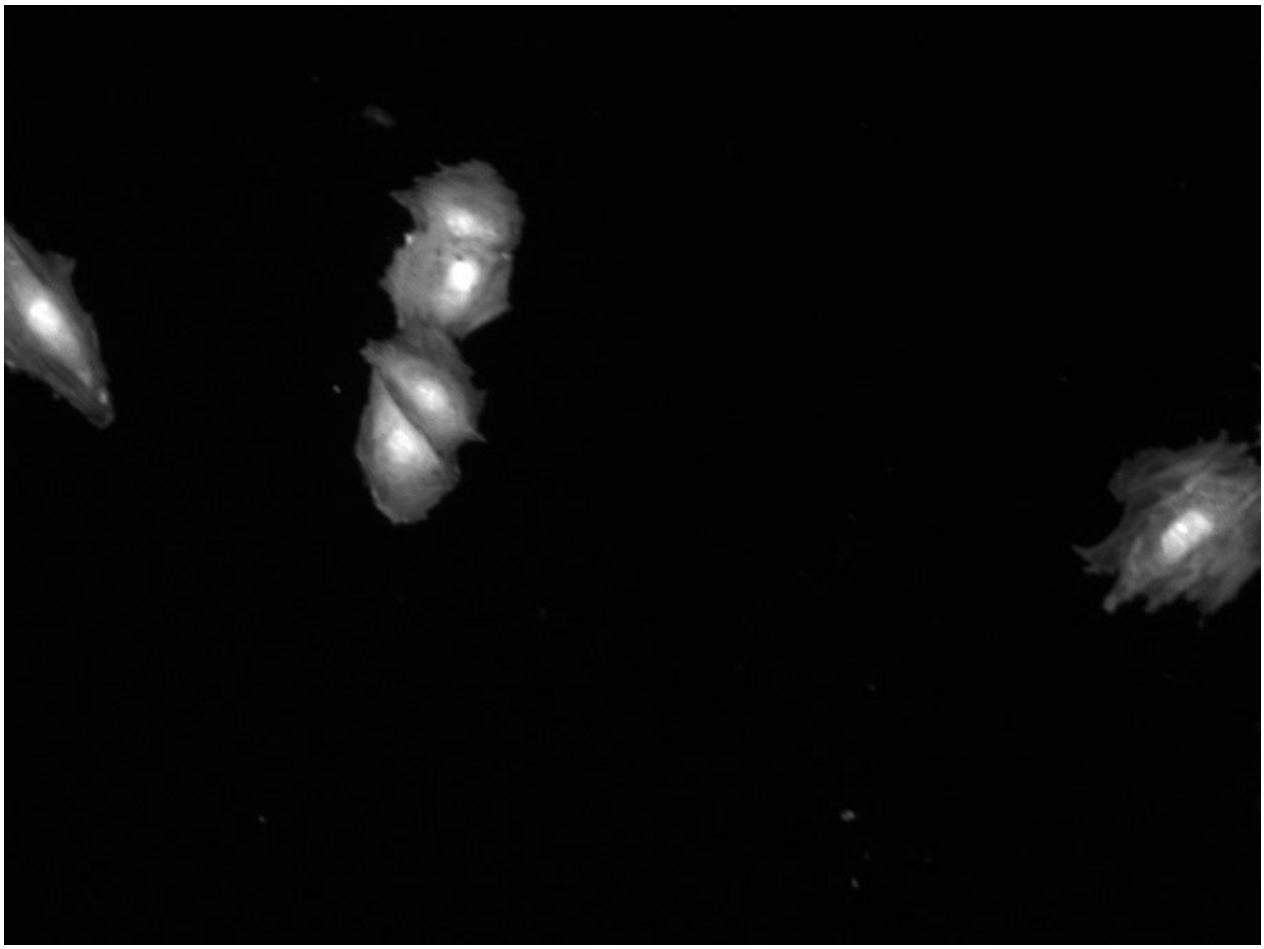

IWFCE_A10MedOptWell1_0001.png

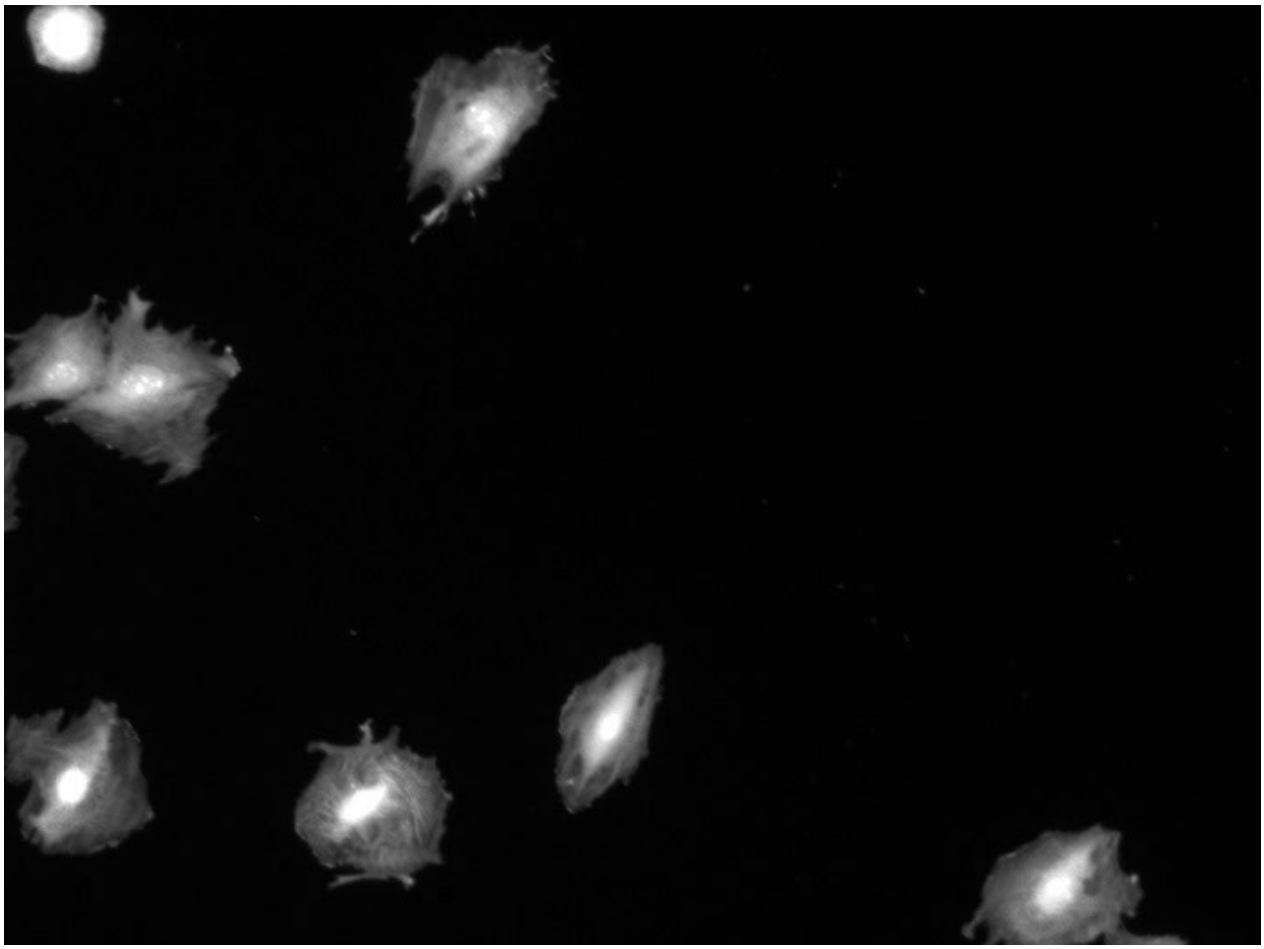

IWFCE_A10MedOptWell1_0002.png

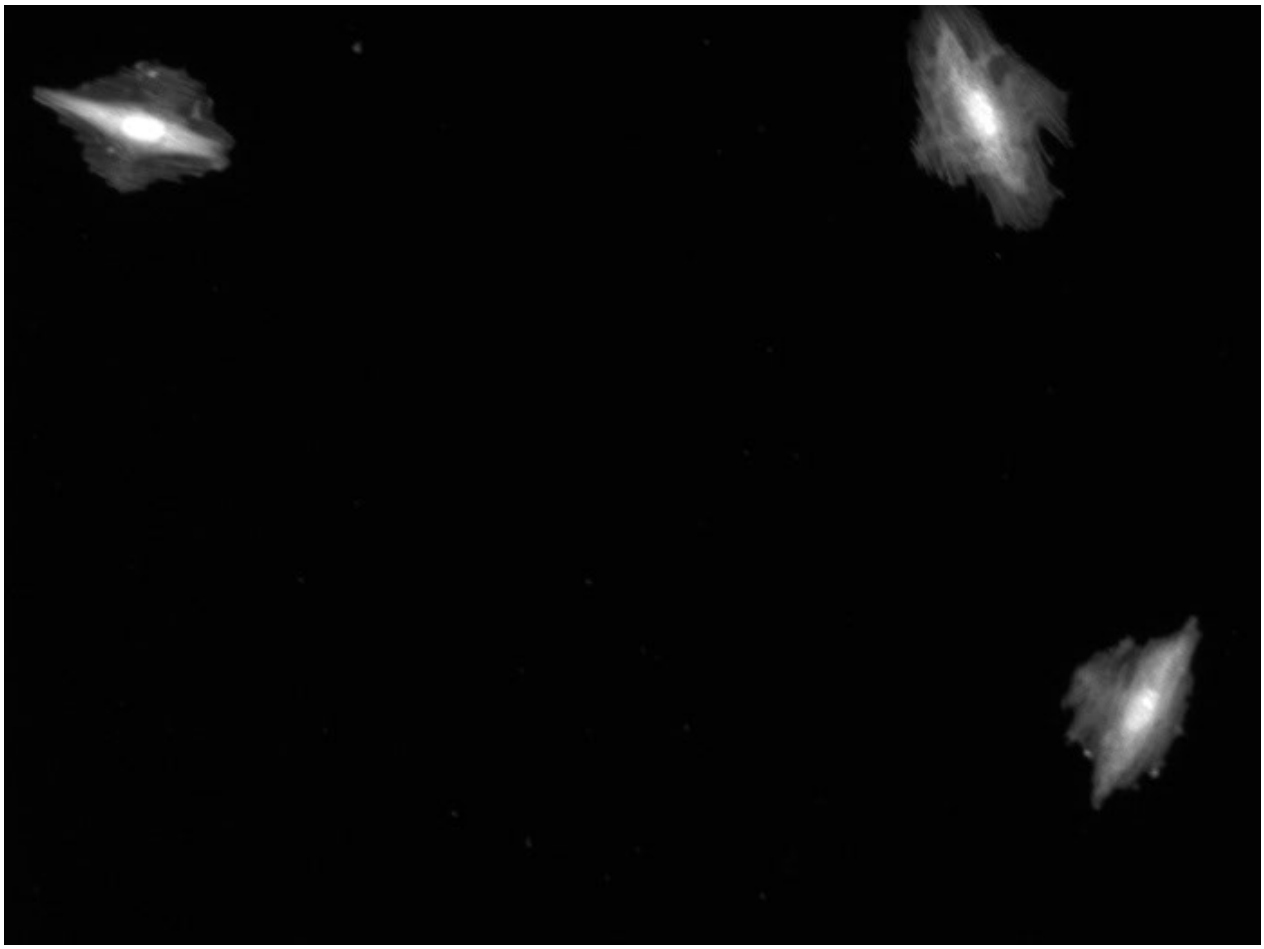

IWFCE_A10MedOptWell1_0003.png

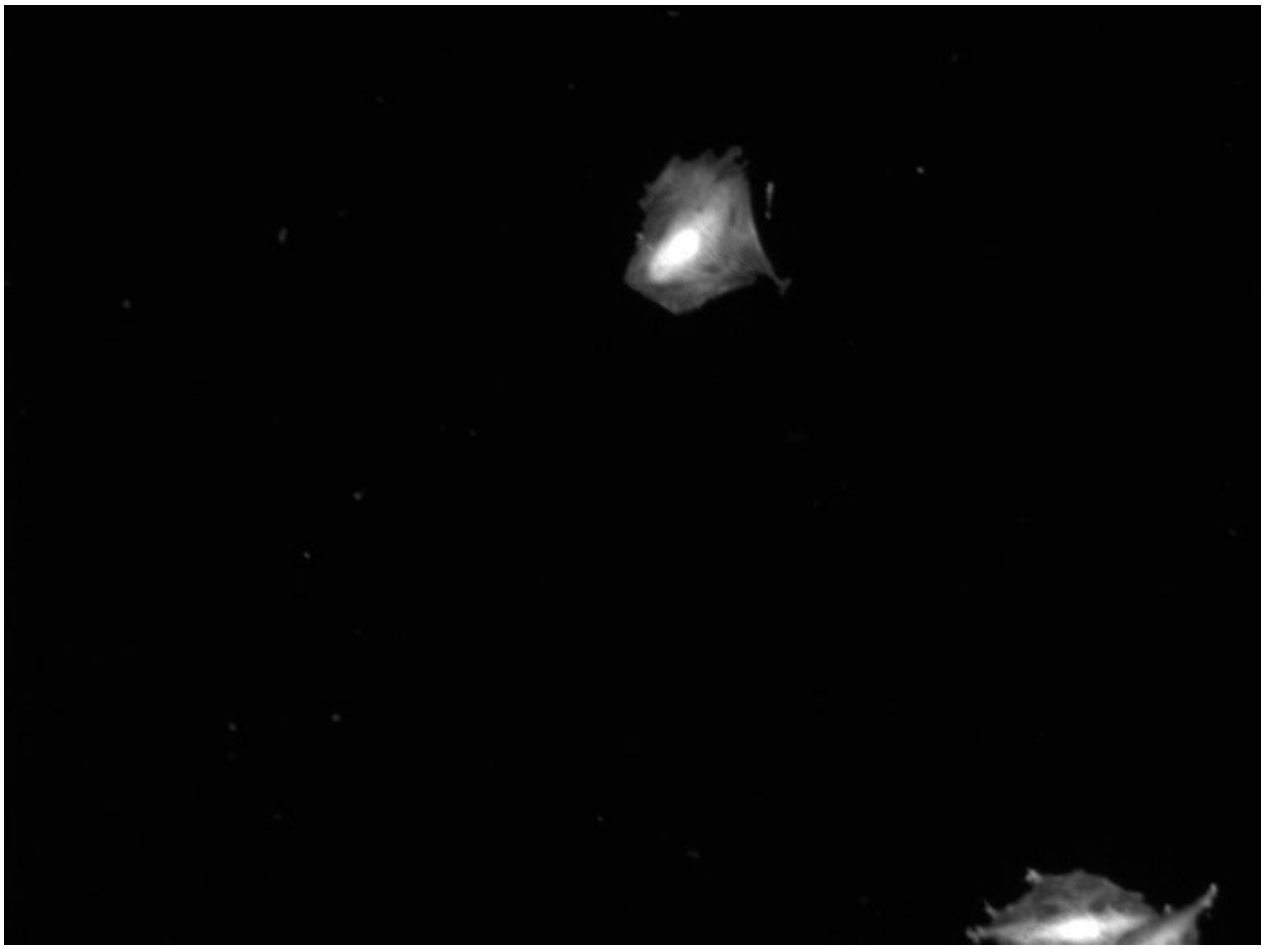

IWFCE_A10MedOptWell1_0004.png

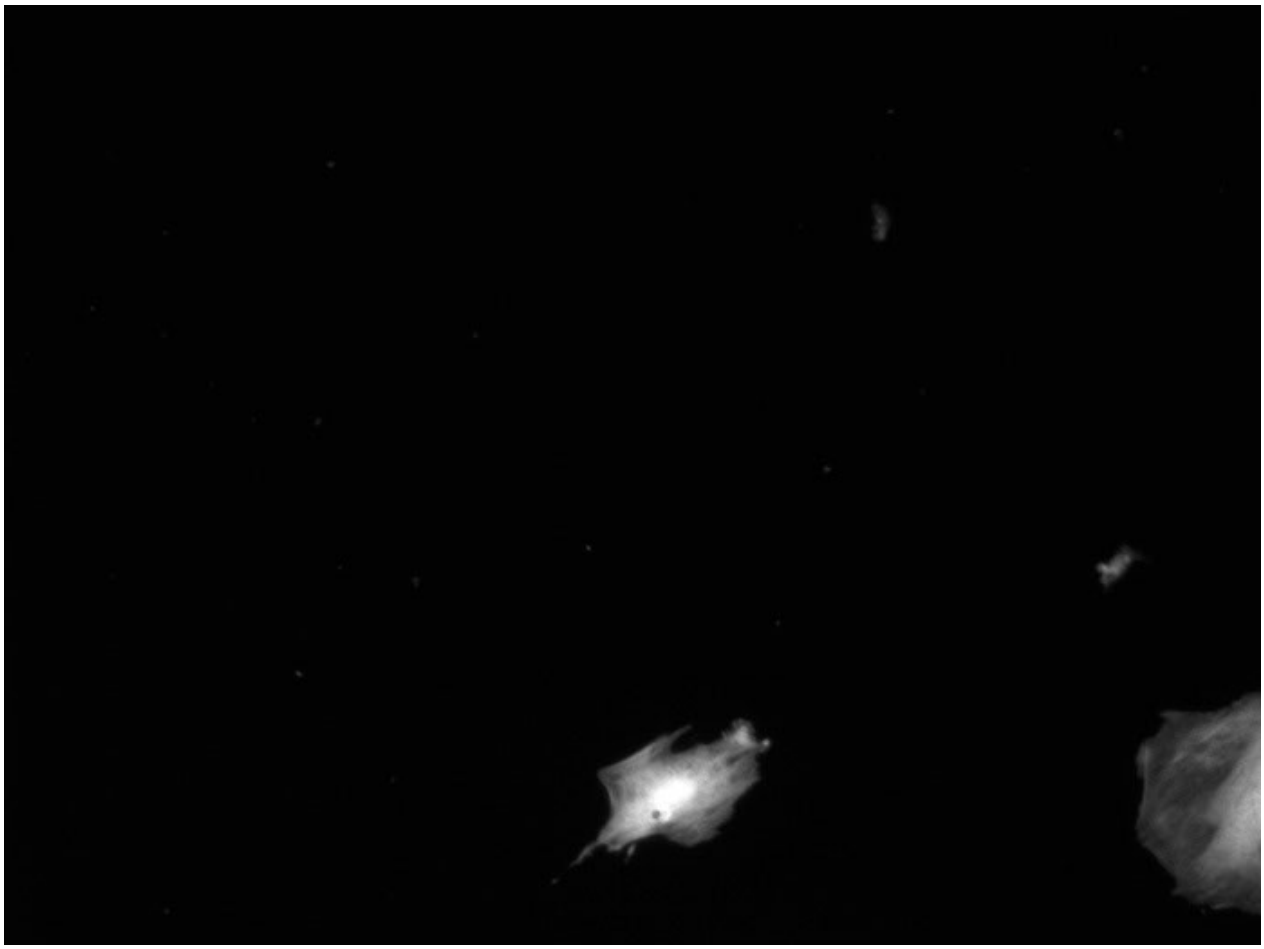

IWFCE_A10MedOptWell1_0005.png

IWFCE_A10MedOptWell1_0006.png

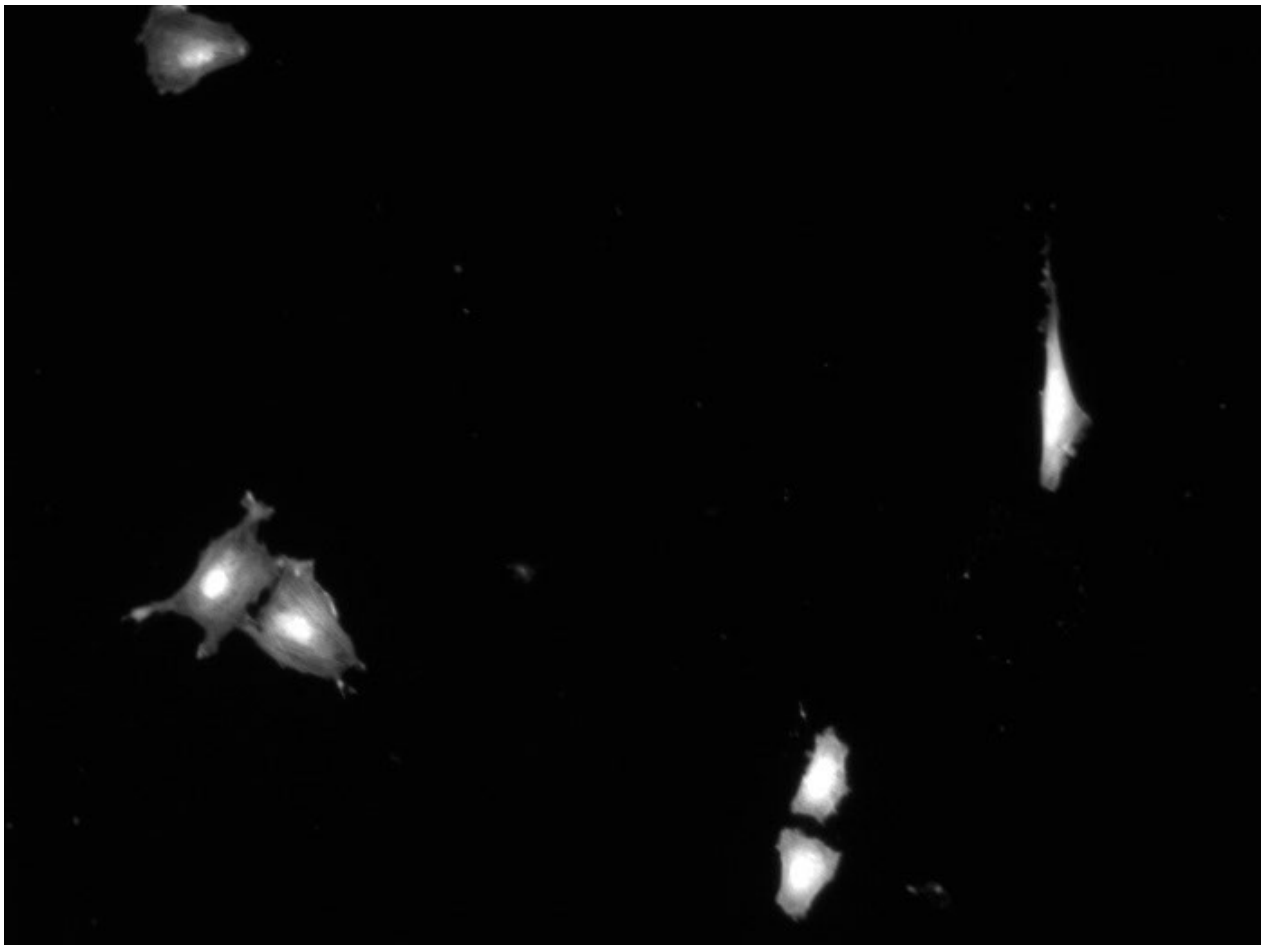

IWFCE_A10MedOptWell1_0007.png

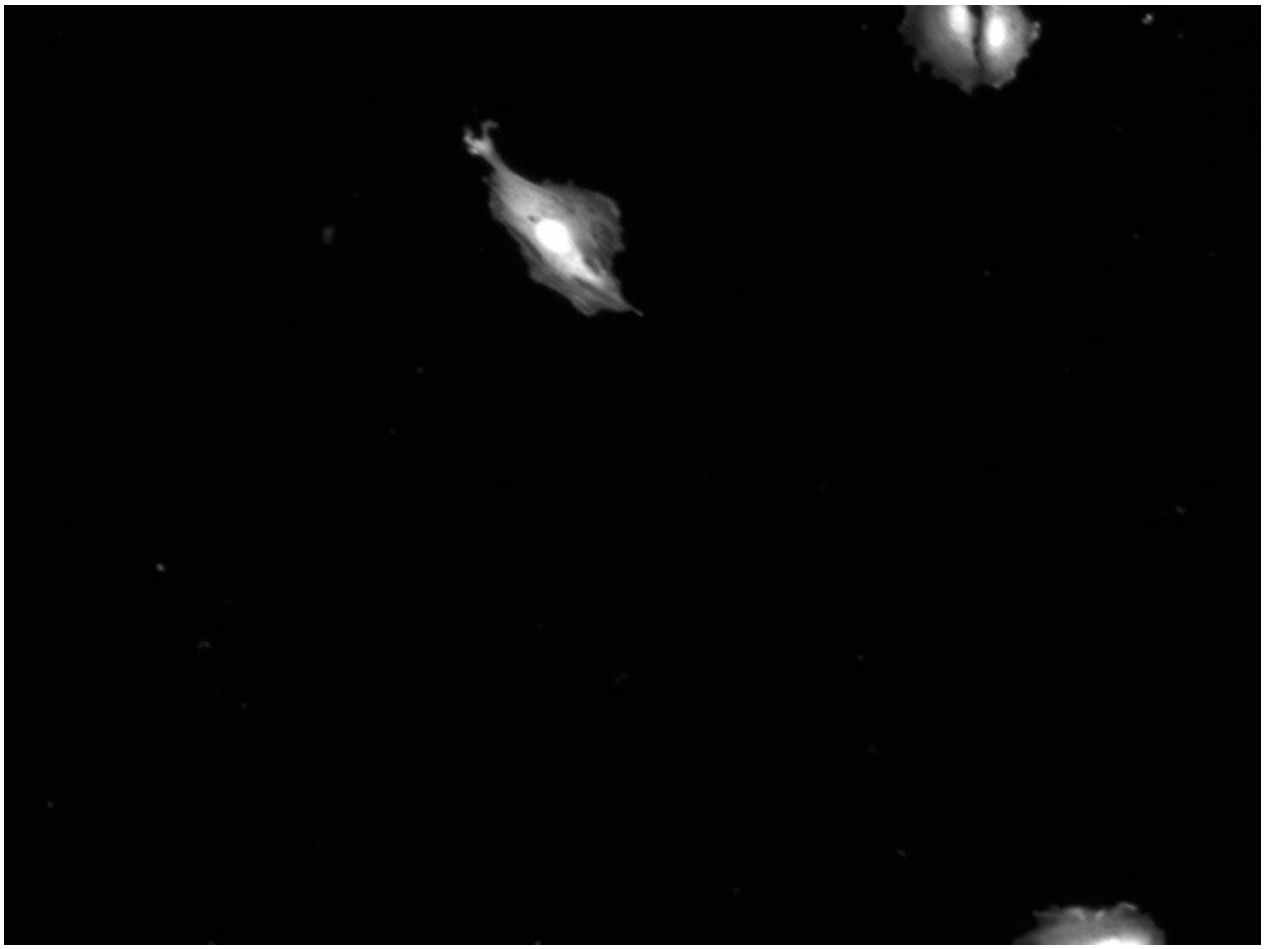

IWFCE_A10MedOptWell1_0008.png

IWFCE_A10MedOptWell1_0009.png

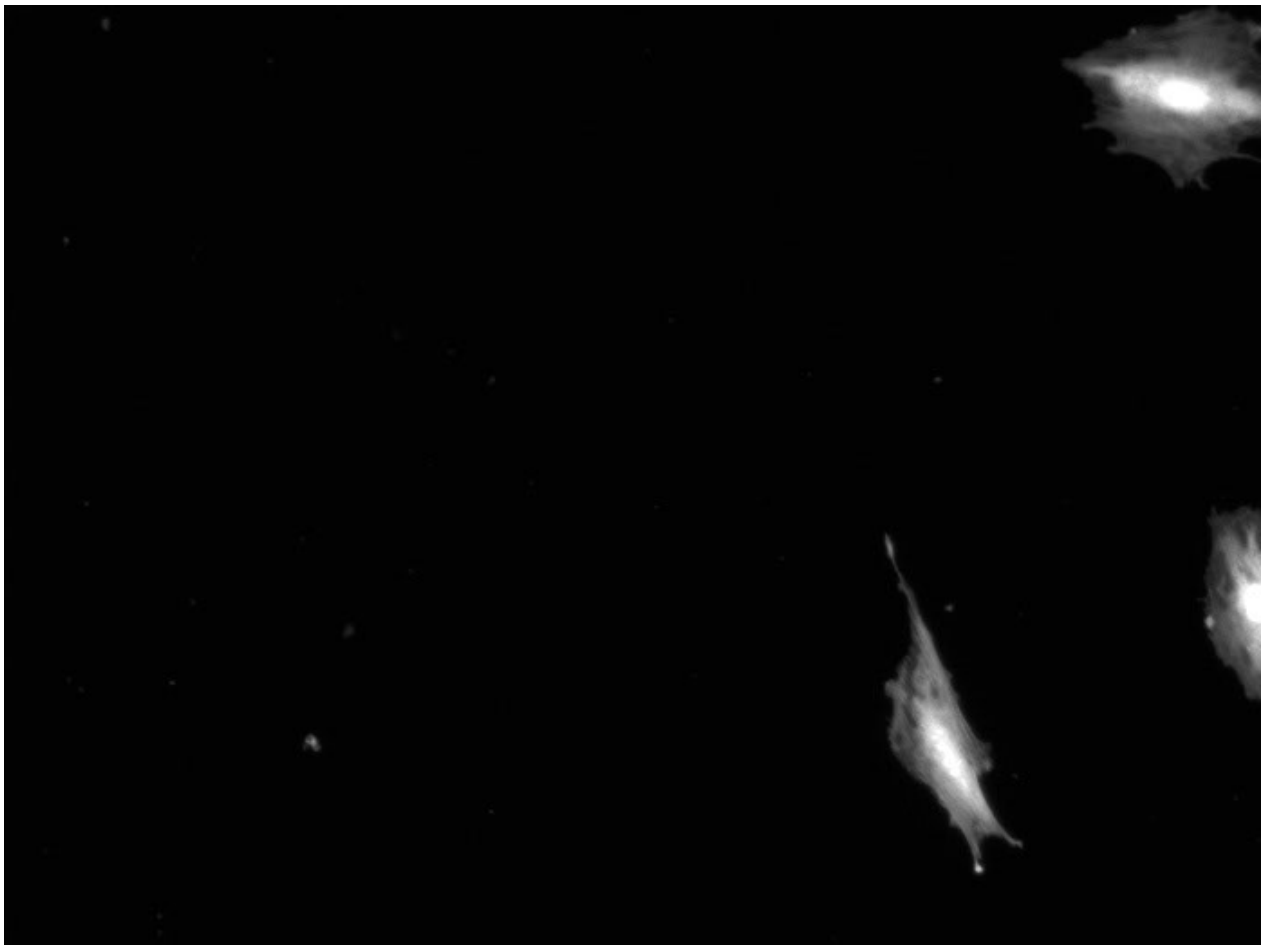

IWFCE_A10MedOptWell1_0010.png

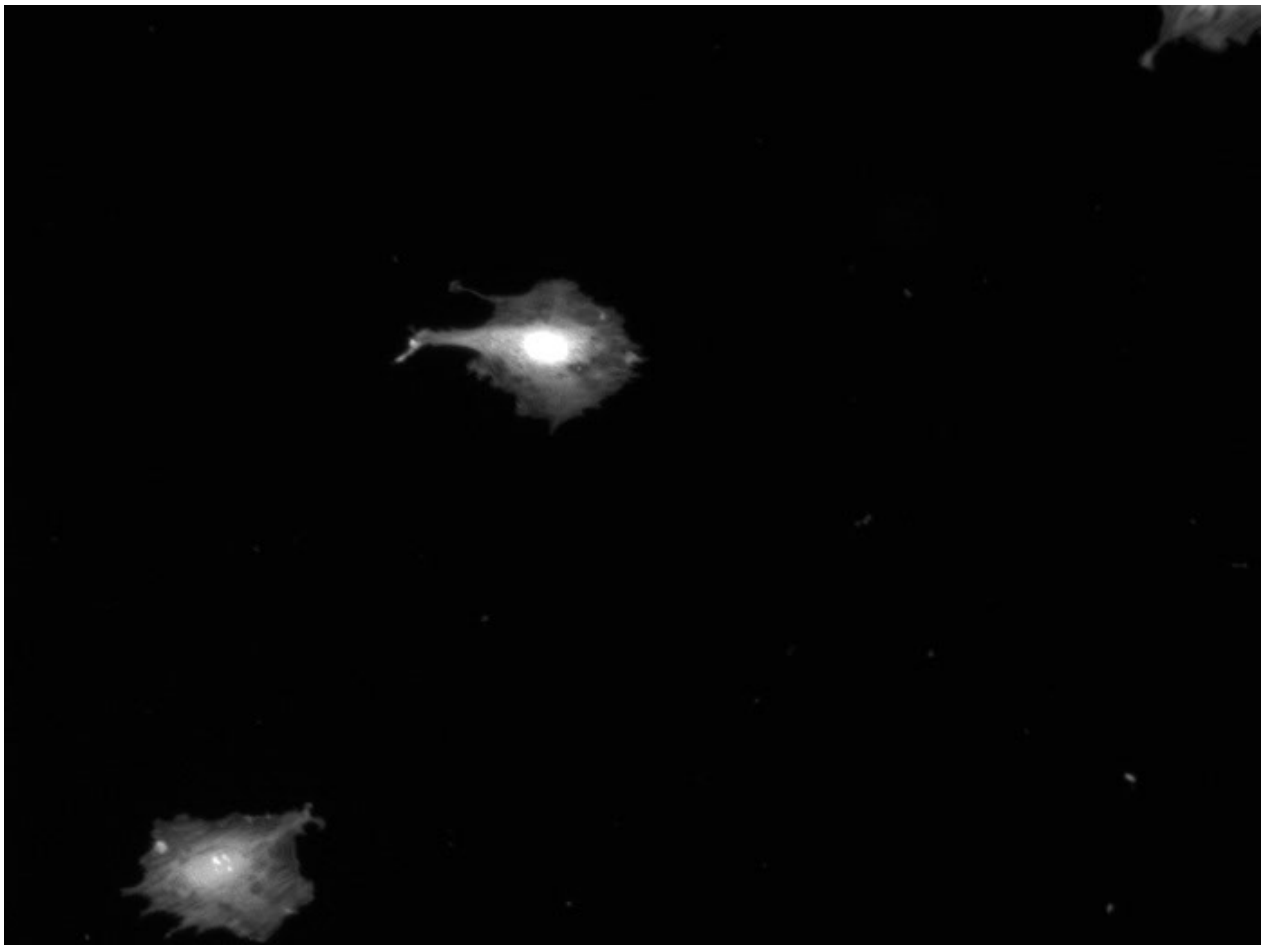

IWFCE_A10MedOptWell1_0011.png

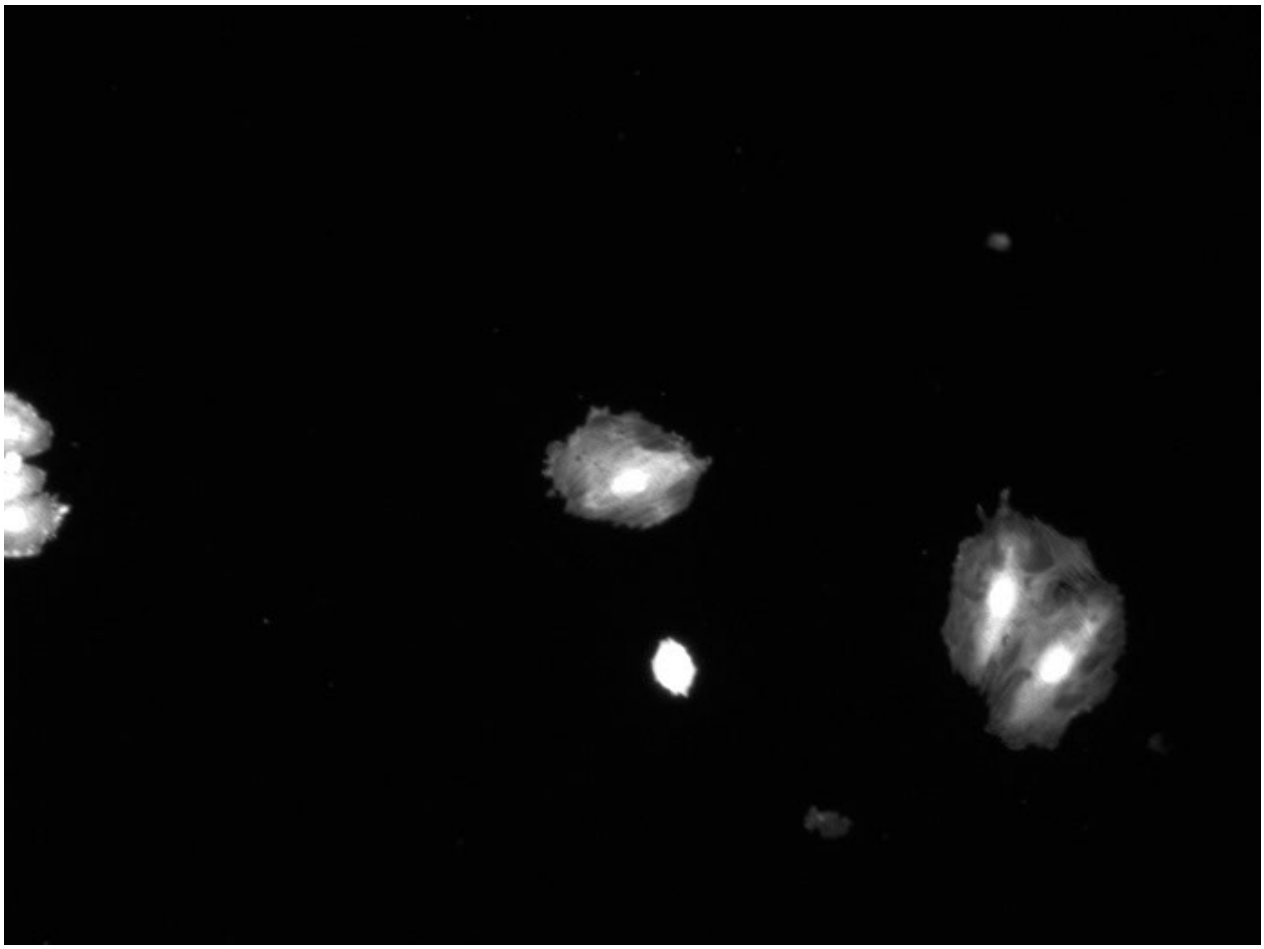

IWFCE_A10MedOptWell1_0012.png

IWFCE_A10MedOptWell1_0013.png

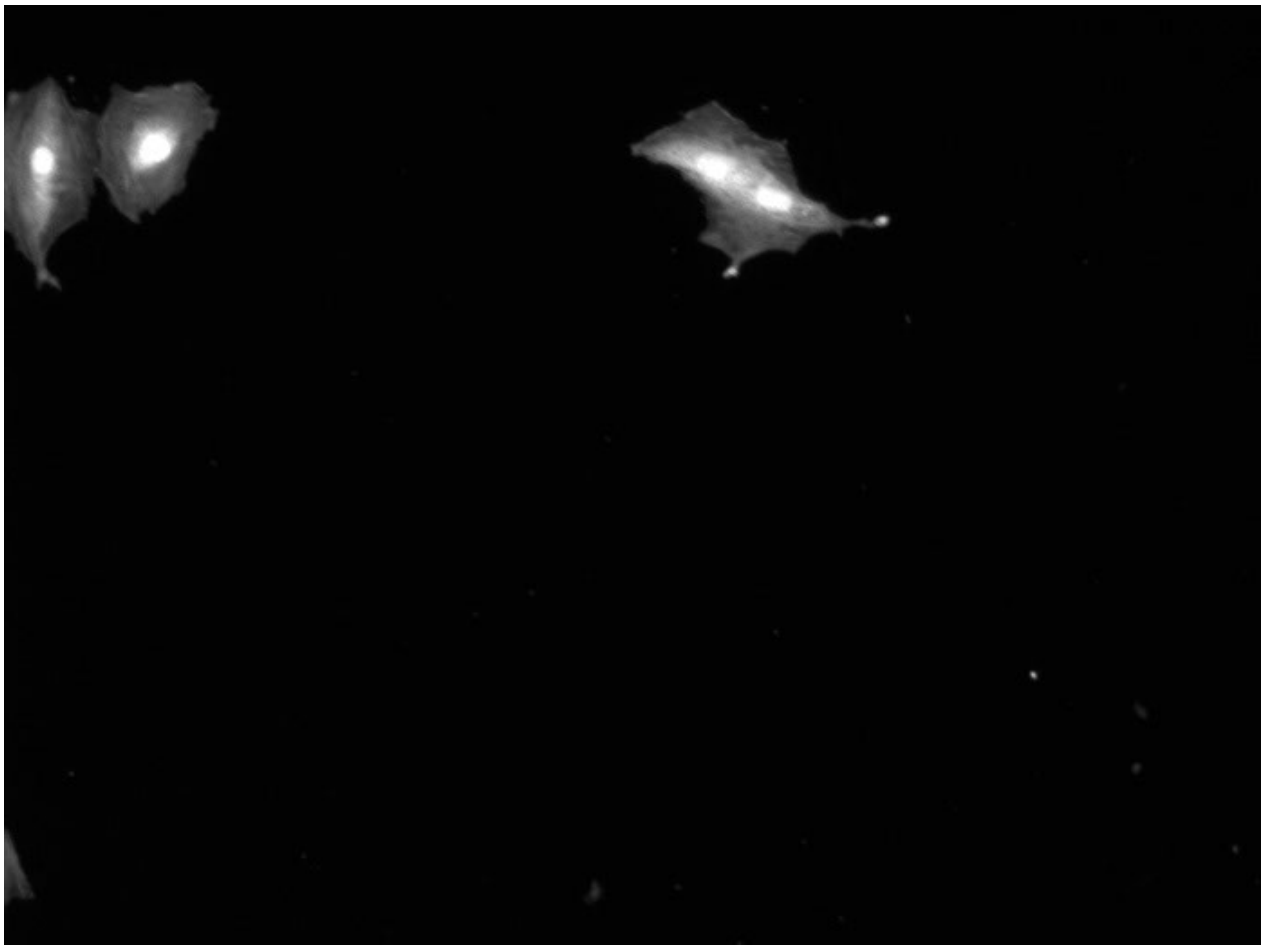

IWFCE_A10MedOptWell1_0014.png

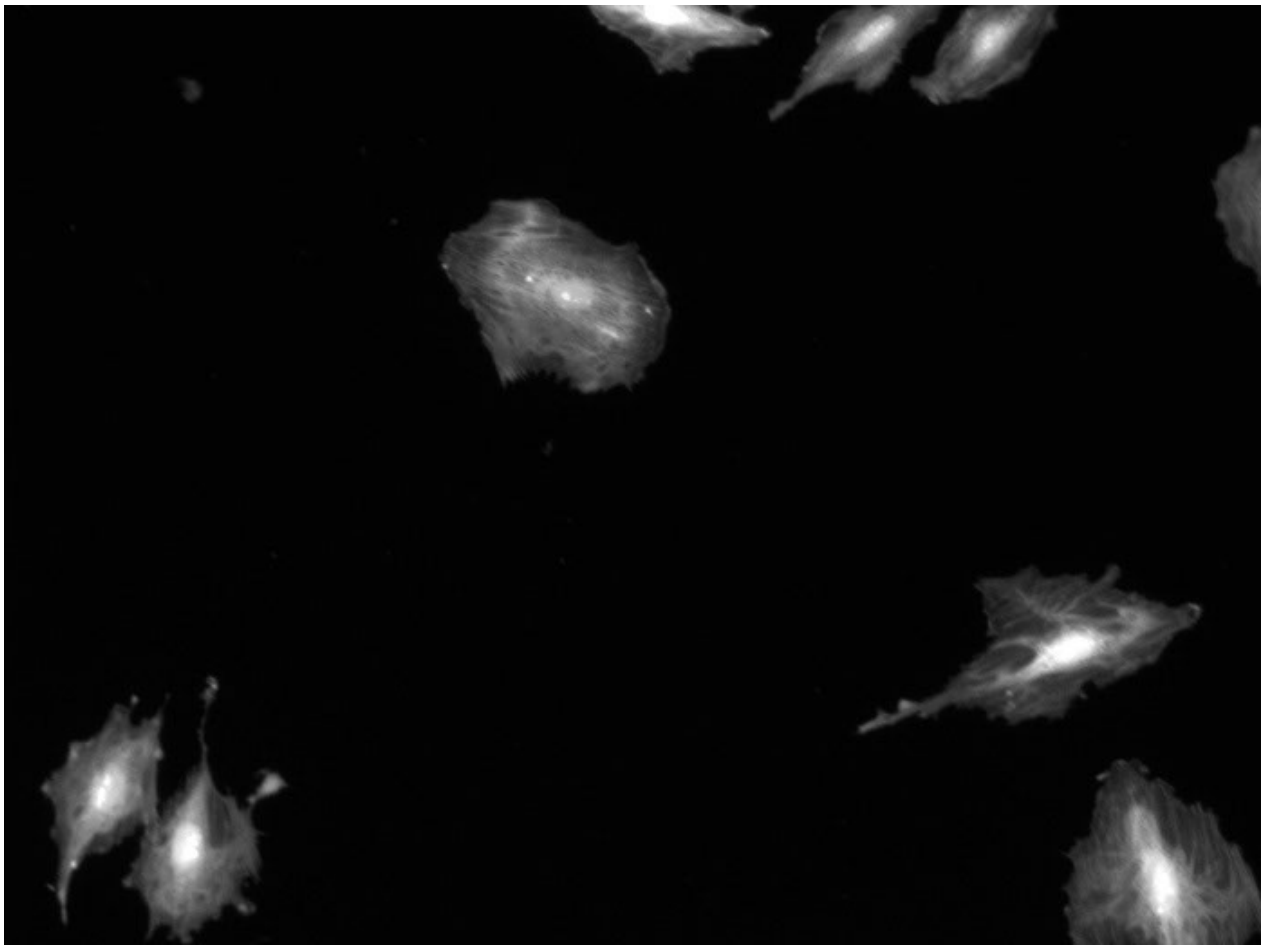

IWFCE_A10MedOptWell1_0015.png

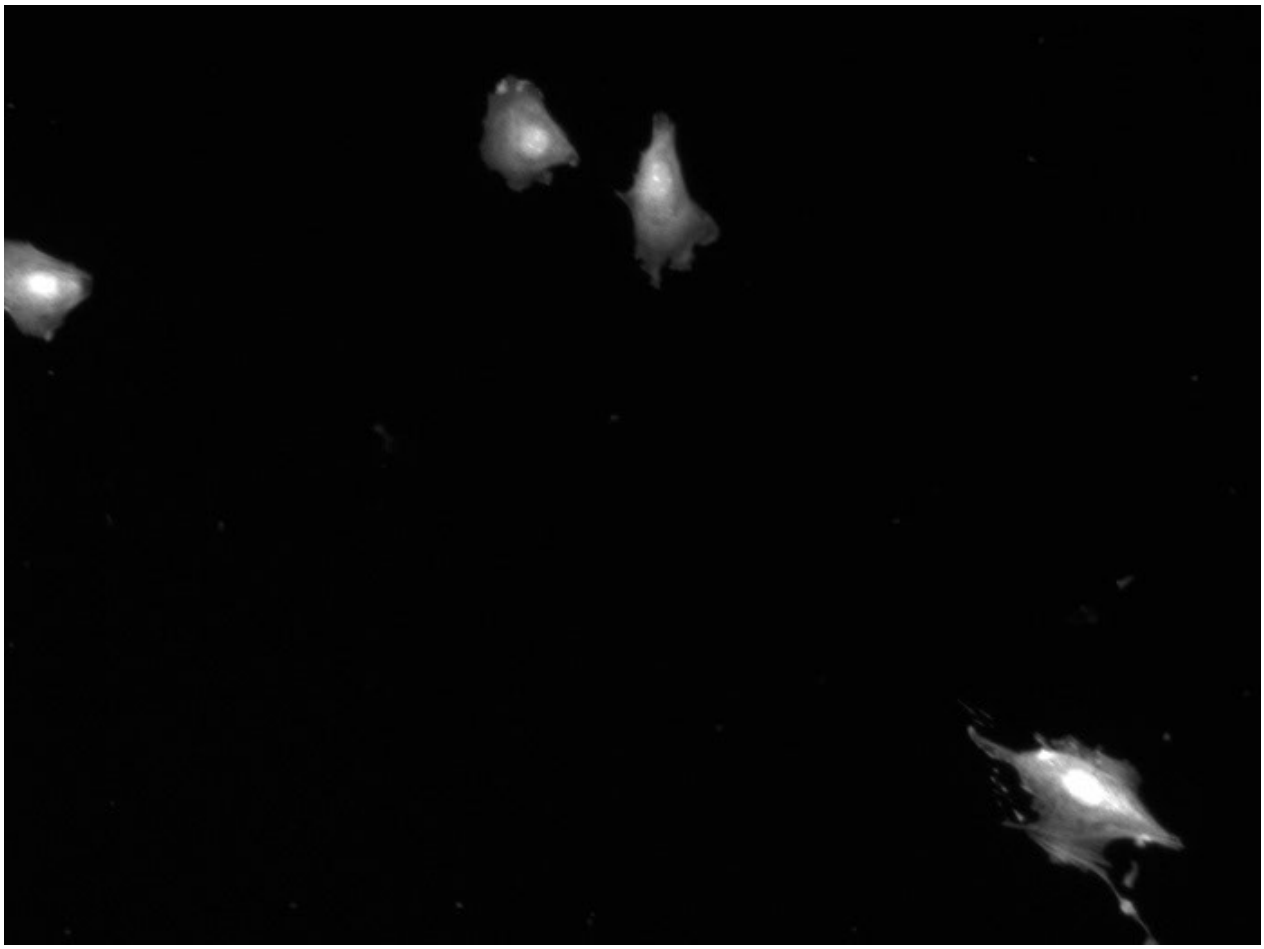

IWFCE_A10MedOptWell1_0016.png

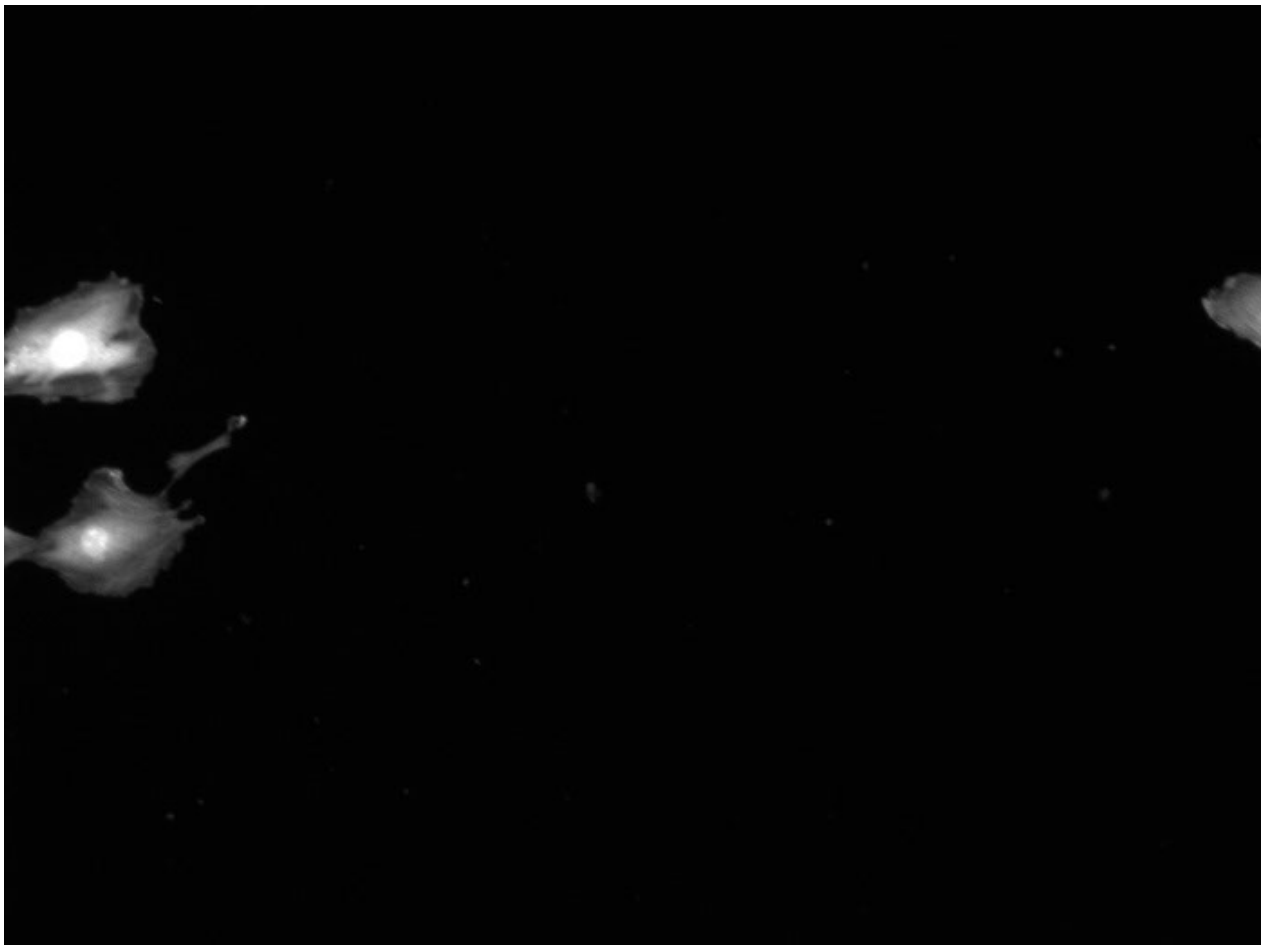

IWFCE_A10MedOptWell1_0017.png

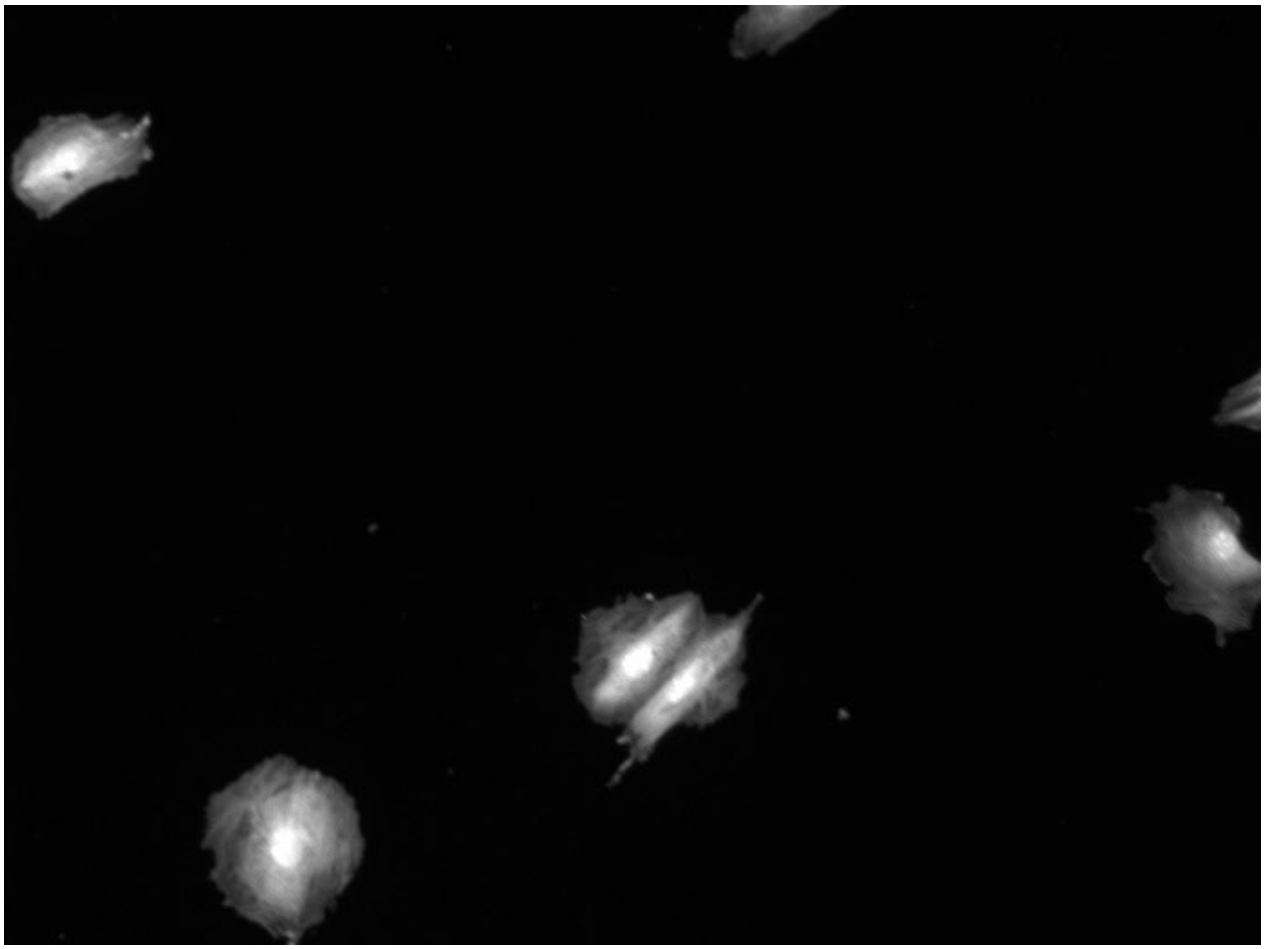

IWFCE_A10MedOptWell1_0018.png

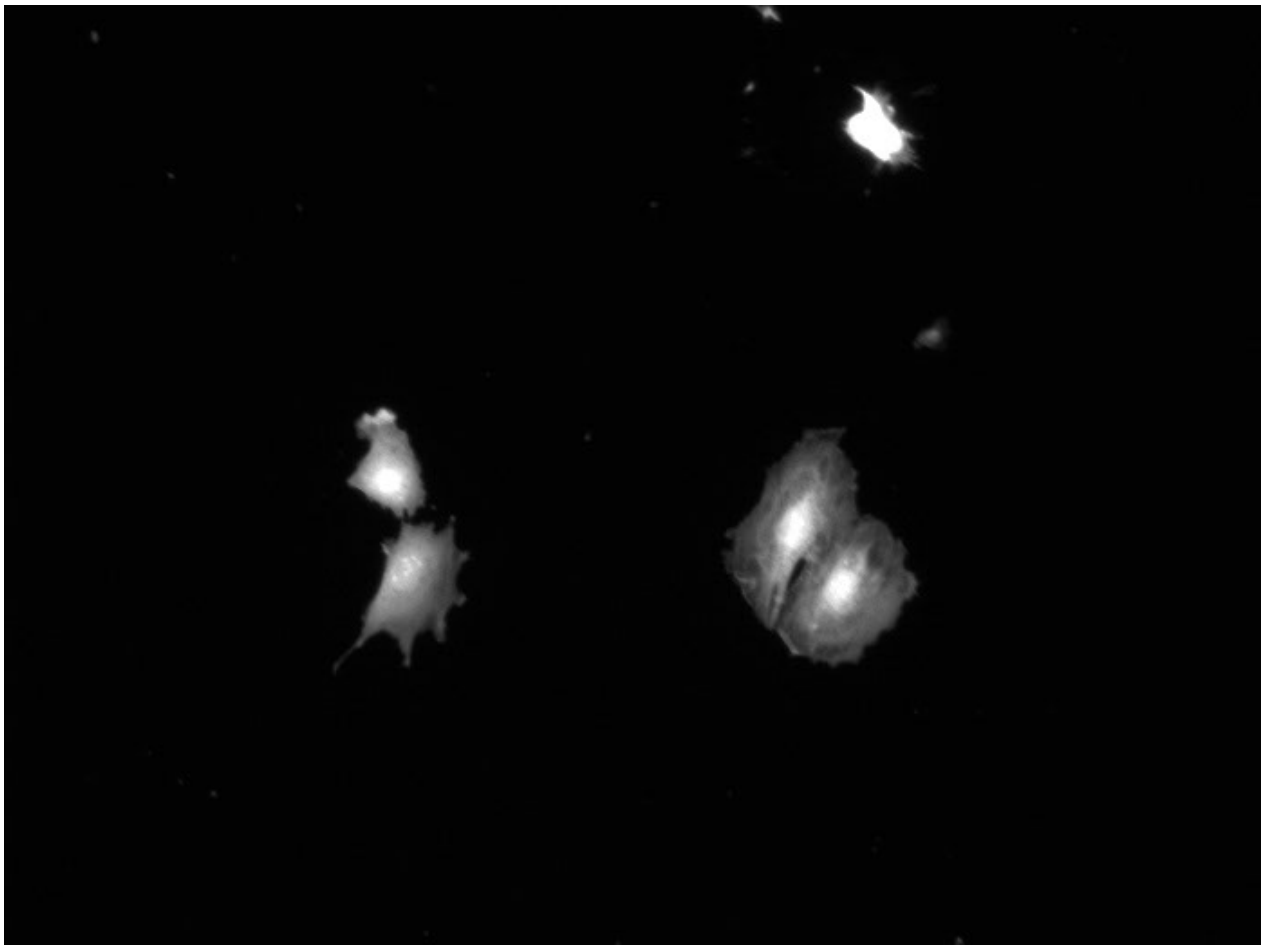

IWFCE_A10MedOptWell1_0019.png

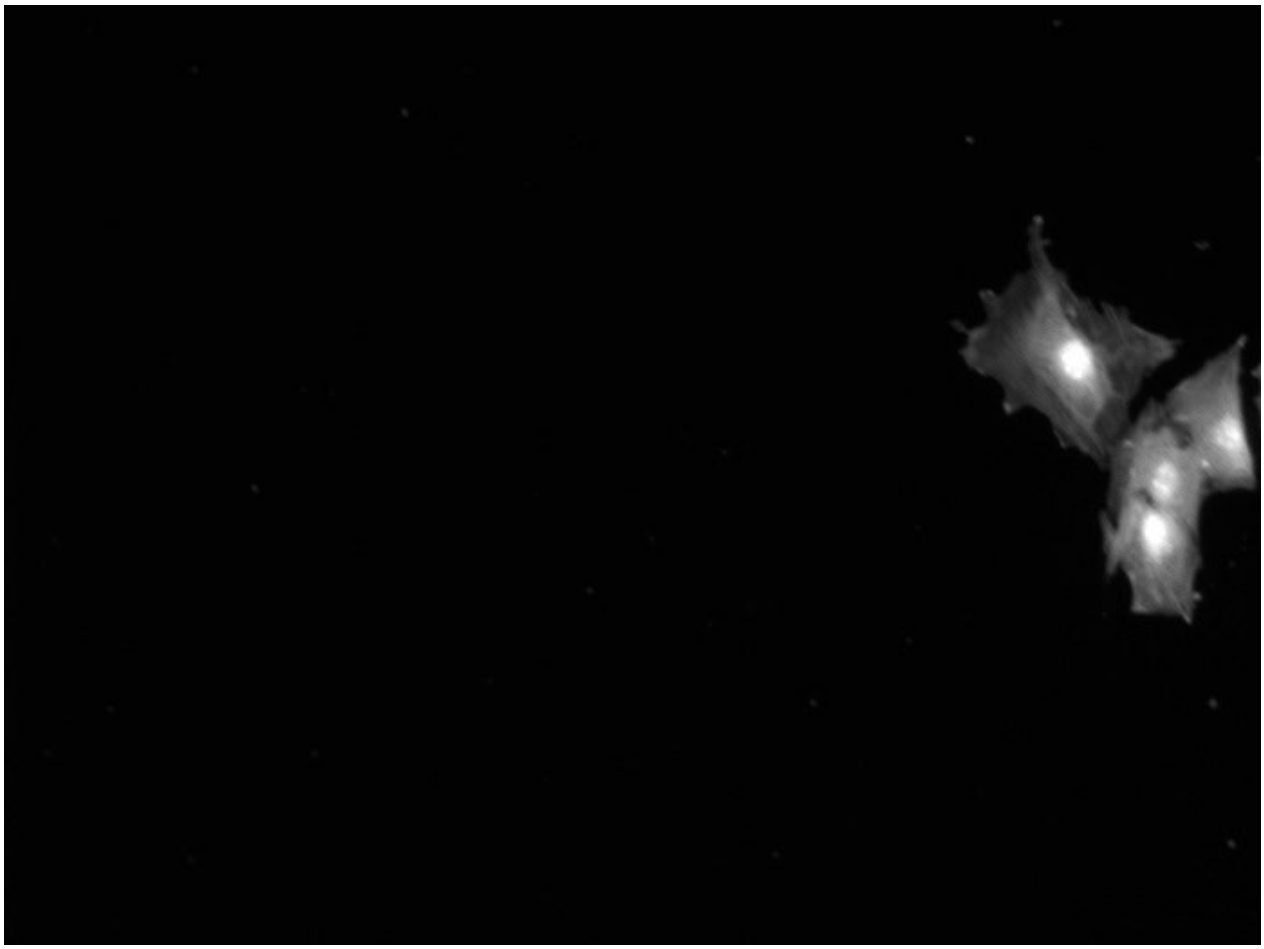

IWFCE_A10MedOptWell1_0020.png

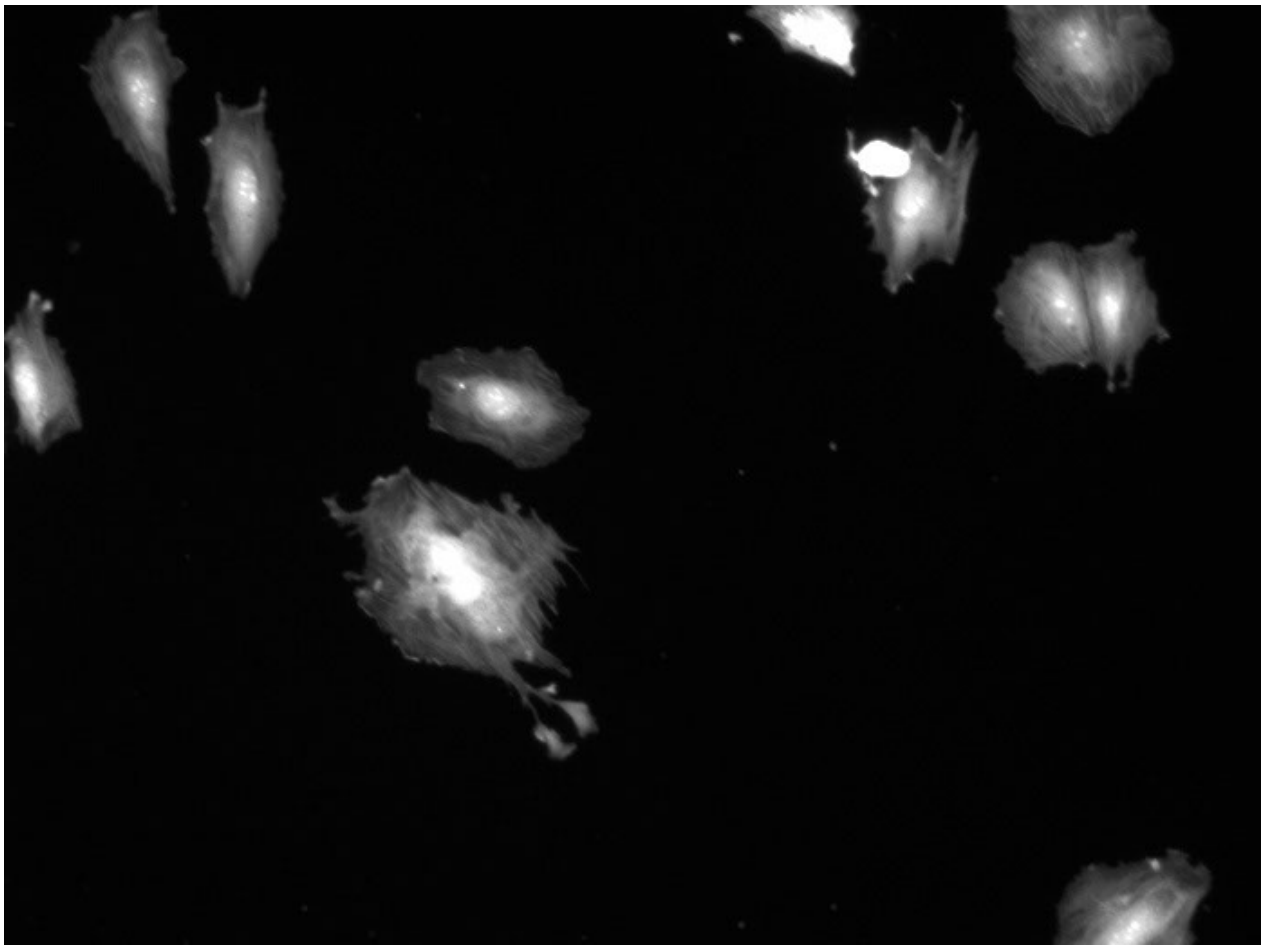

IWFCE_A10MedOptWell1_0021.png

IWFCE_A10MedOptWell1_0022.png

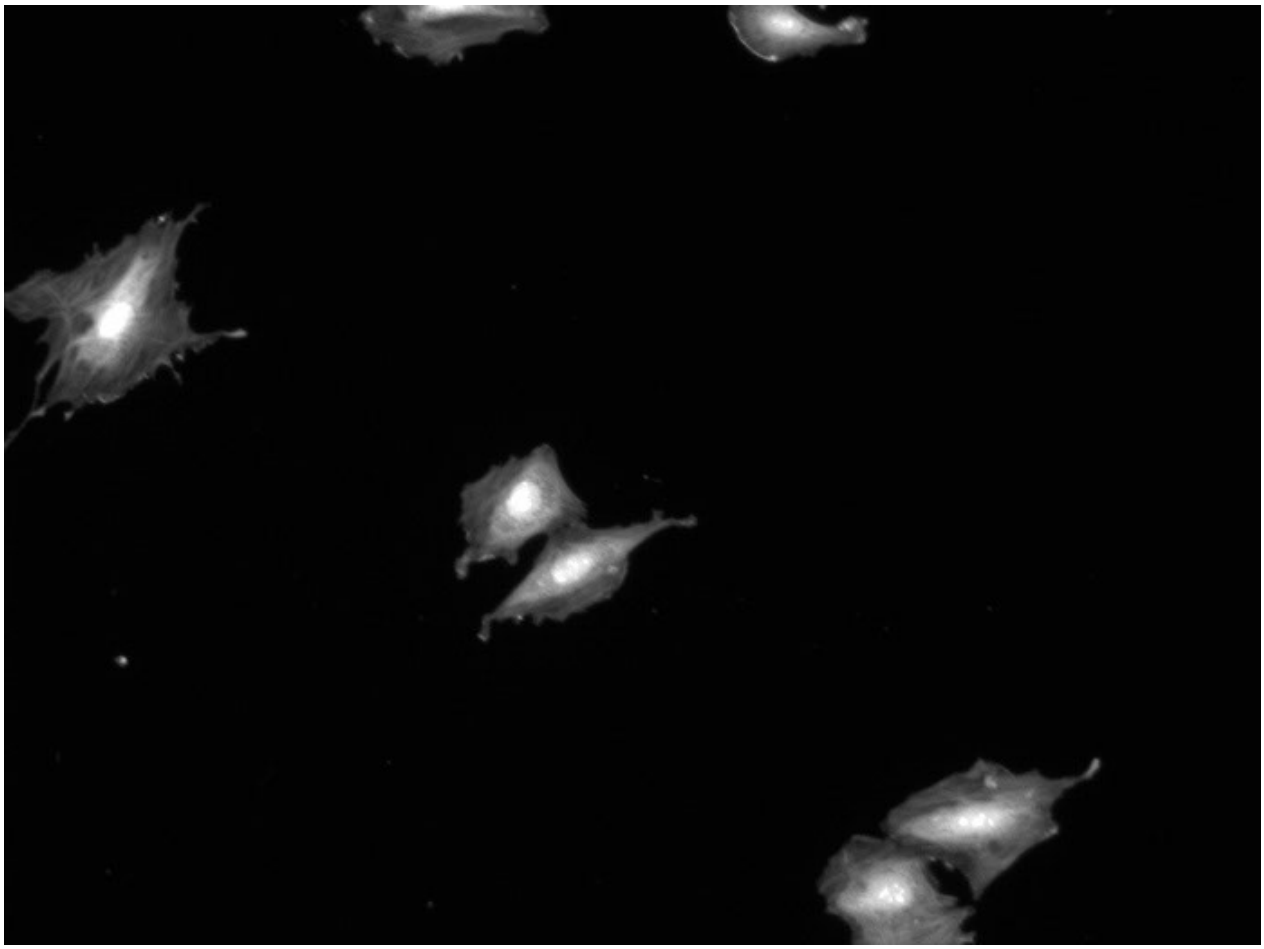

IWFCE_A10MedOptWell1_0023.png

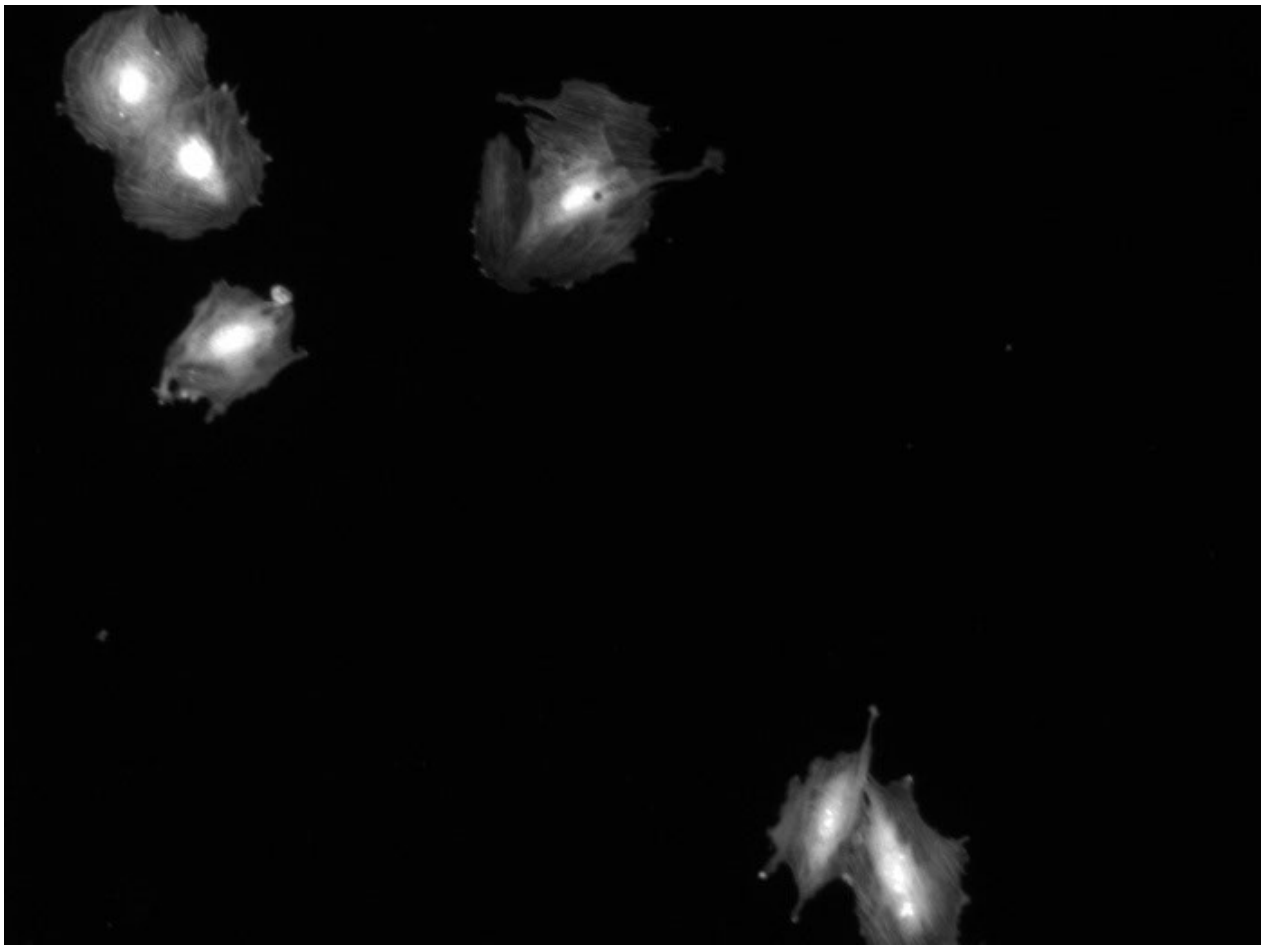

IWFCE_A10MedOptWell1_0024.png

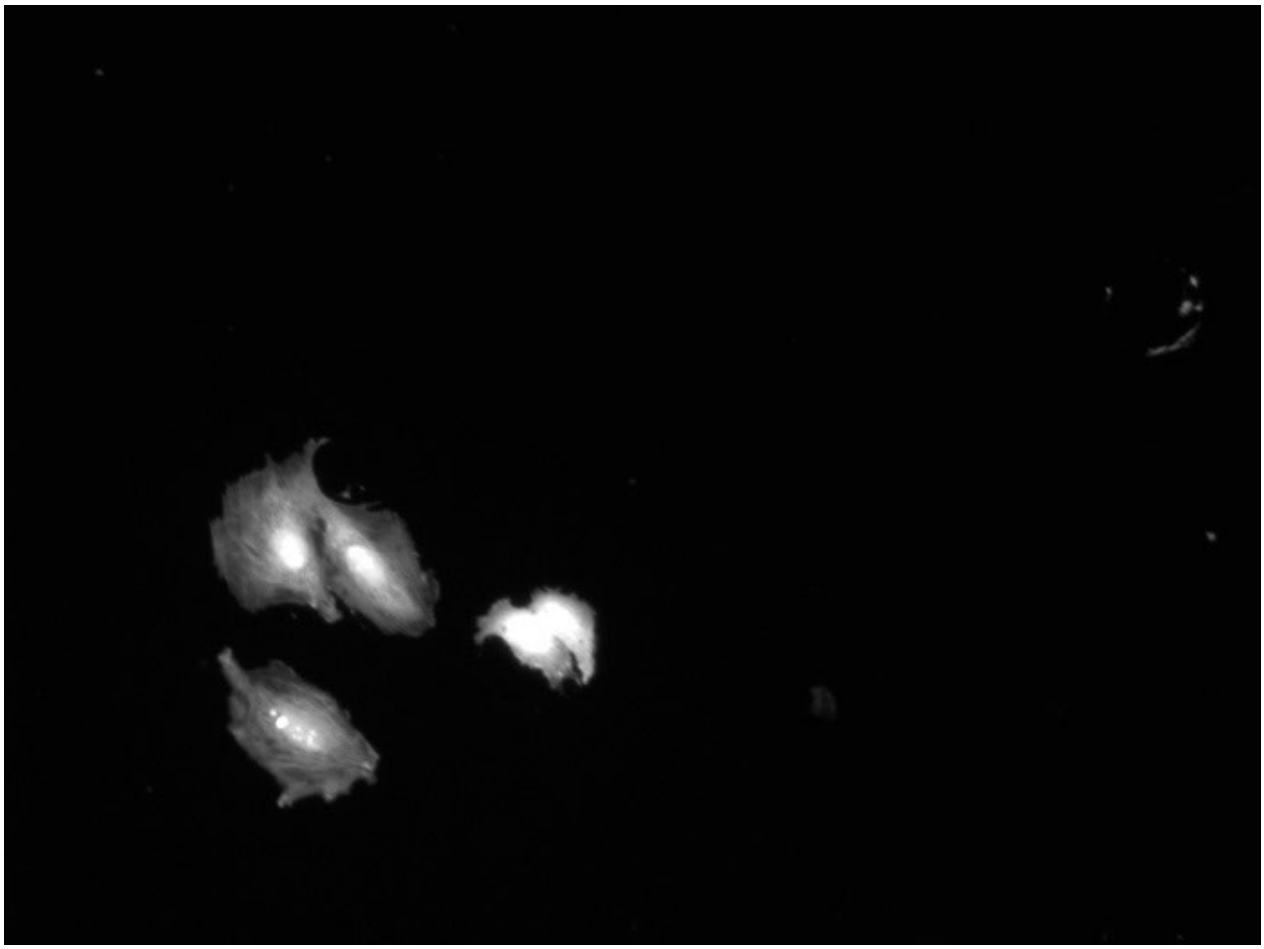

IWFCE_A10MedOptWell1_0025.png

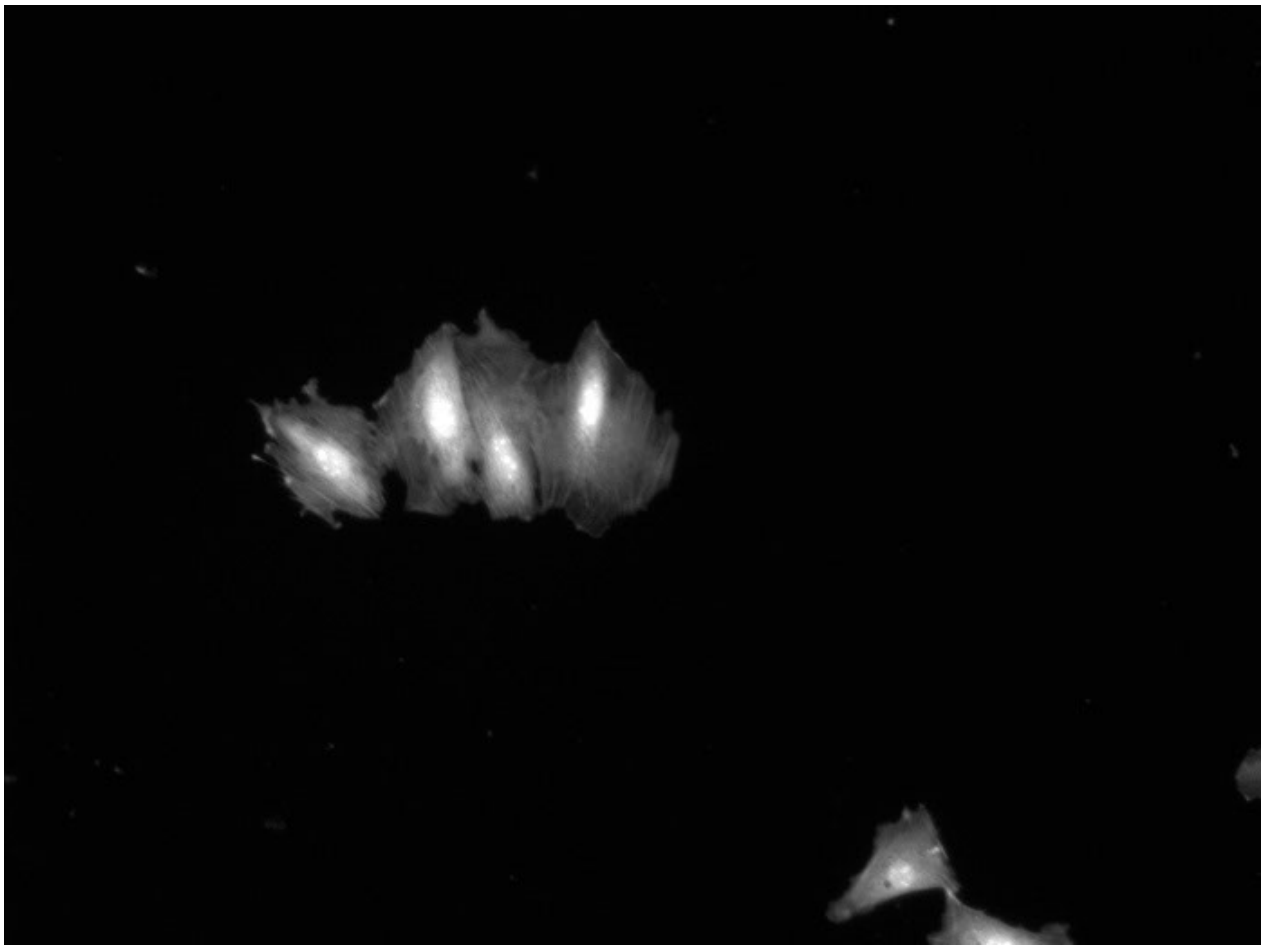

IWFCE_A10MedOptWell1_0026.png

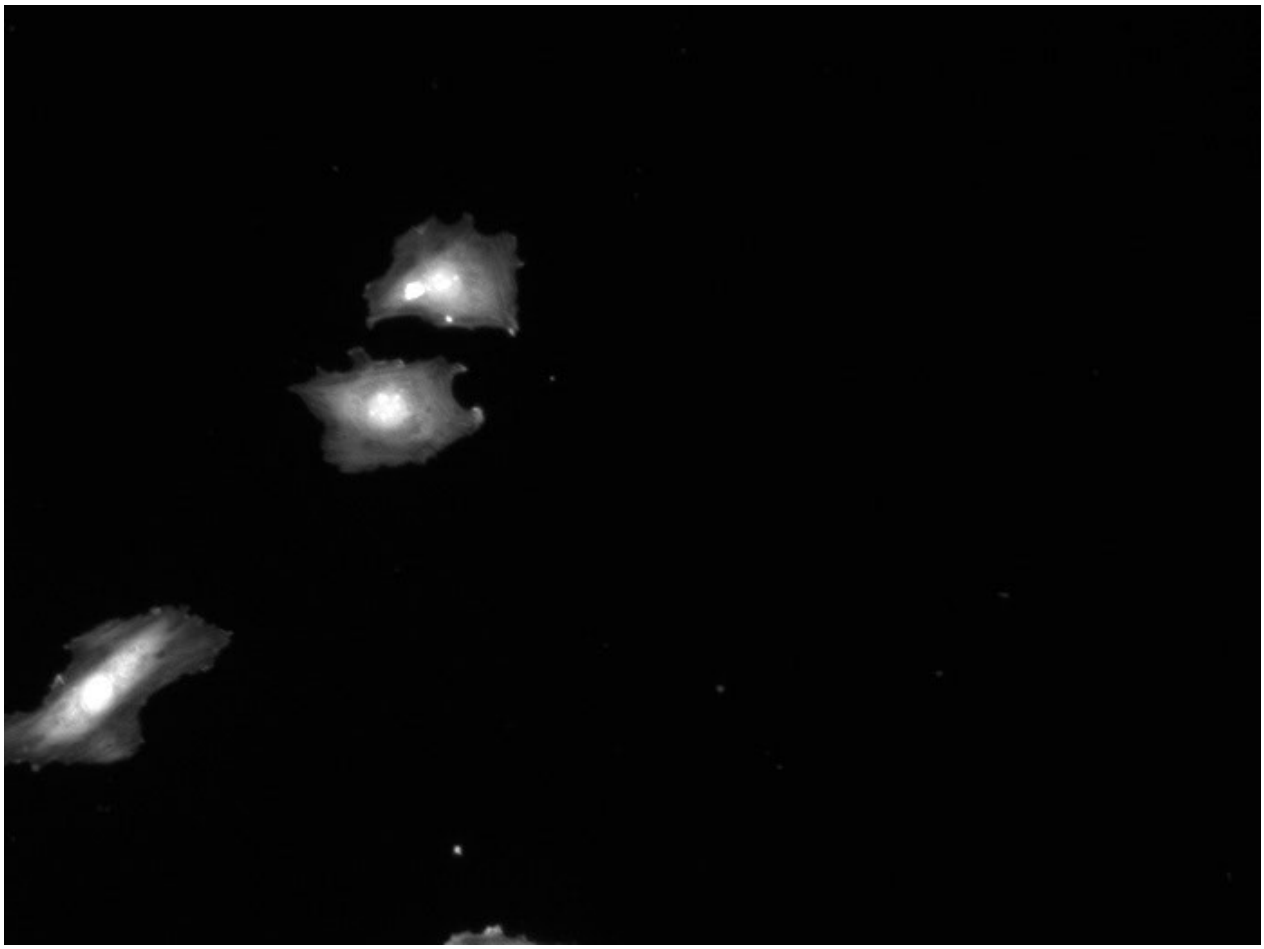

IWFCE_A10MedOptWell1_0027.png

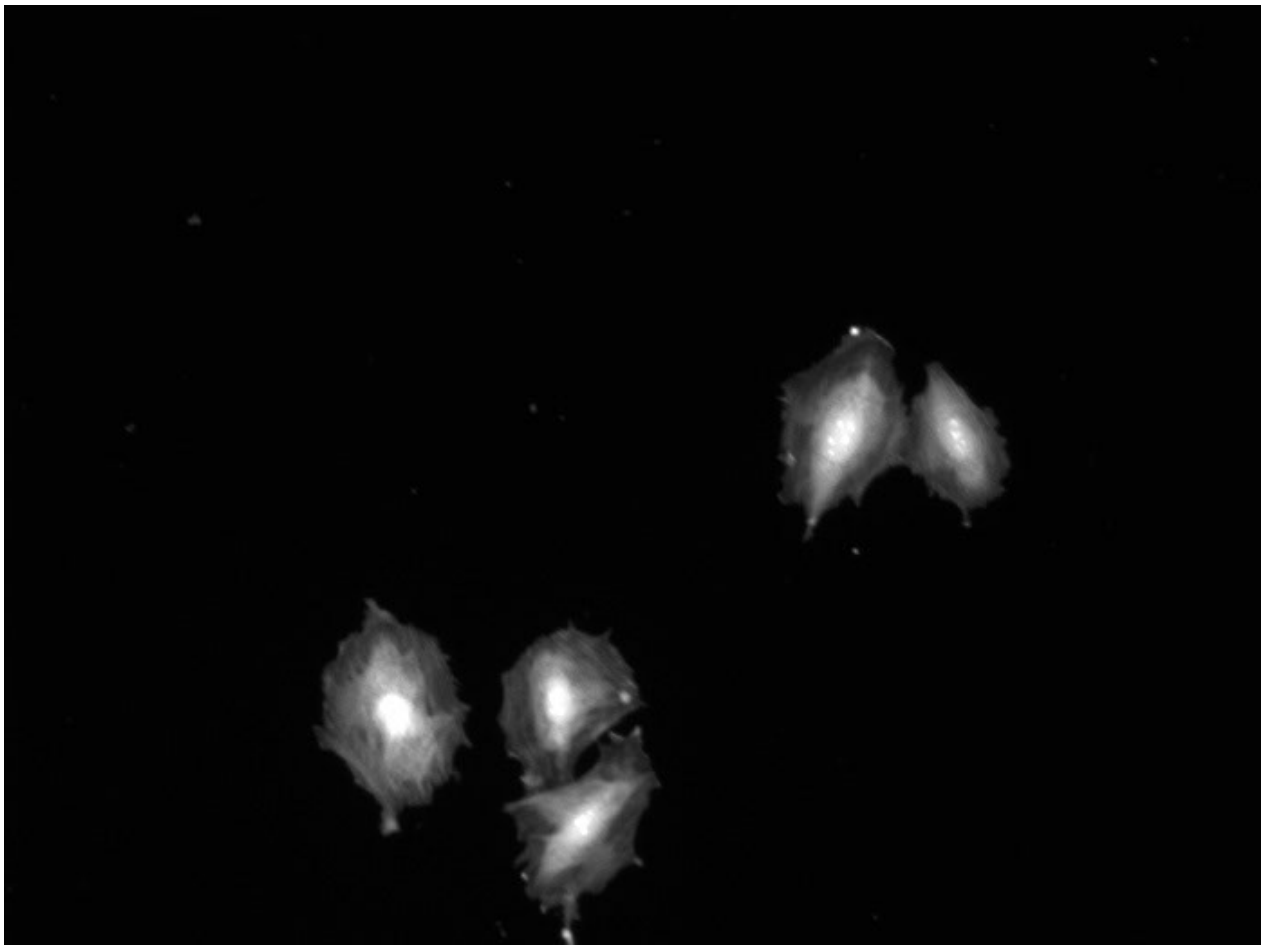

IWFCE_A10MedOptWell1_0028.png

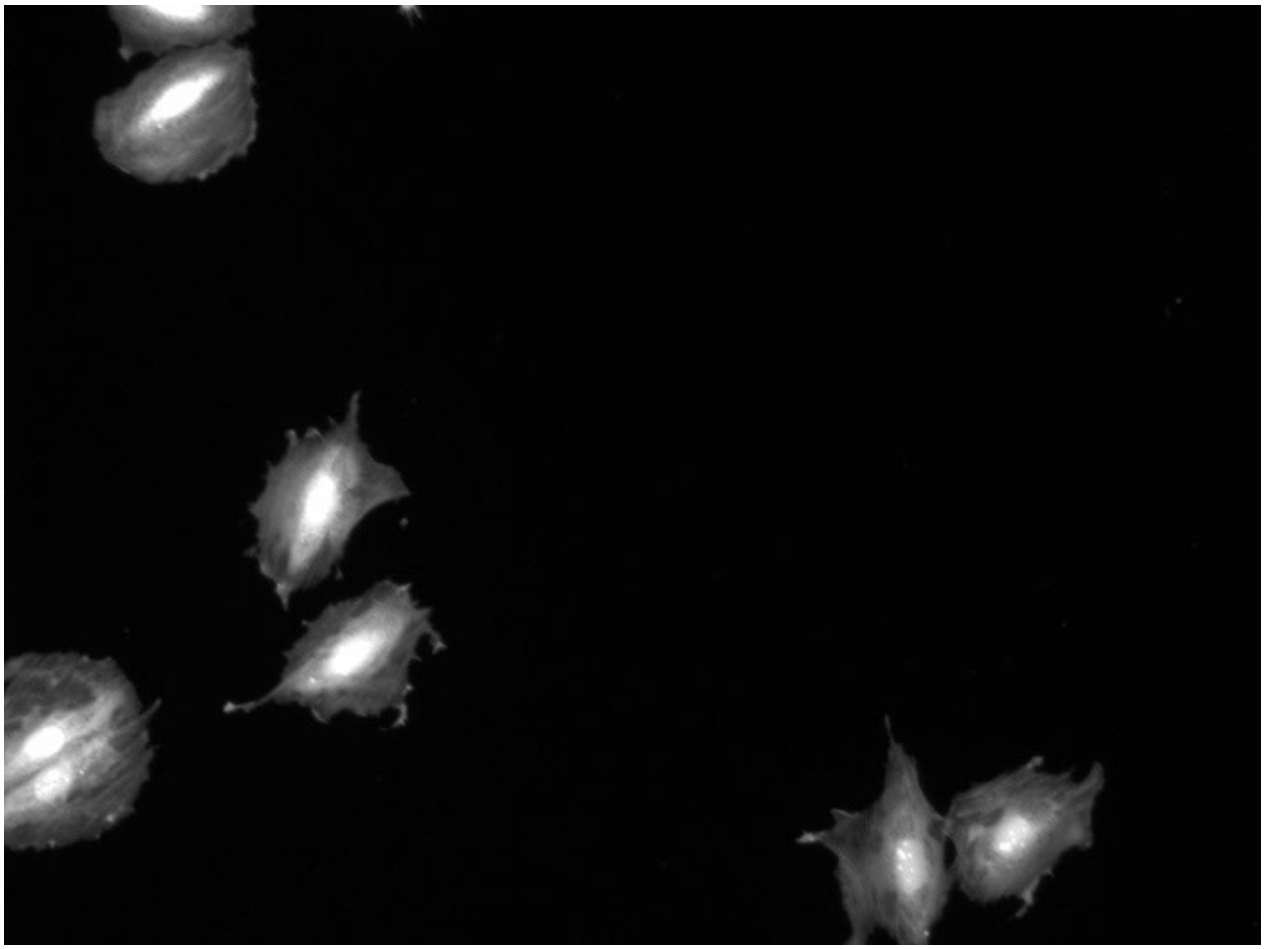

IWFCE_A10MedOptWell1_0029.png

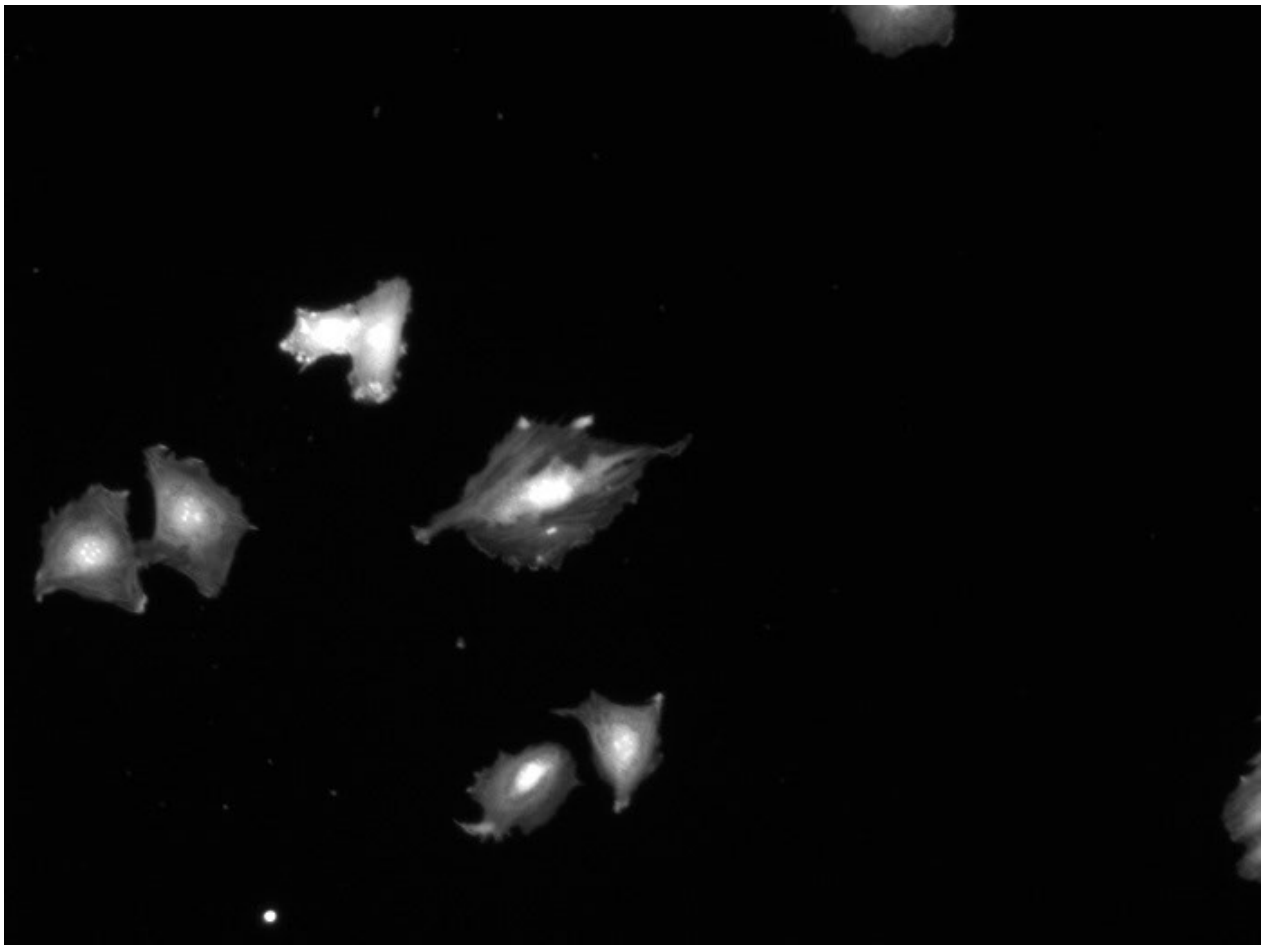

IWFCE_A10MedOptWell1_0030.png

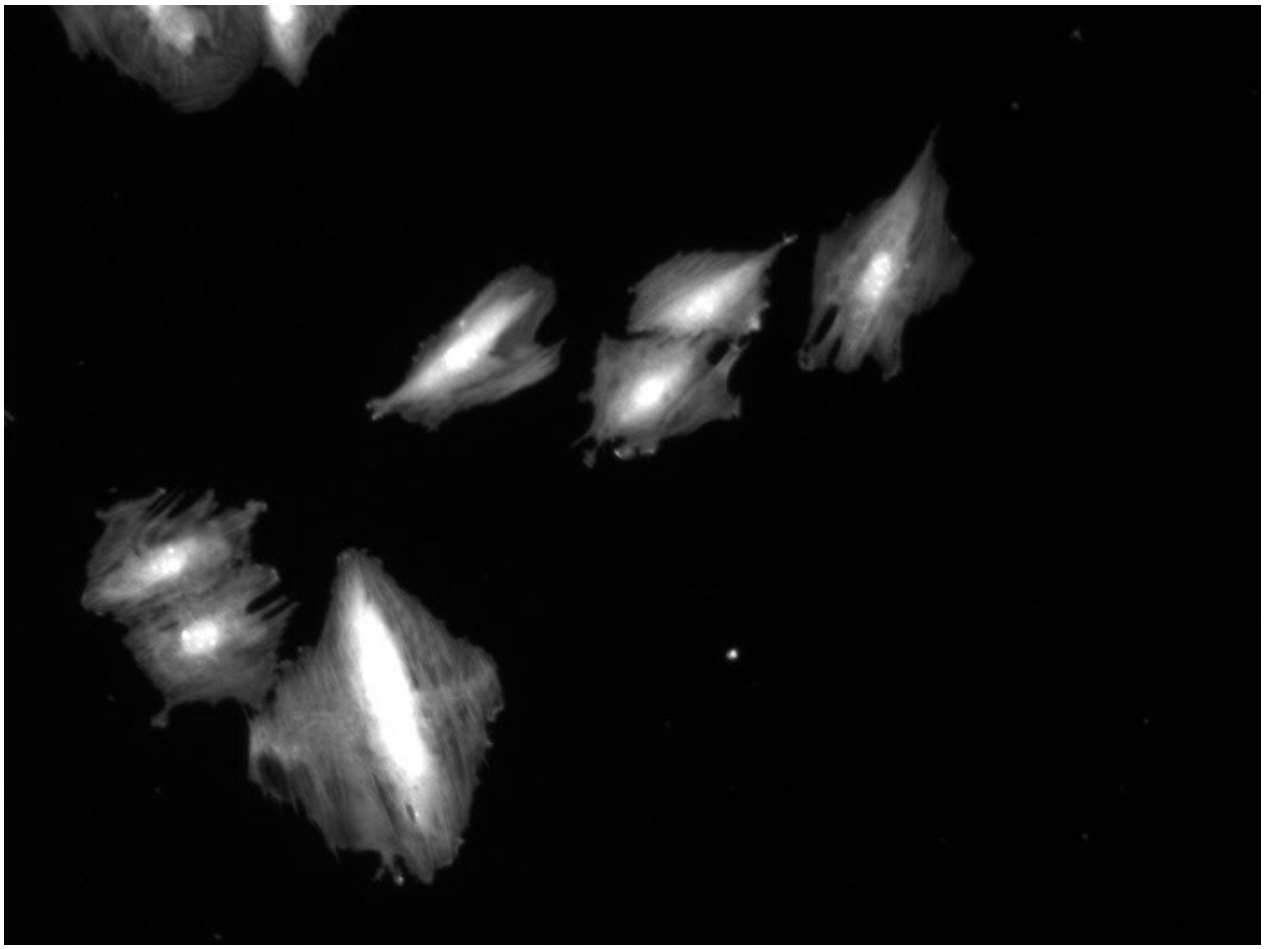

IWFCE_A10MedOptWell1_0031.png

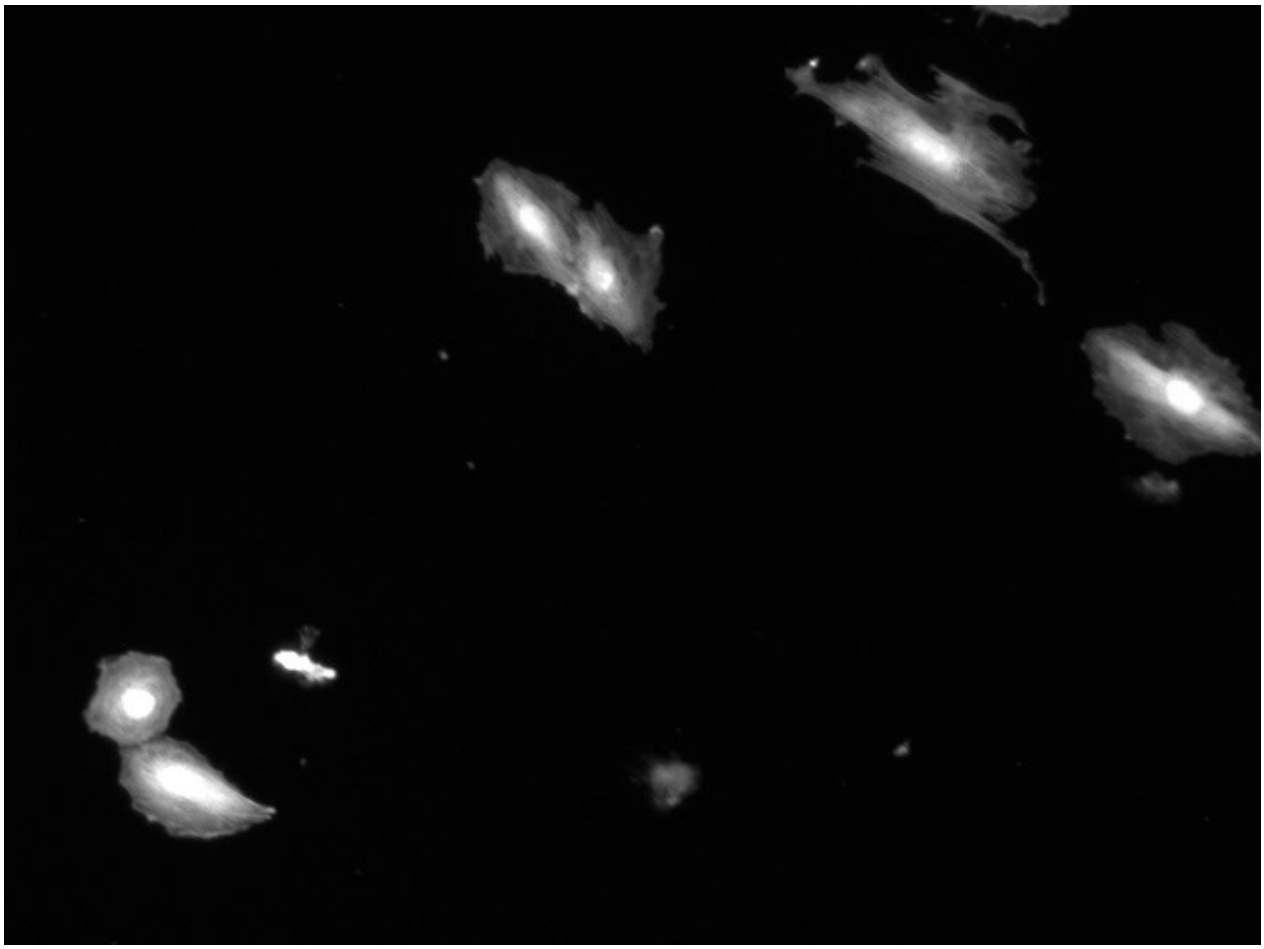

IWFCE_A10MedOptWell1_0032.png

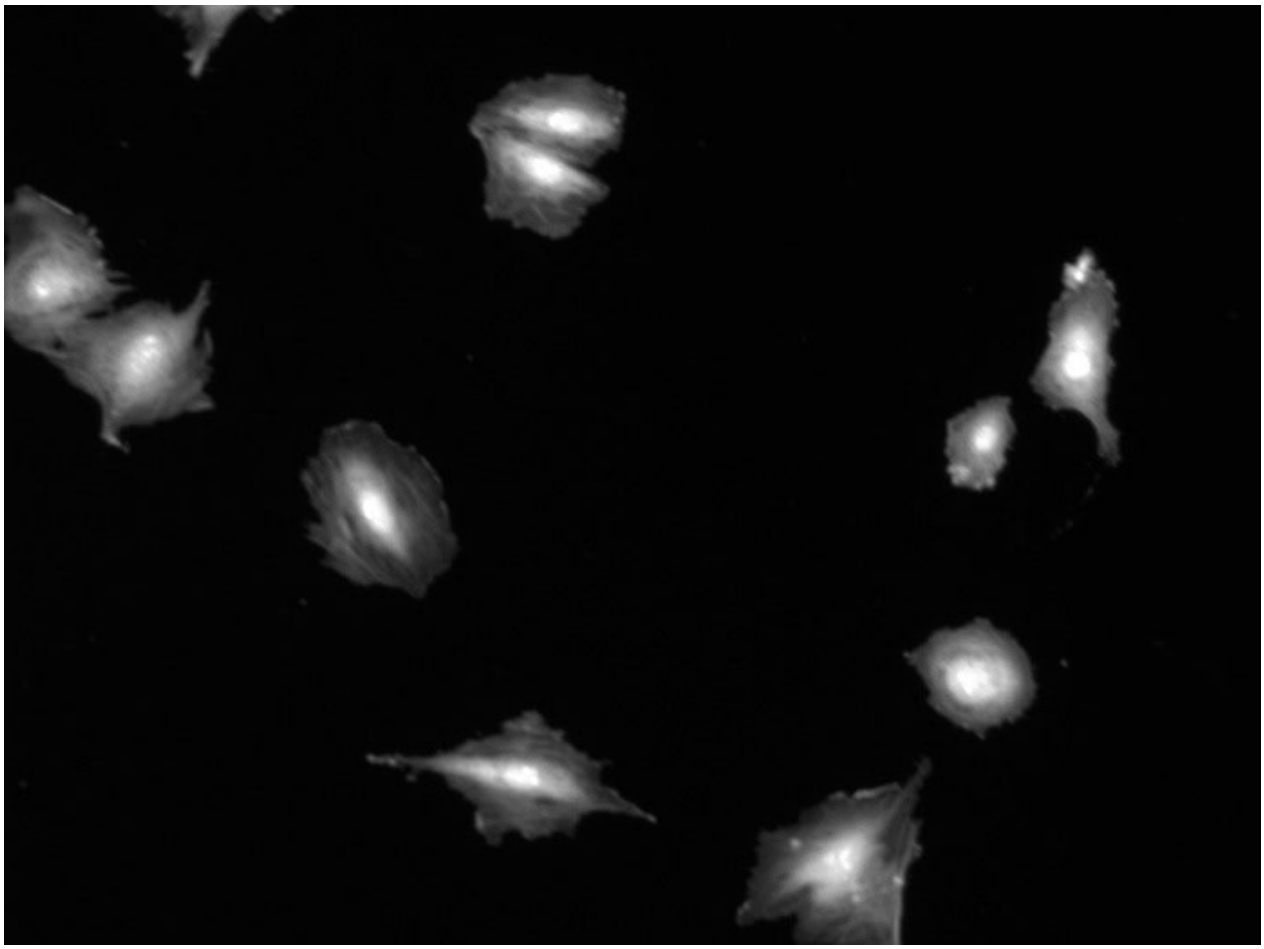

IWFCE_A10MedOptWell1_0033.png

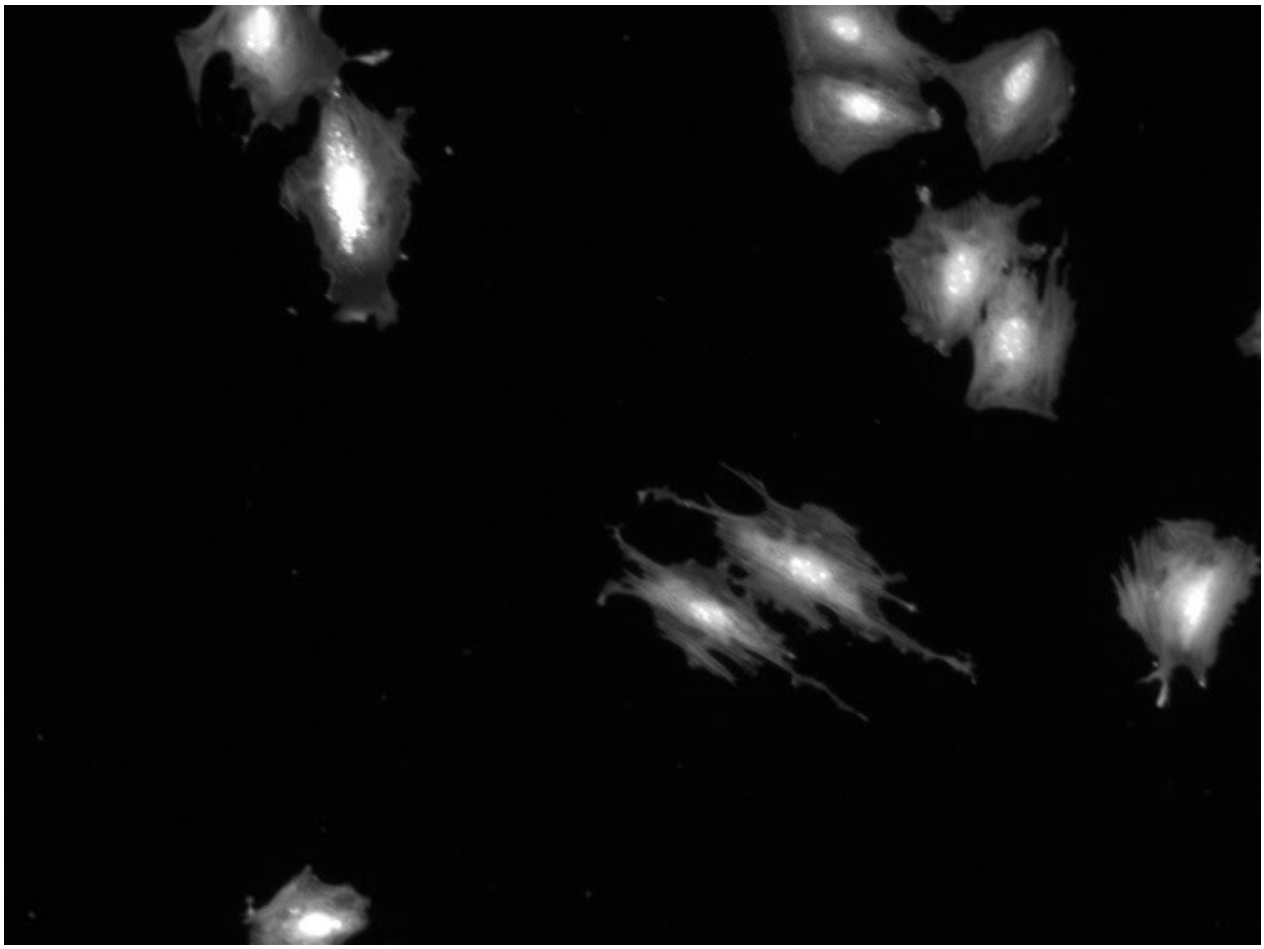

IWFCE_A10MedOptWell1_0034.png

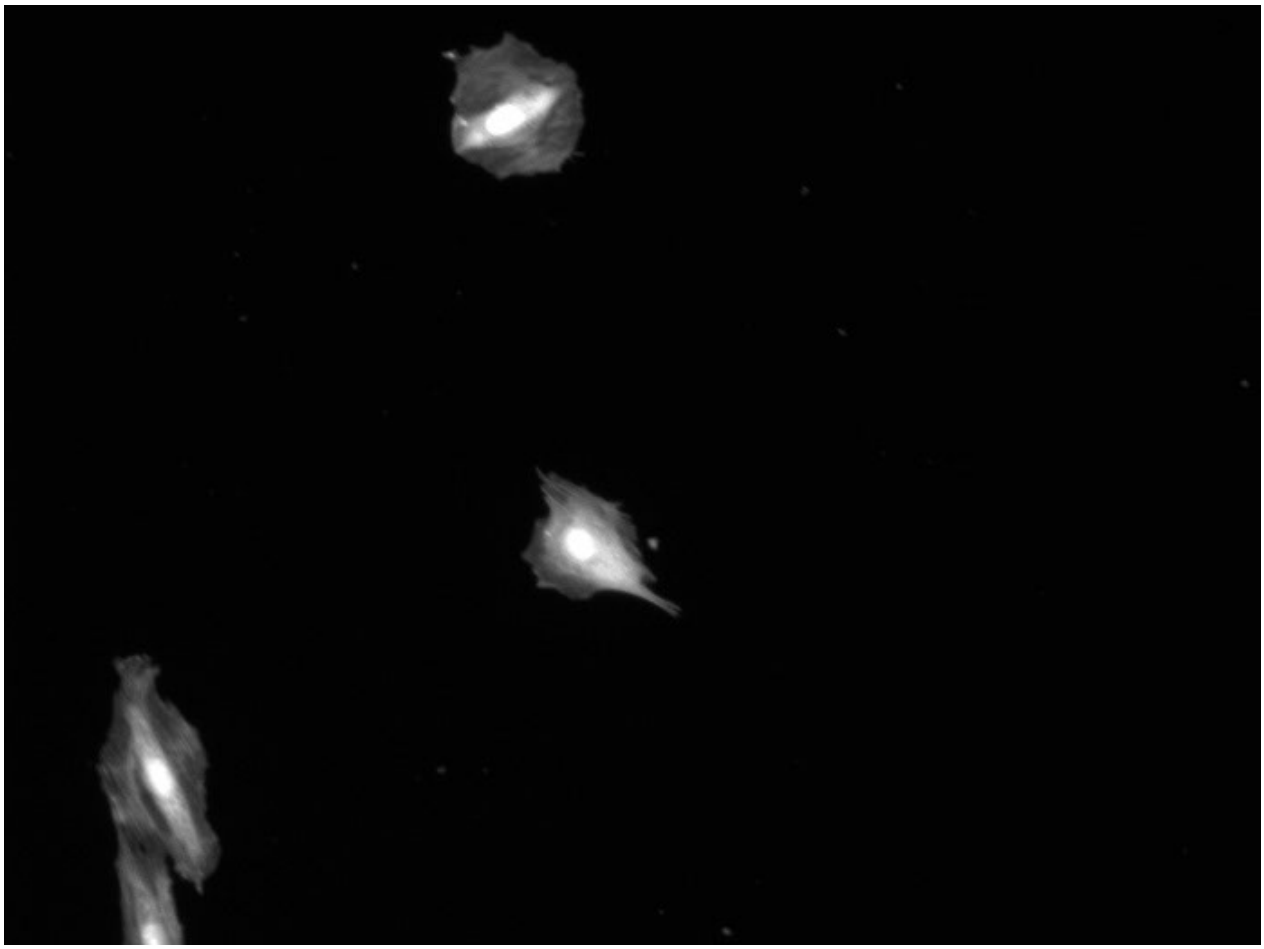

IWFCE_A10MedOptWell1_0035.png

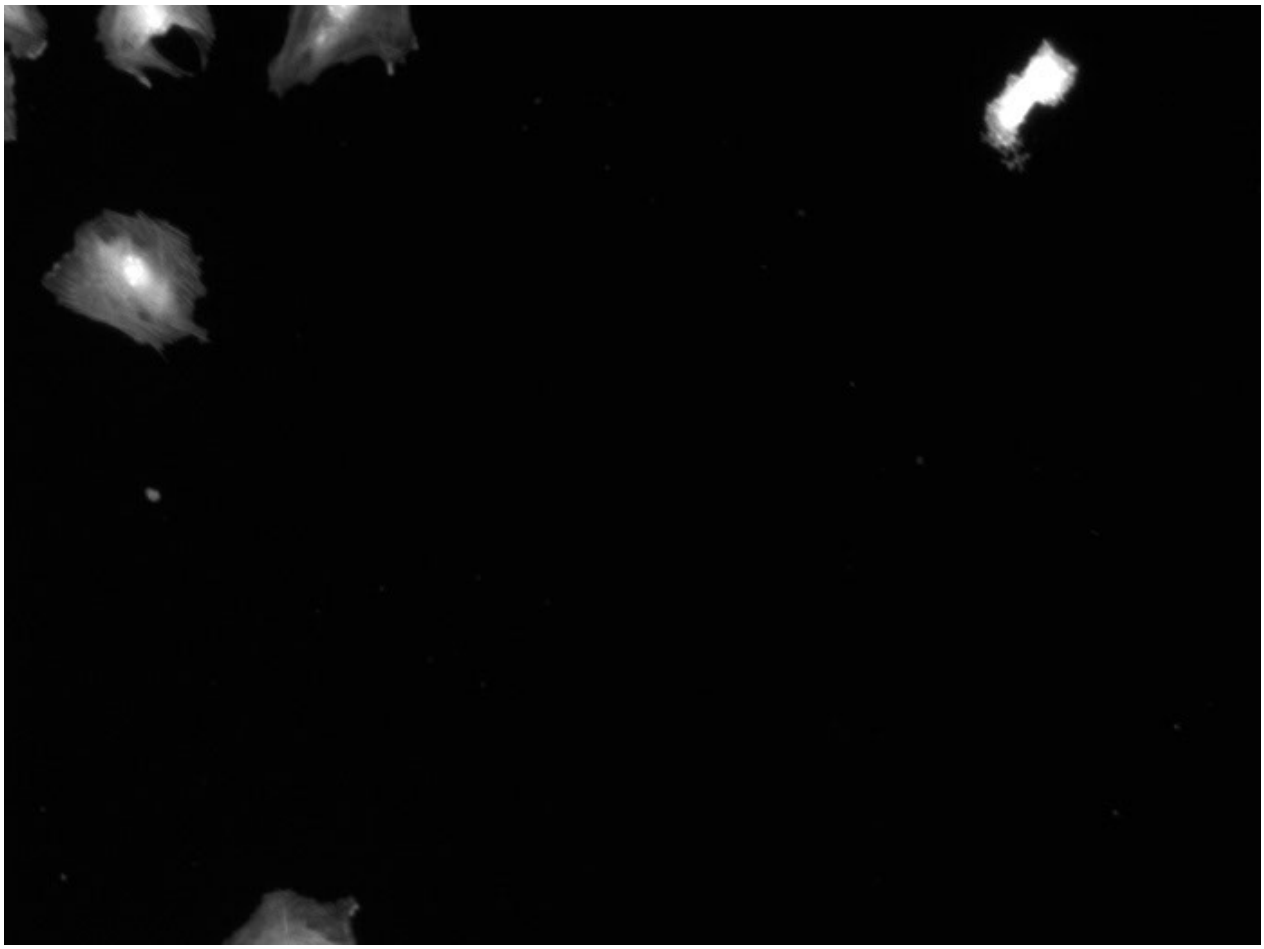

IWFCE_A10MedOptWell1_0036.png

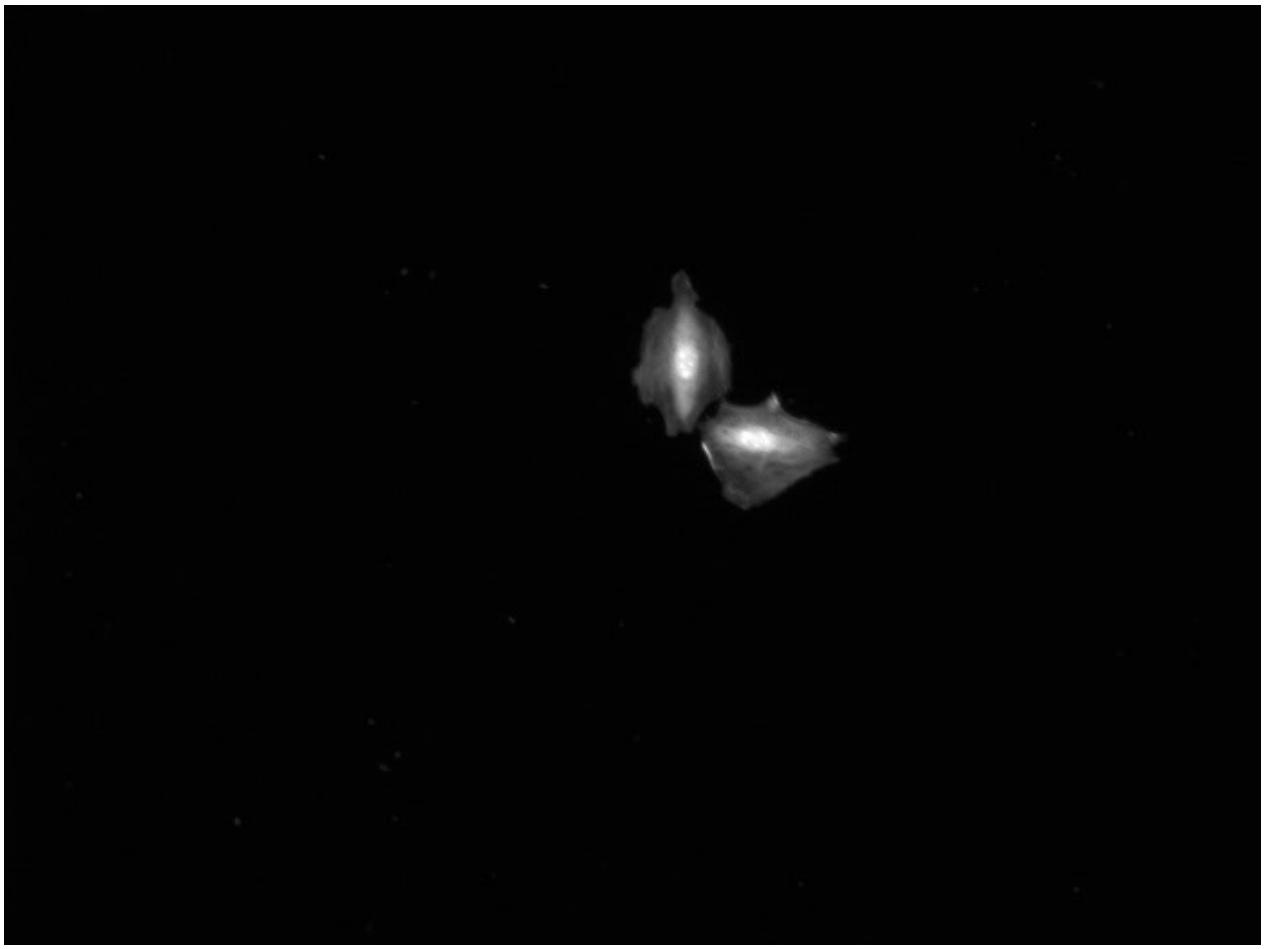

IWFCE_A10MedOptWell1_0037.png

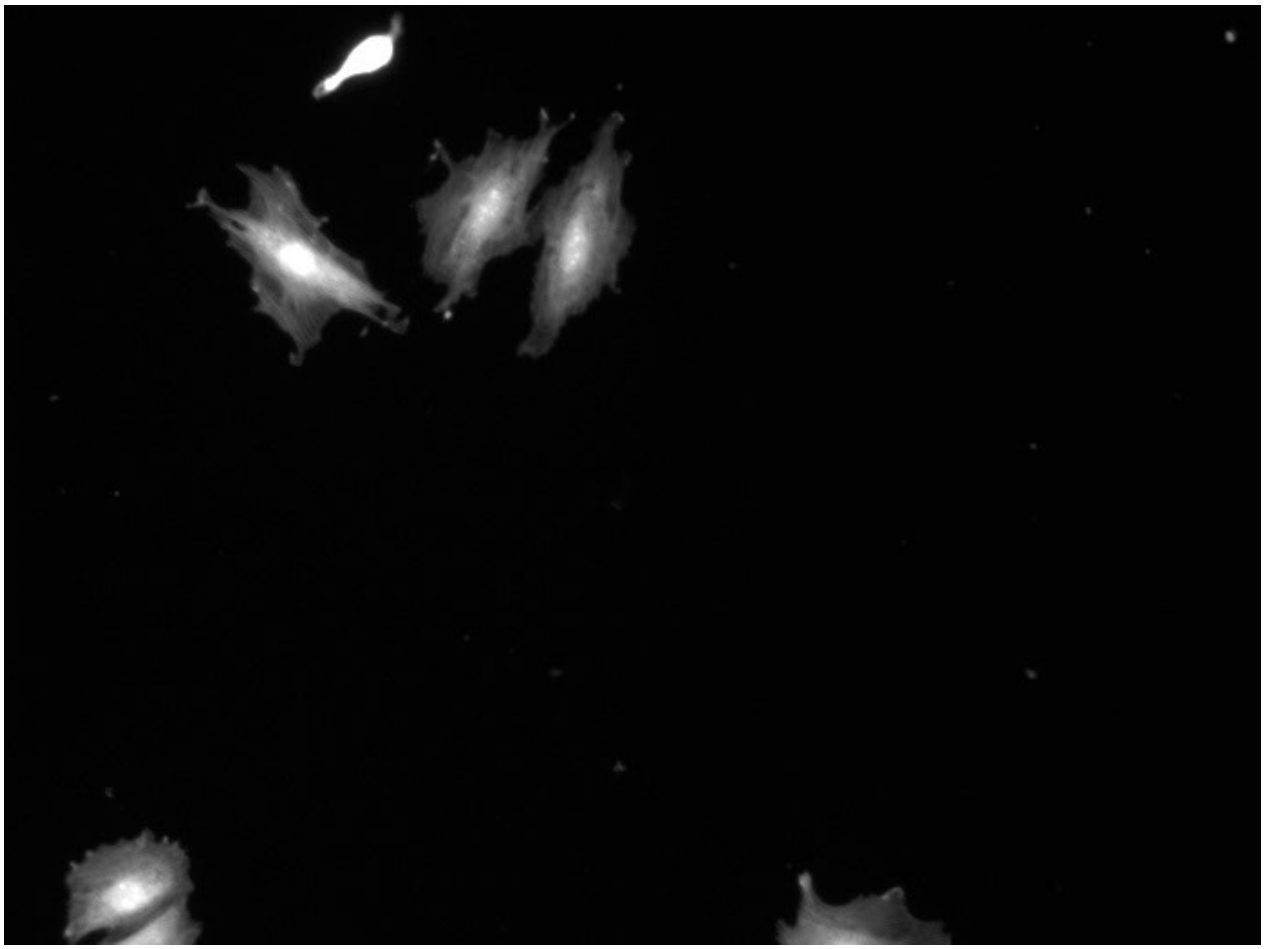

IWFCE_A10MedOptWell1_0038.png

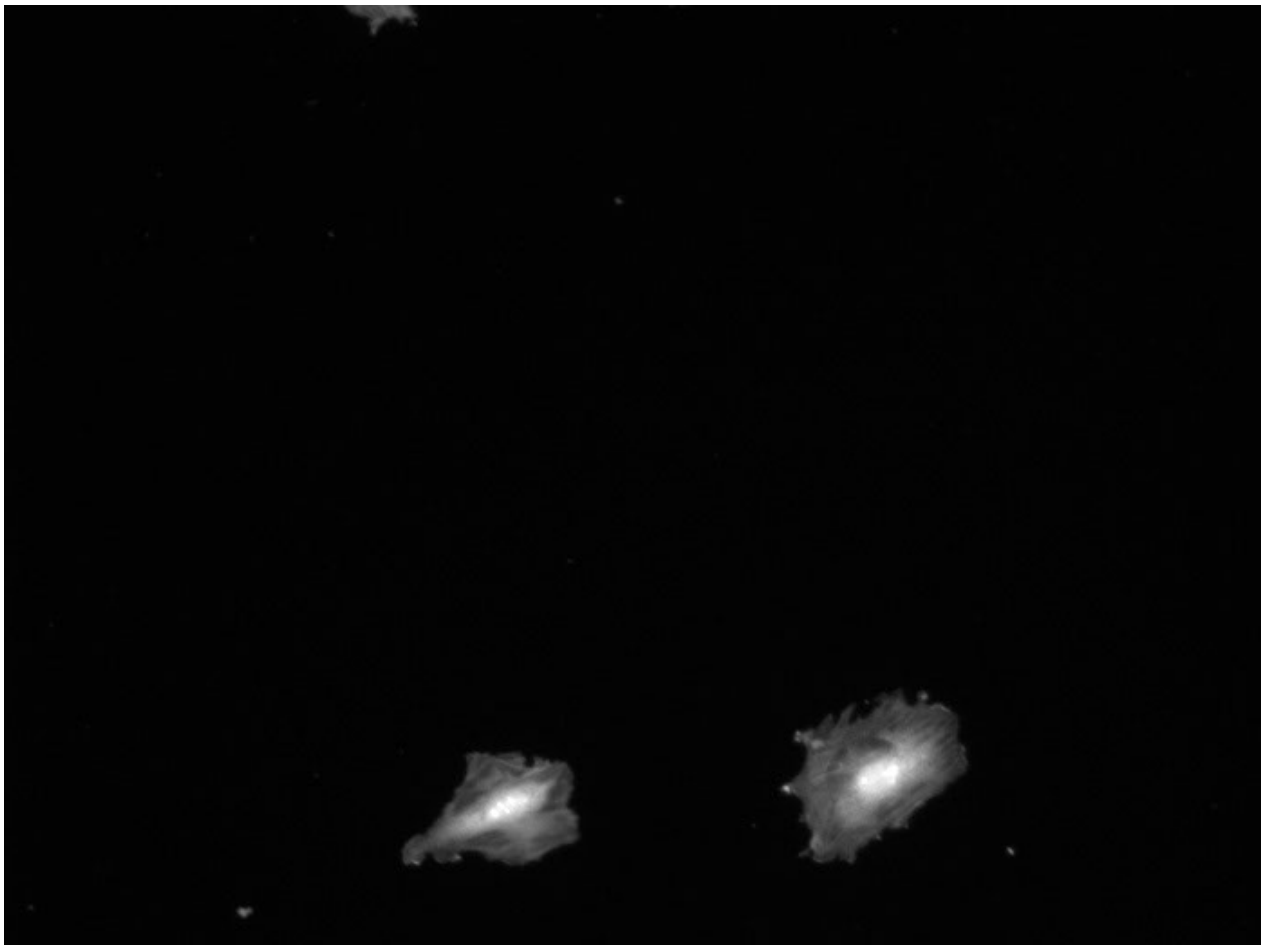

IWFCE_A10MedOptWell1_0039.png

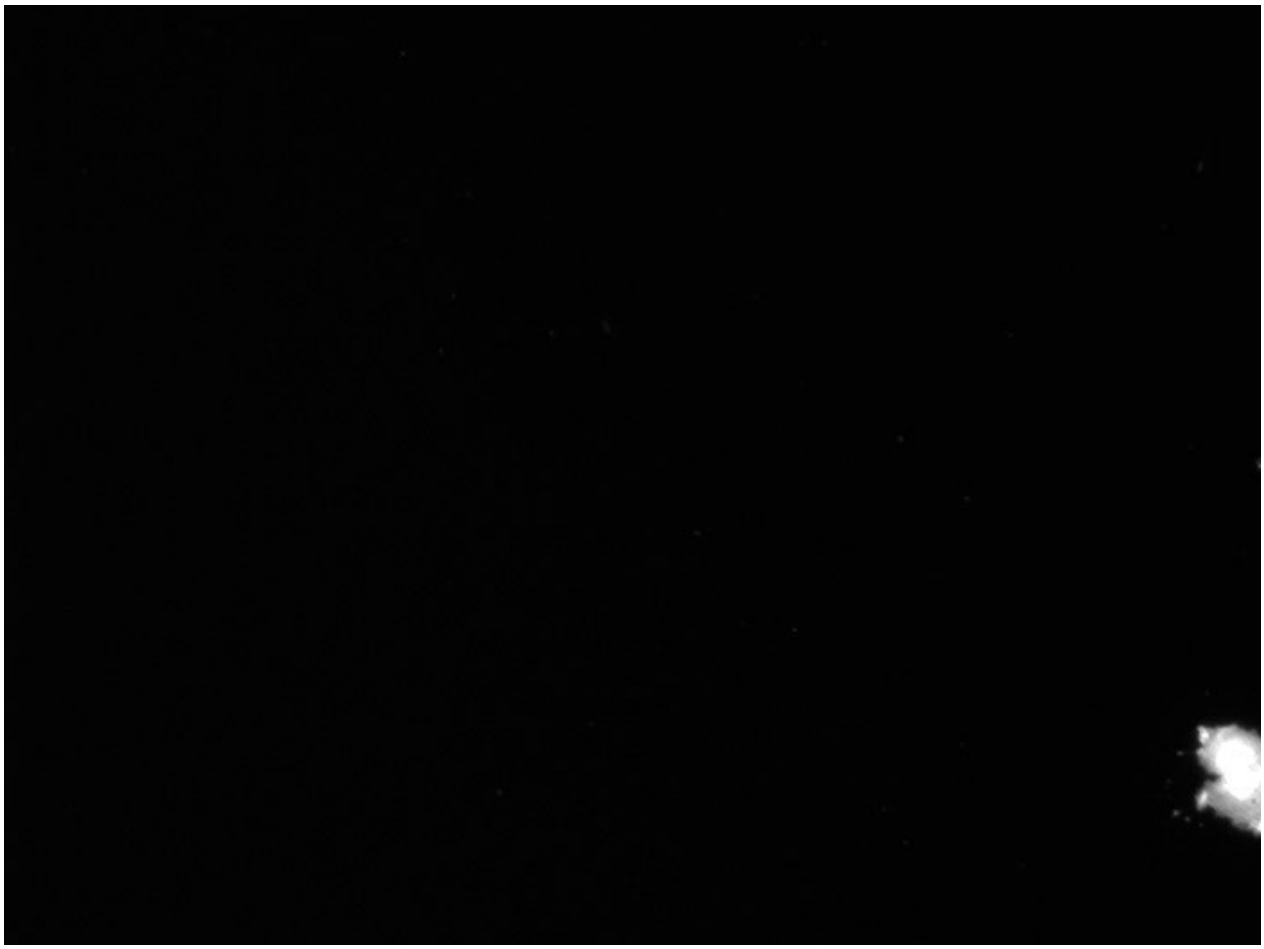

IWFCE_A10MedOptWell1_0040.png

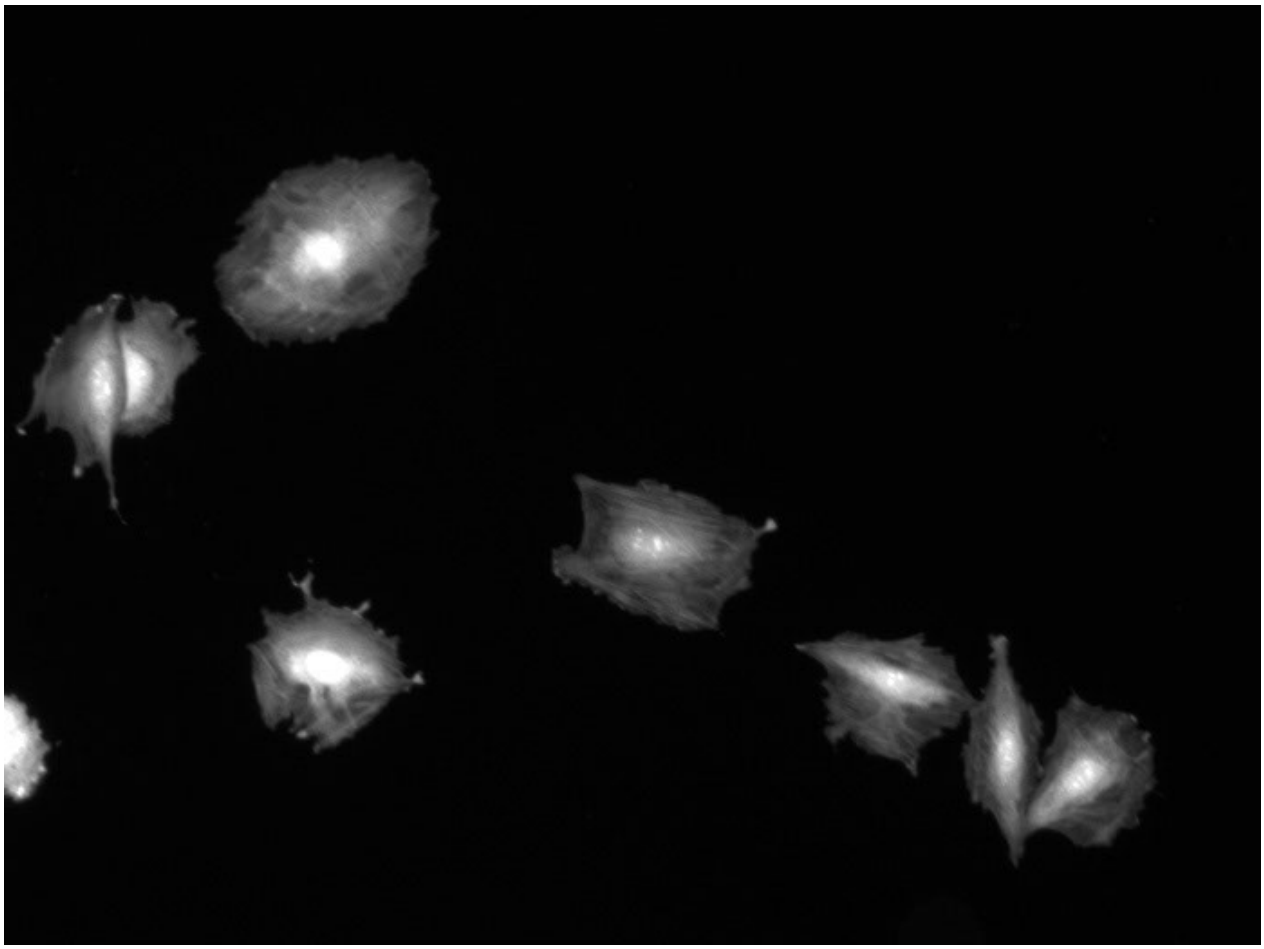

IWFCE_A10MedOptWell1_0041.png

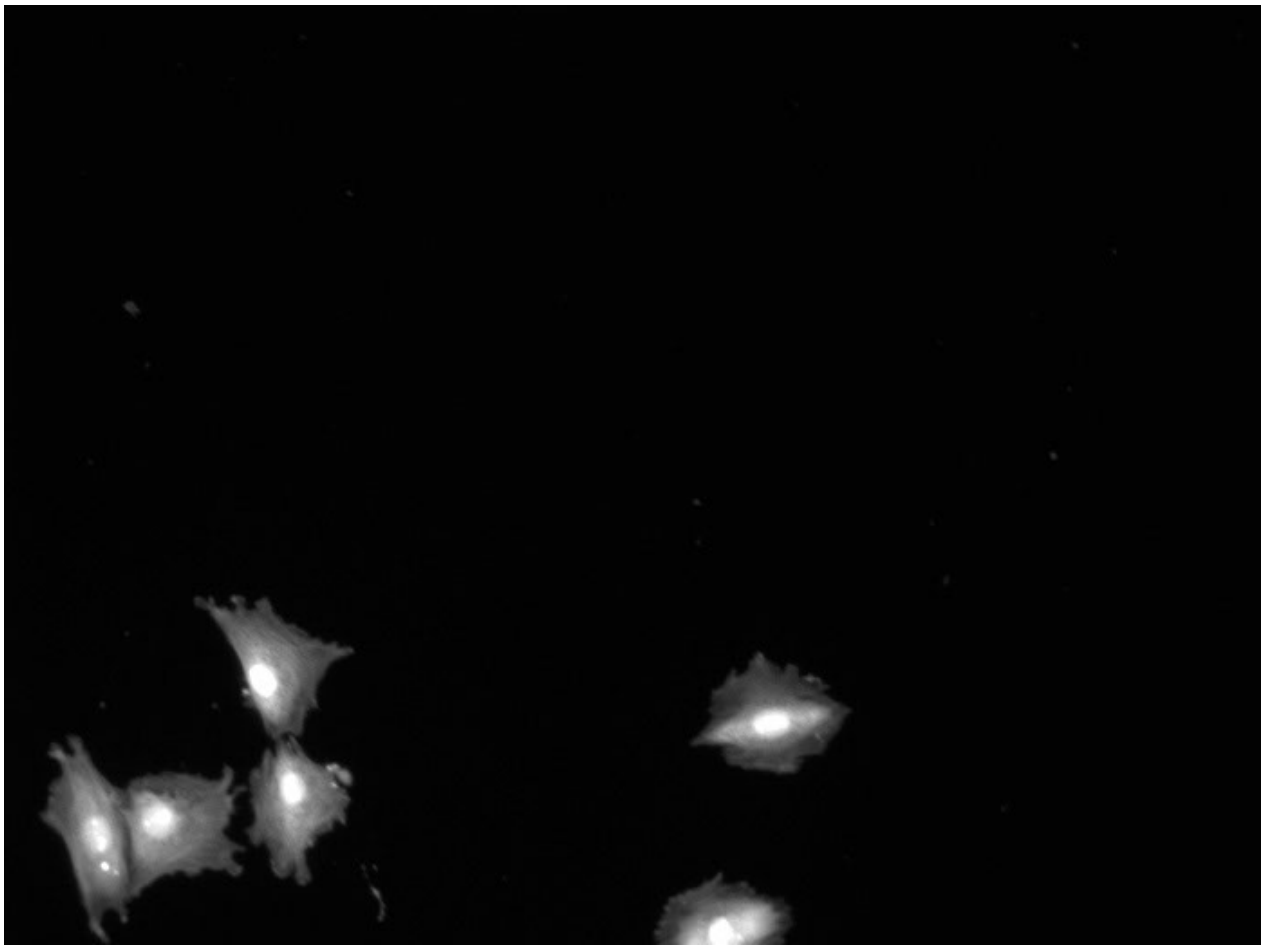

IWFCE_A10MedOptWell1_0042.png

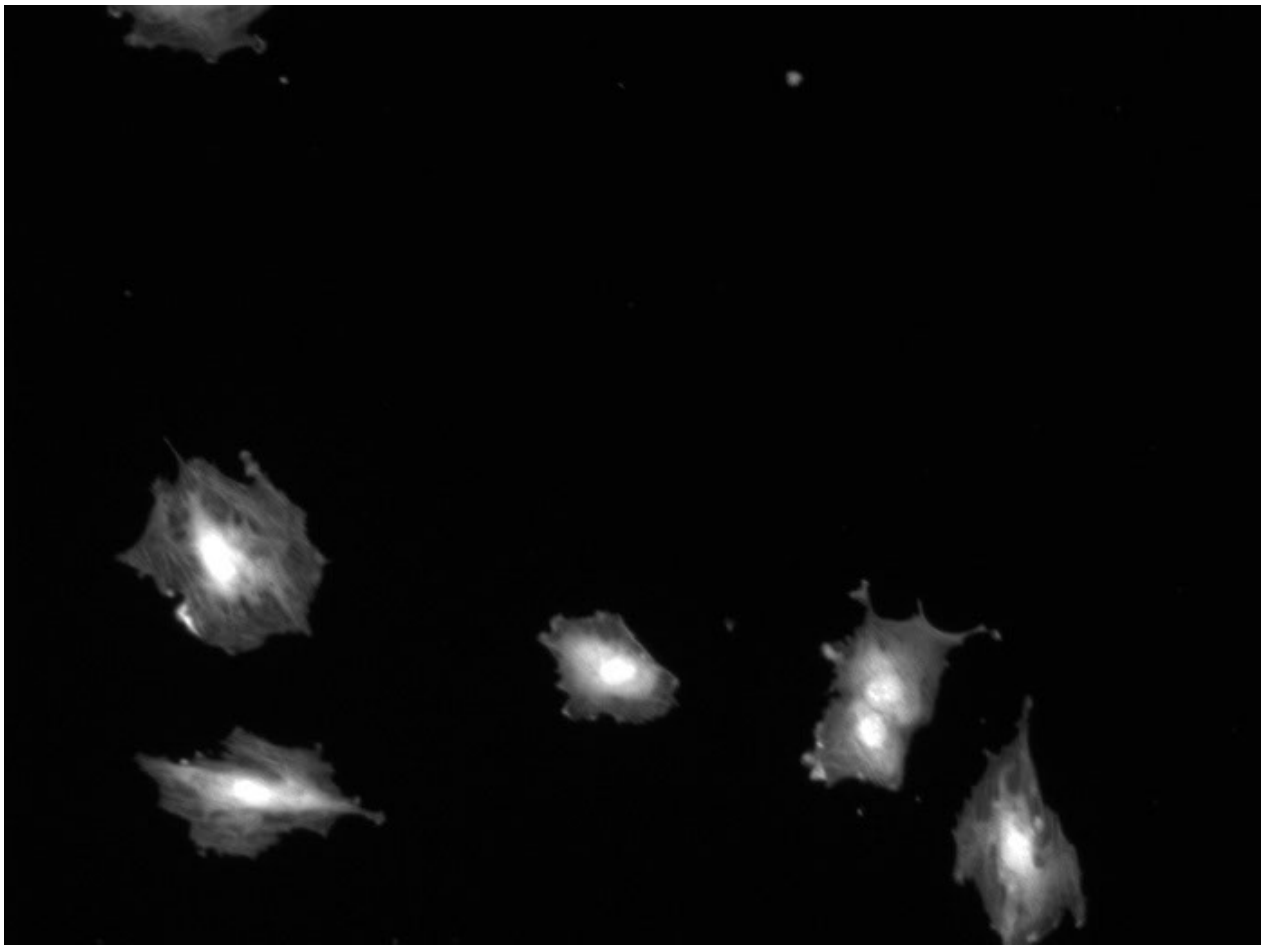

IWFCE_A10MedOptWell1_0043.png

IWFCE_A10MedOptWell1_0044.png

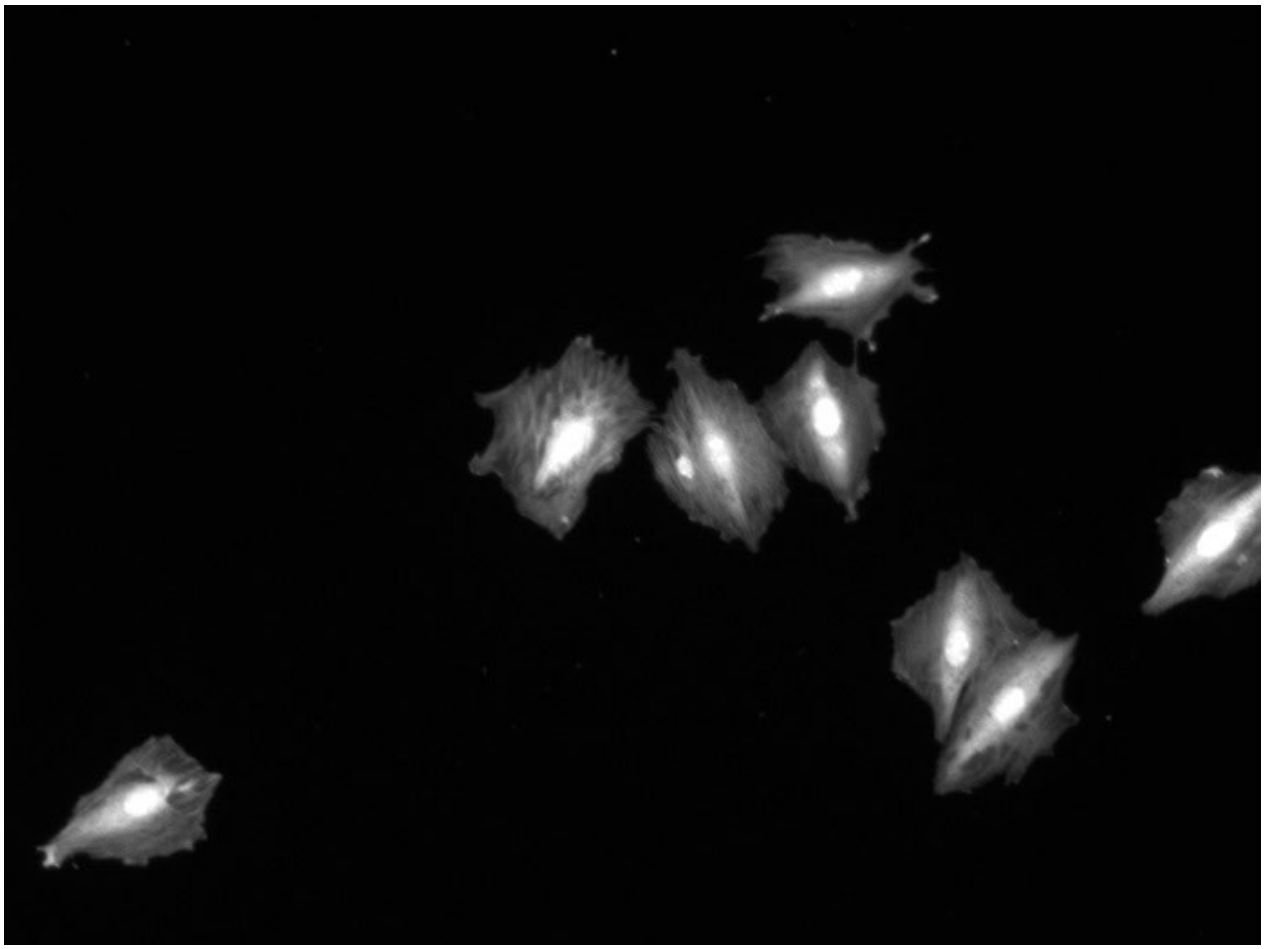

IWFCE_A10MedOptWell1_0045.png

IWFCE_A10MedOptWell1_0046.png

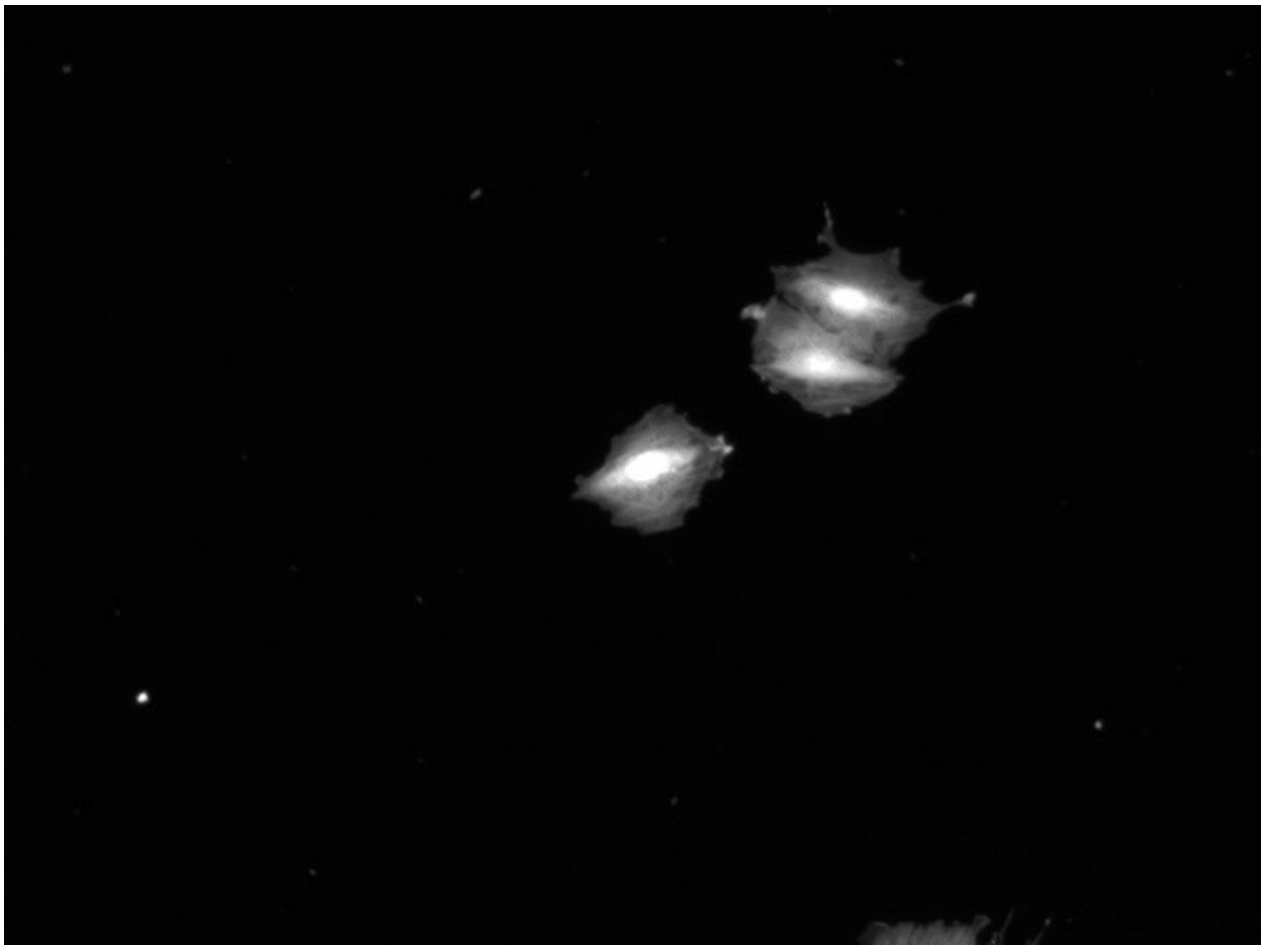

IWFCE_A10MedOptWell1_0047.png

IWFCE_A10MedOptWell1_0048.png

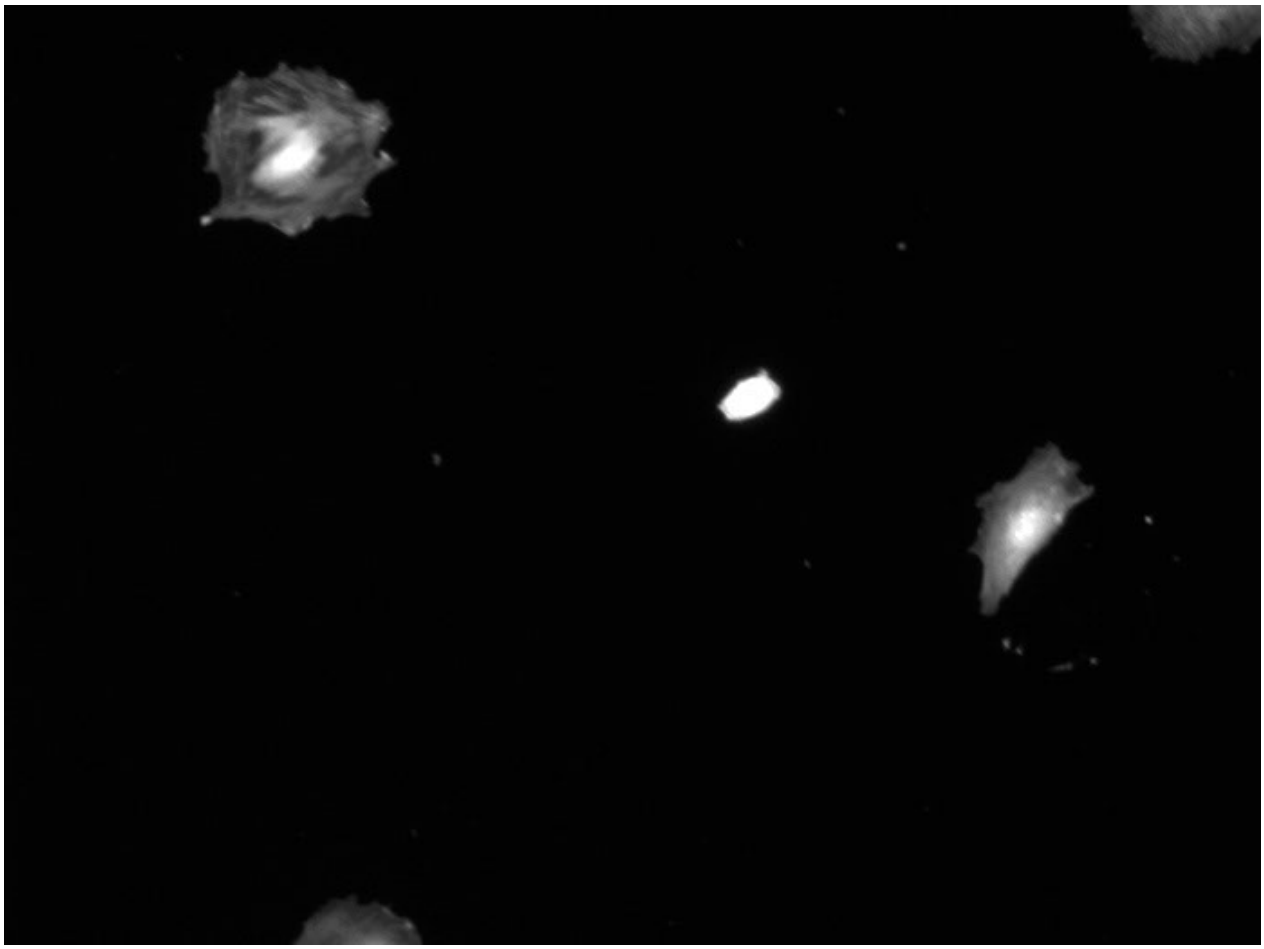

IWFCE_A10MedOptWell1_0049.png

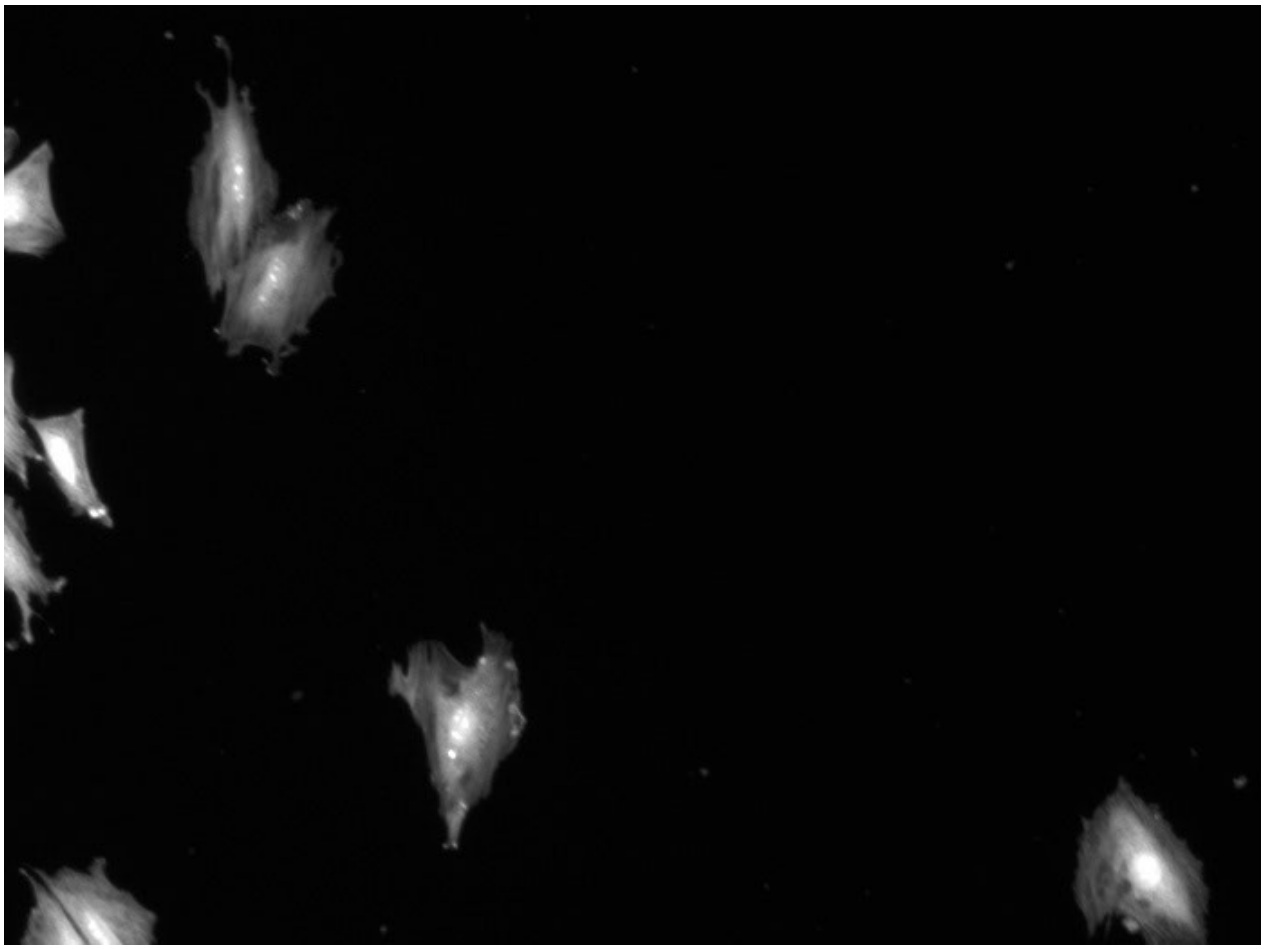

IWFCE_A10MedOptWell1_0050.png