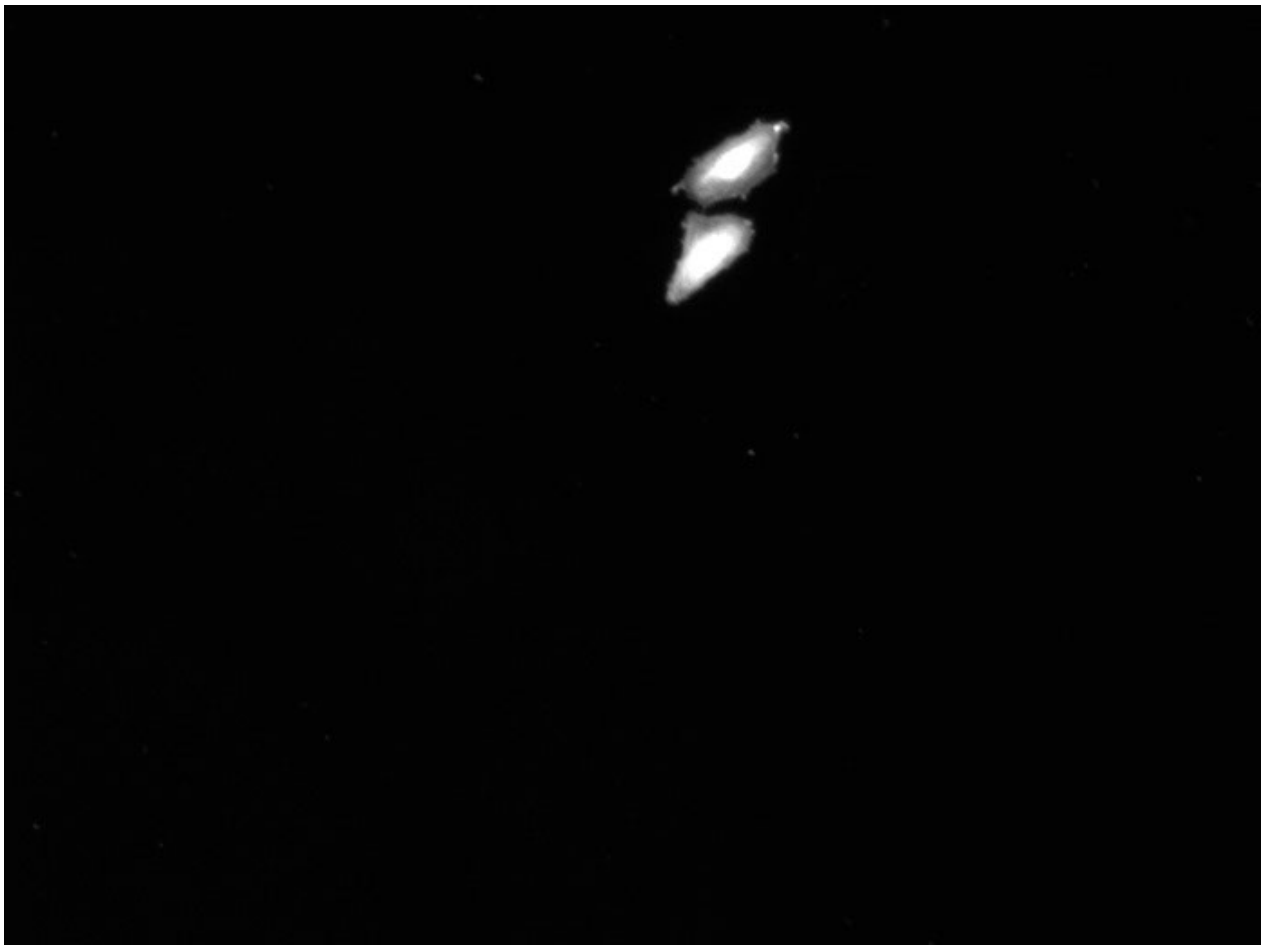

IWFCE_A10MedOptWell2_0001.png

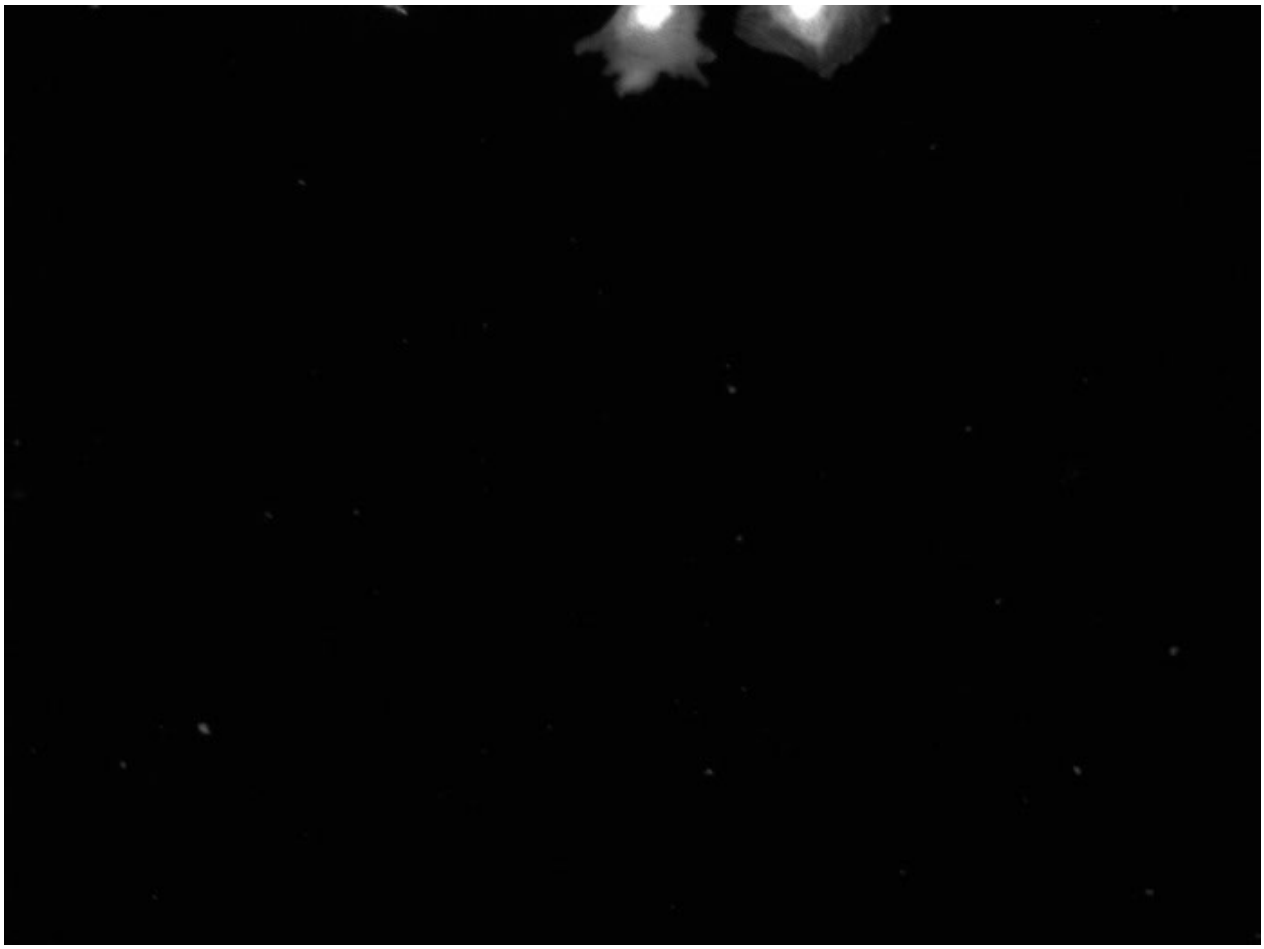

IWFCE_A10MedOptWell2_0002.png

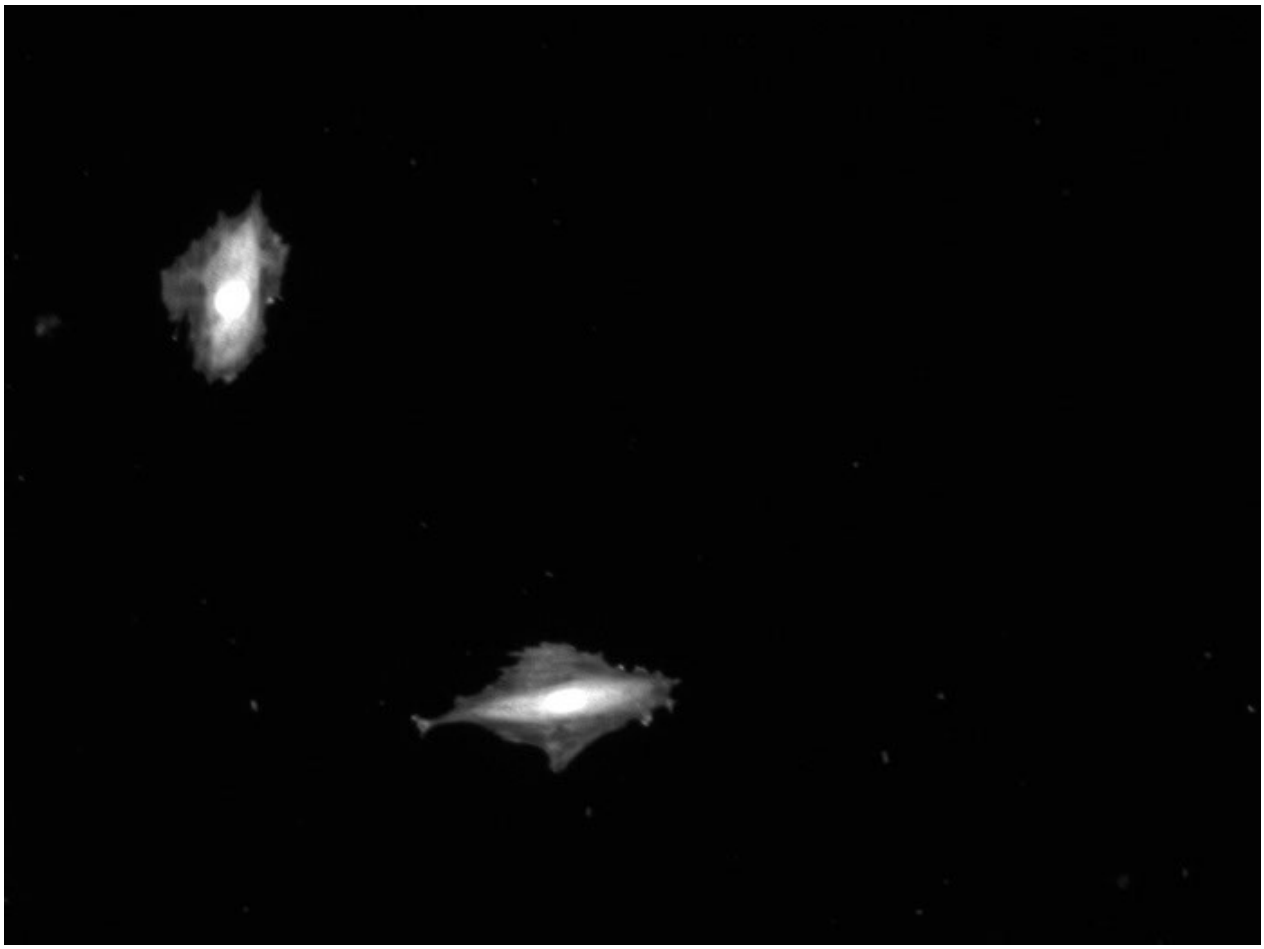

IWFCE_A10MedOptWell2_0003.png

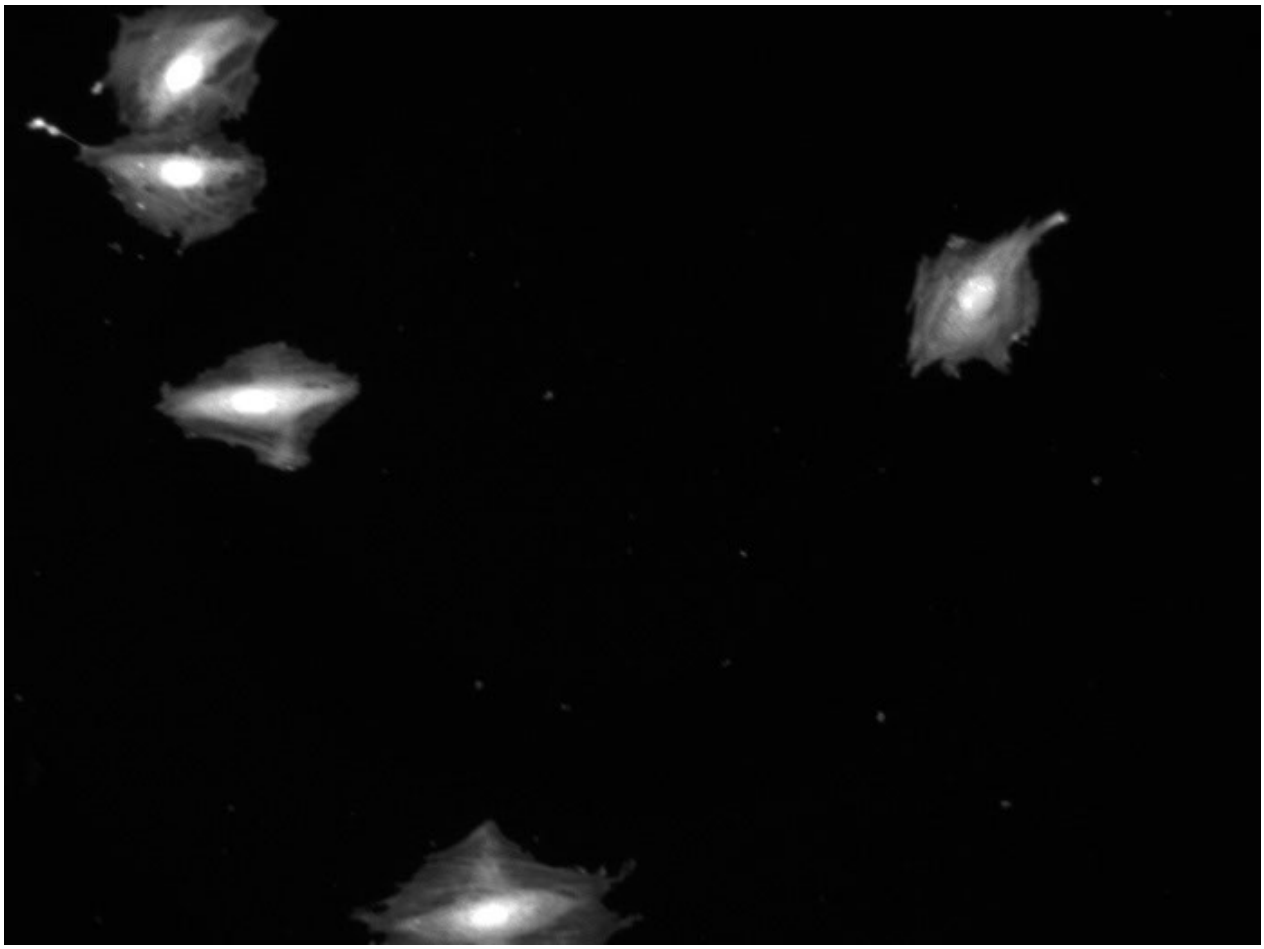

IWFCE_A10MedOptWell2_0004.png

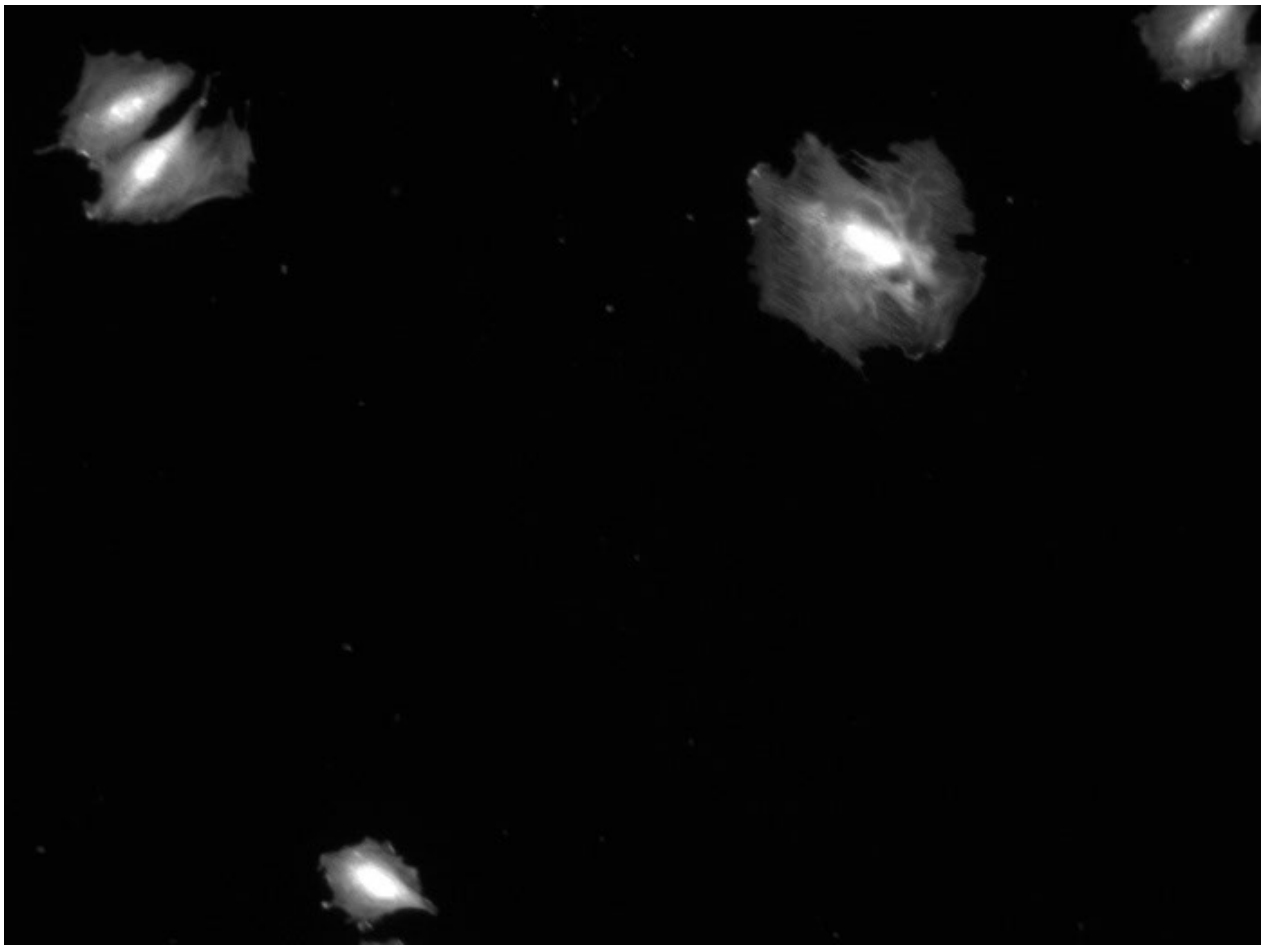

IWFCE_A10MedOptWell2_0005.png

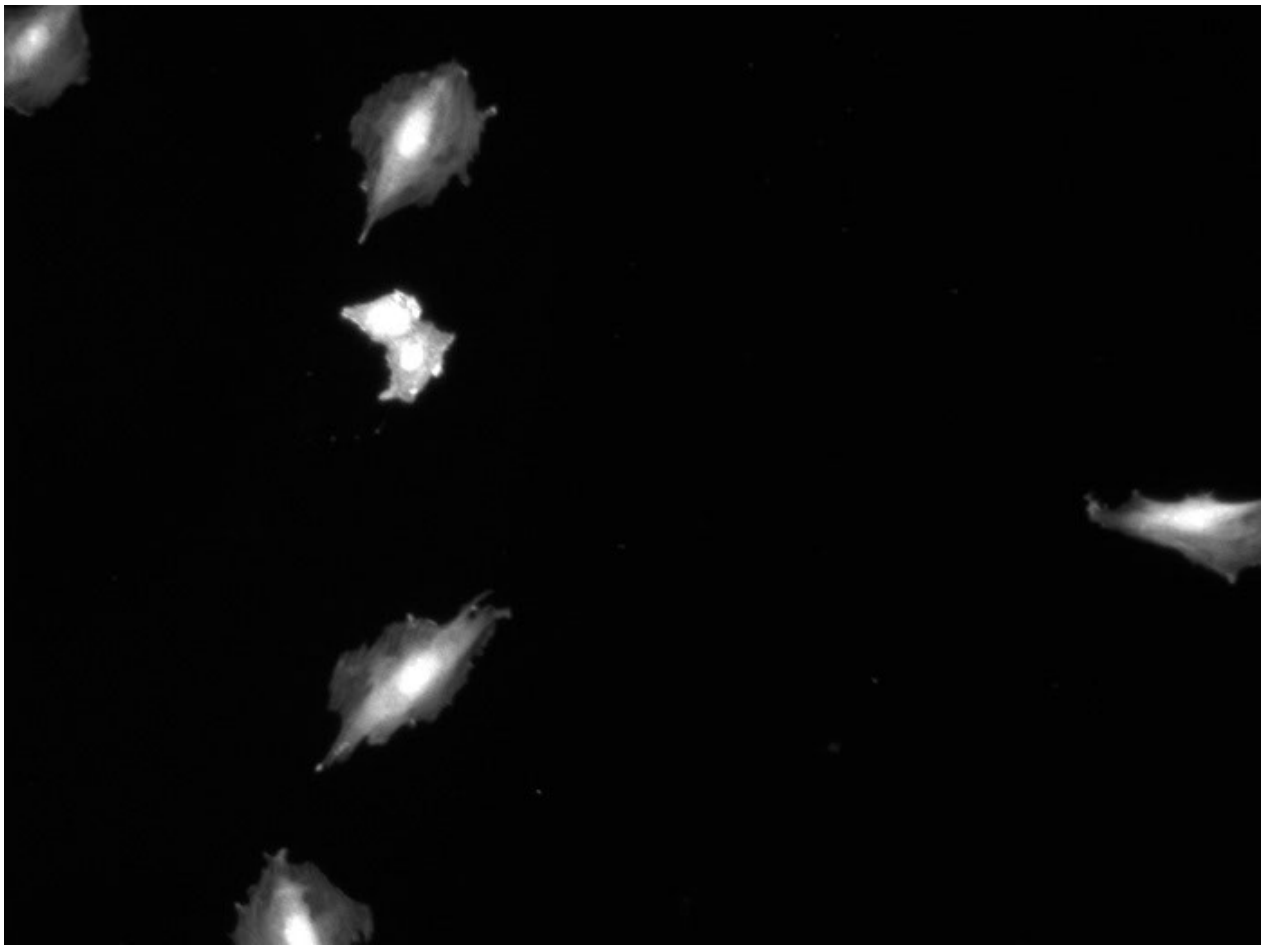

IWFCE_A10MedOptWell2_0006.png

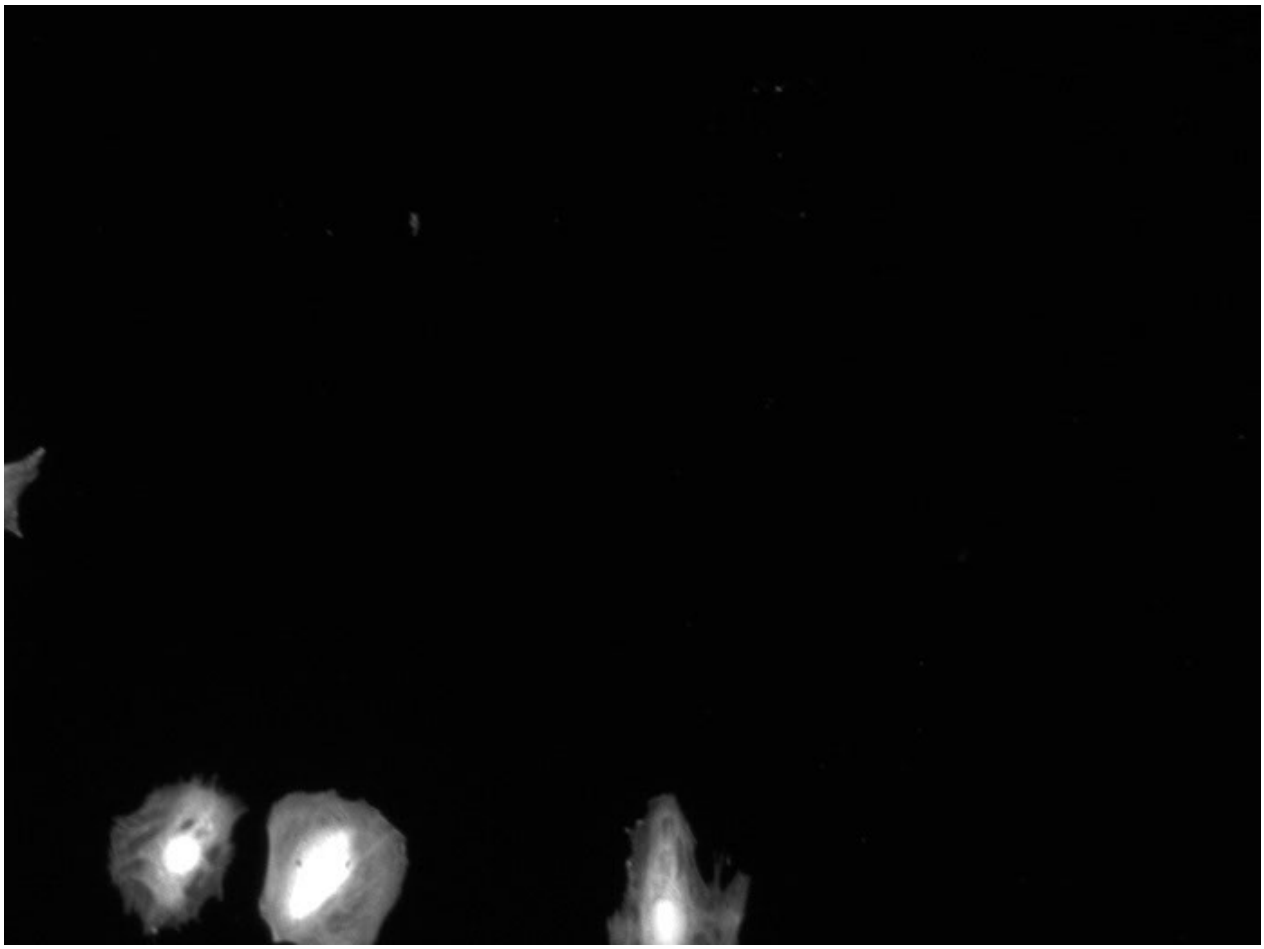

IWFCE_A10MedOptWell2_0007.png

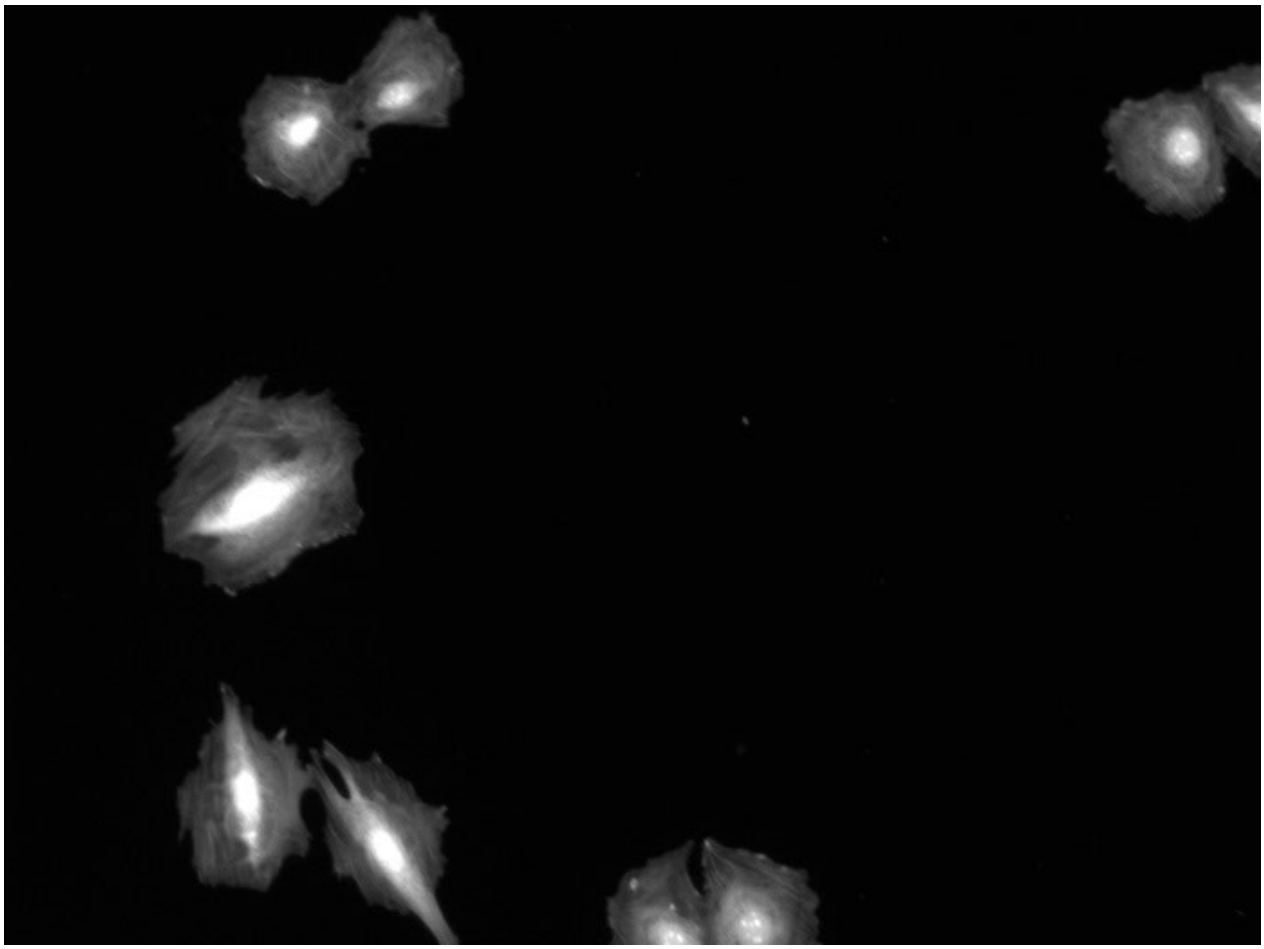

IWFCE_A10MedOptWell2_0008.png

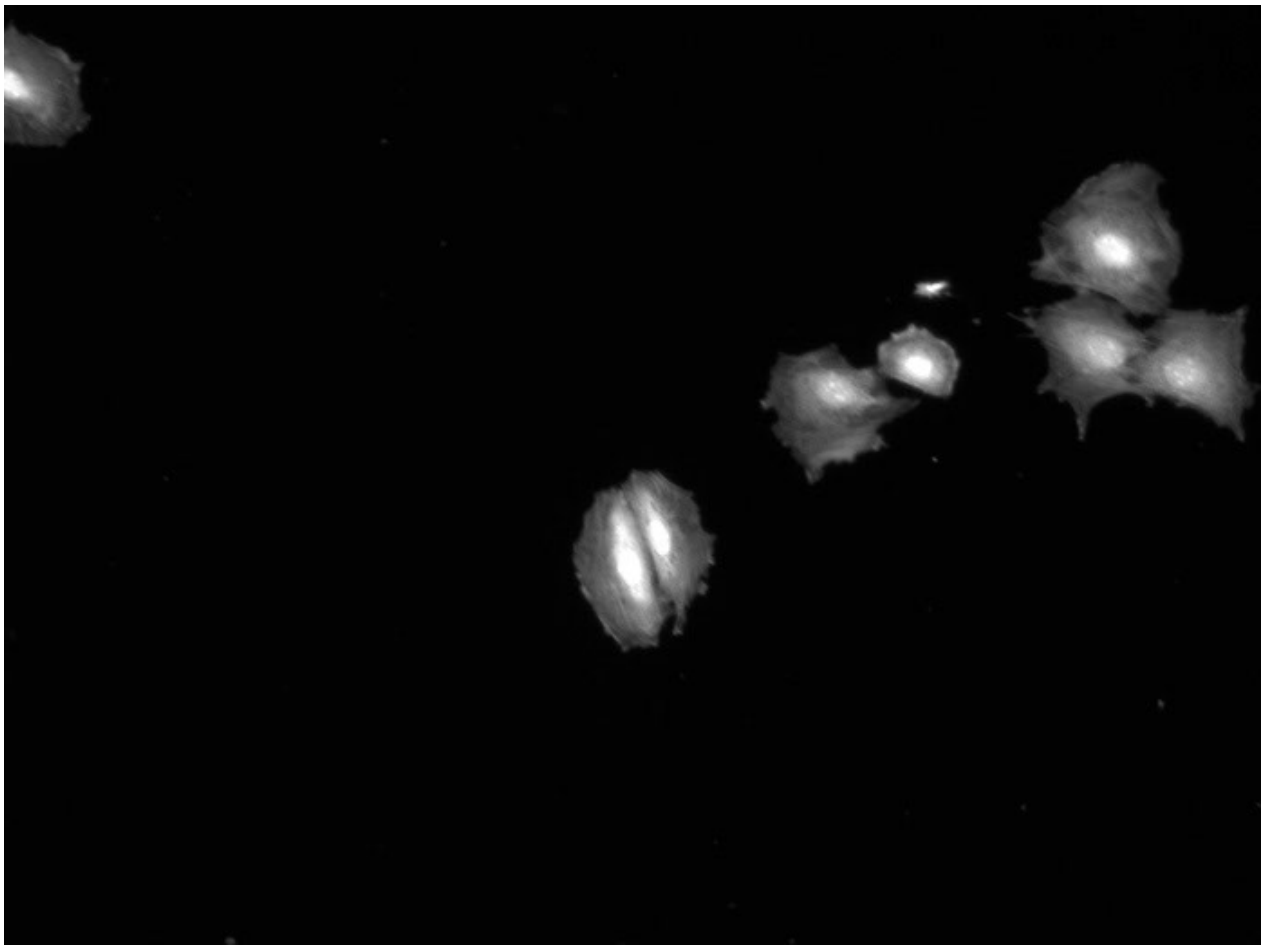

IWFCE_A10MedOptWell2_0009.png

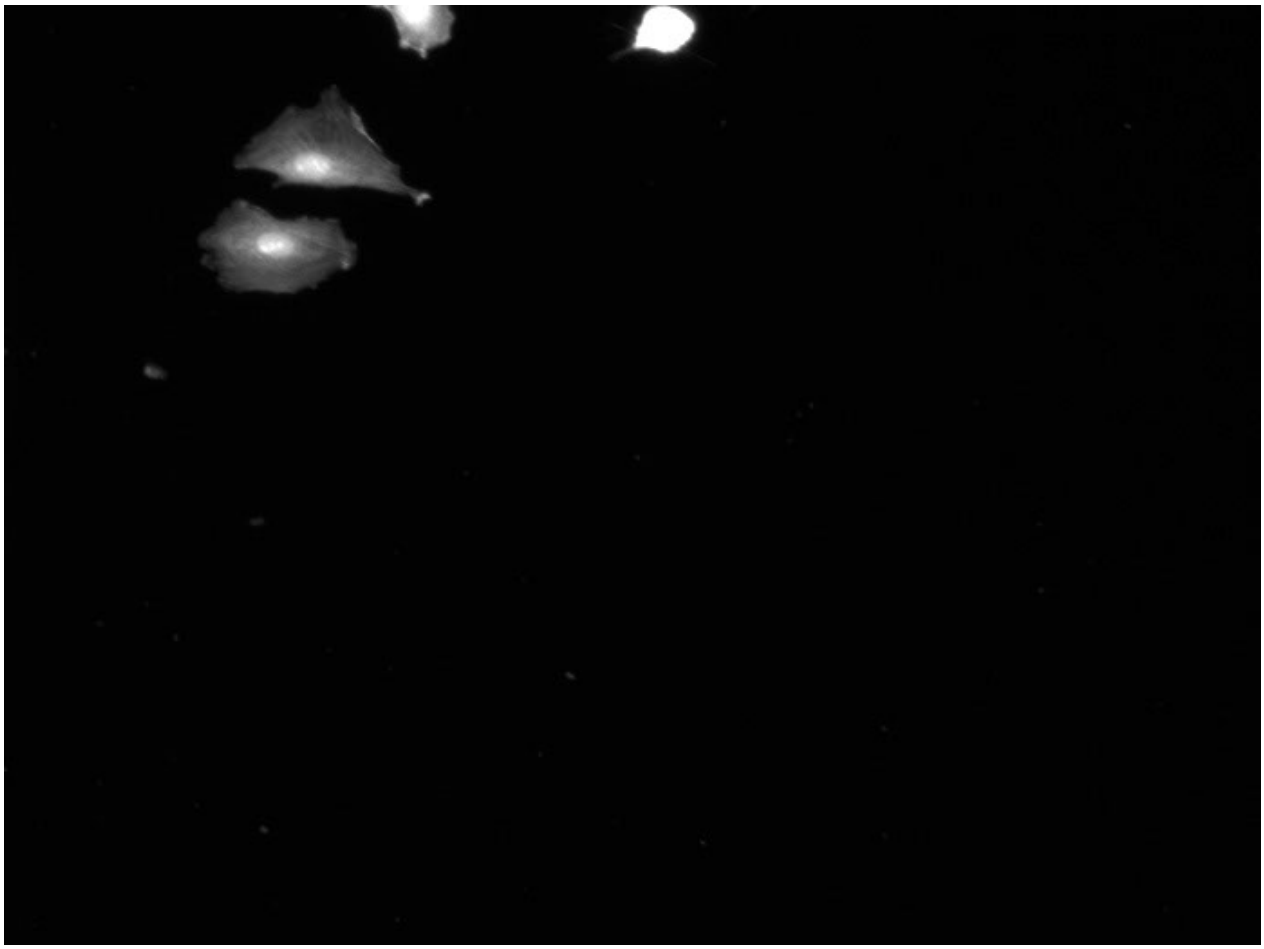

IWFCE_A10MedOptWell2_0010.png

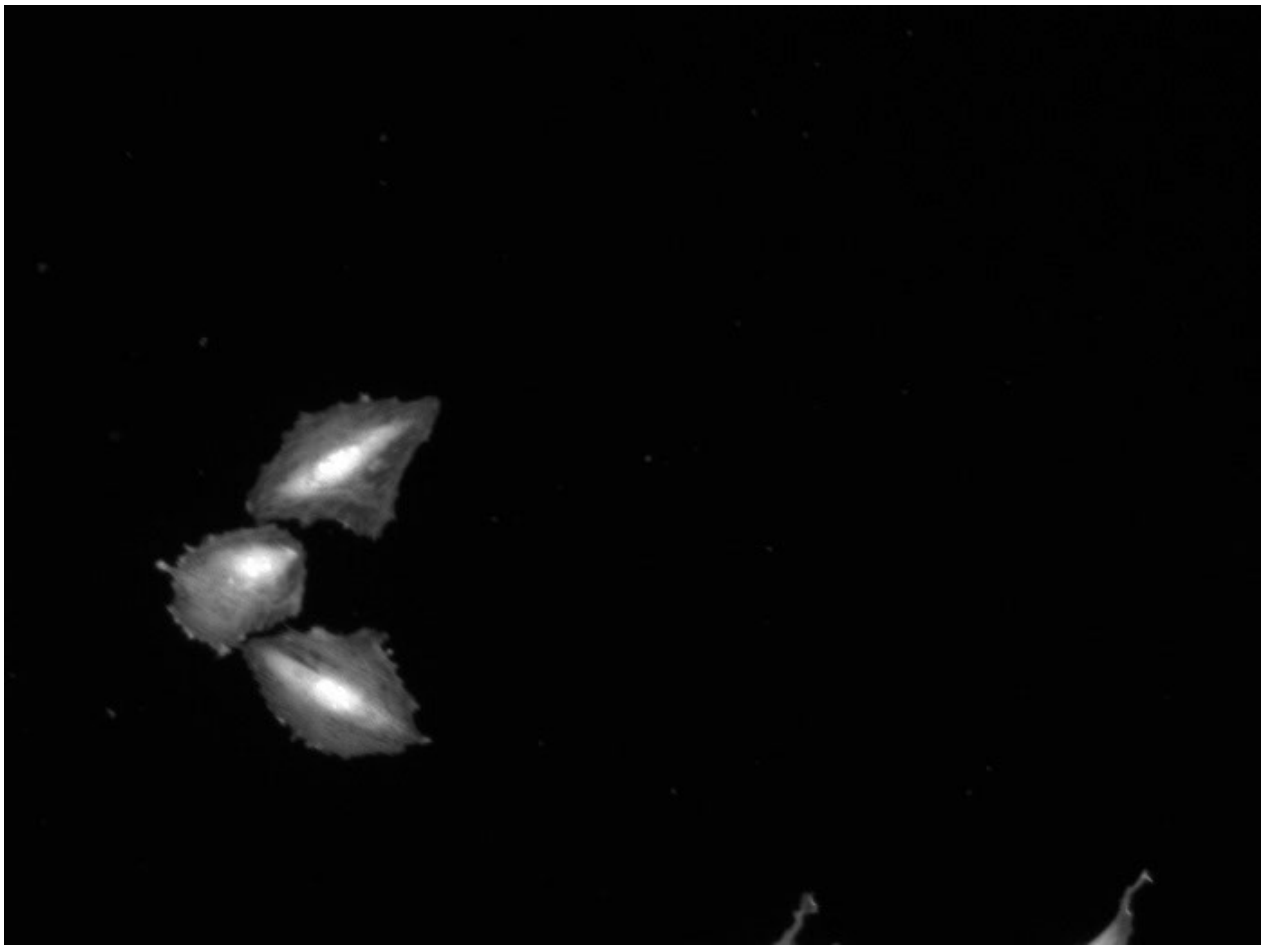

IWFCE_A10MedOptWell2_0011.png

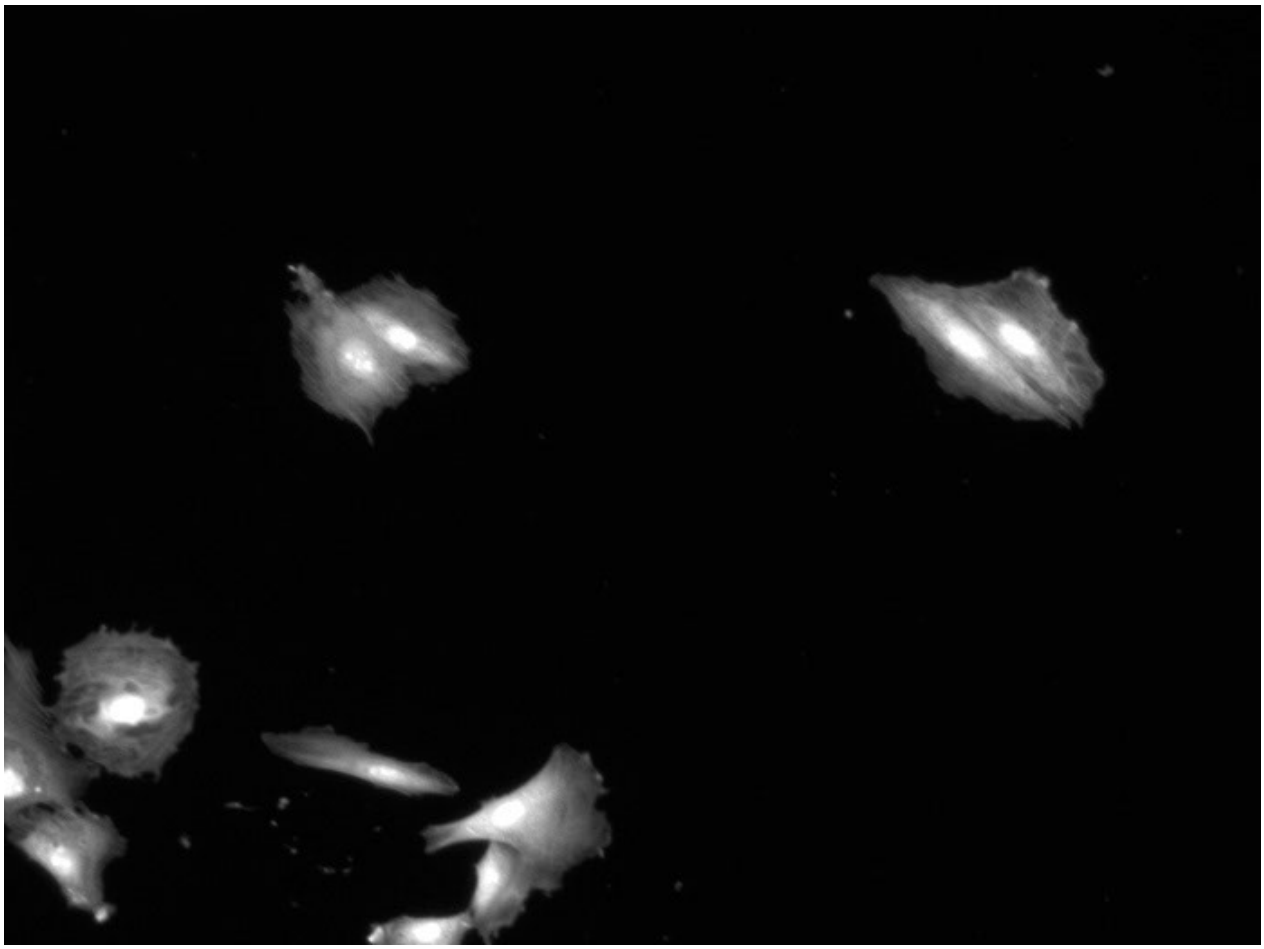

IWFCE_A10MedOptWell2_0012.png

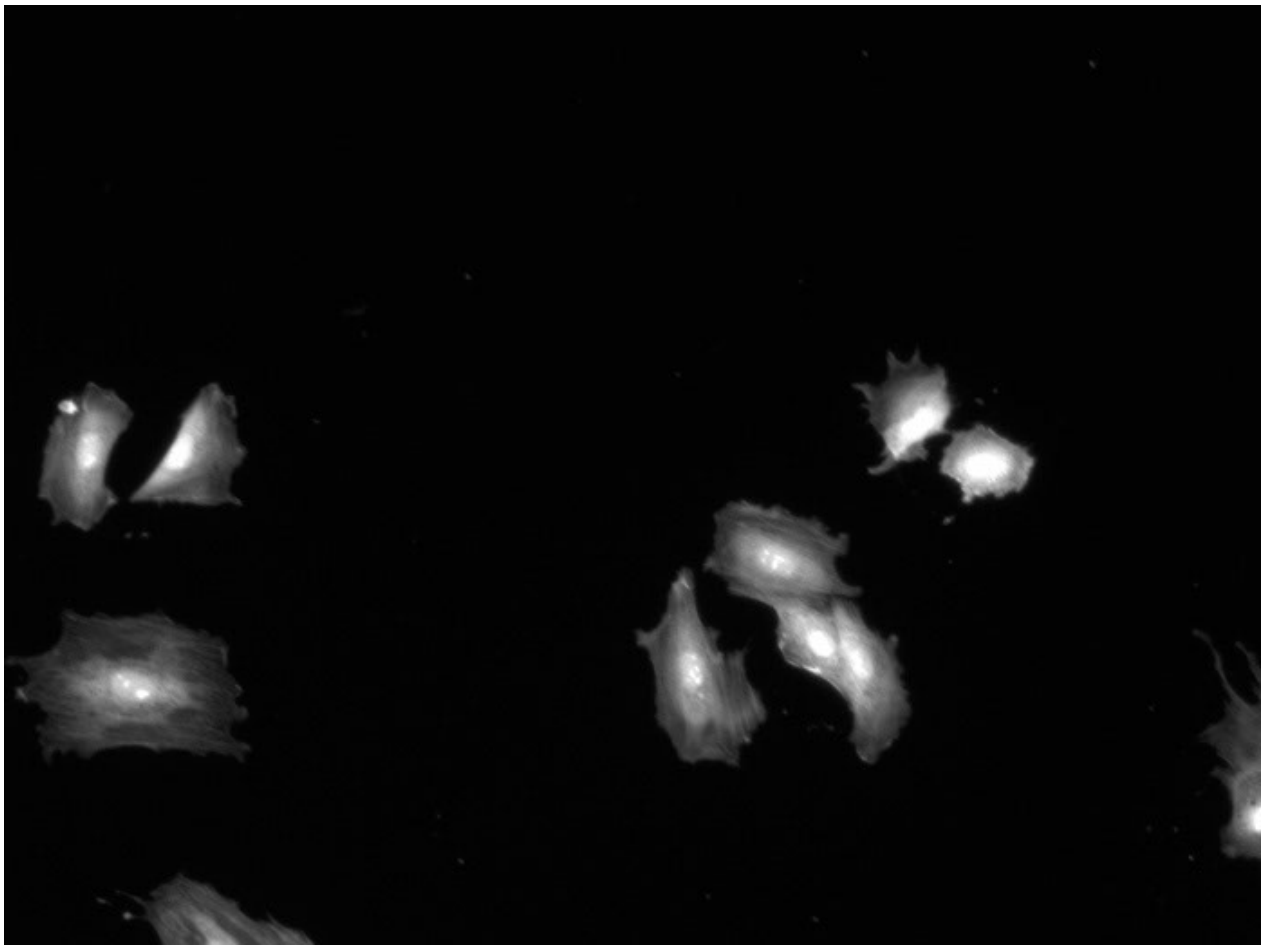

IWFCE_A10MedOptWell2_0013.png

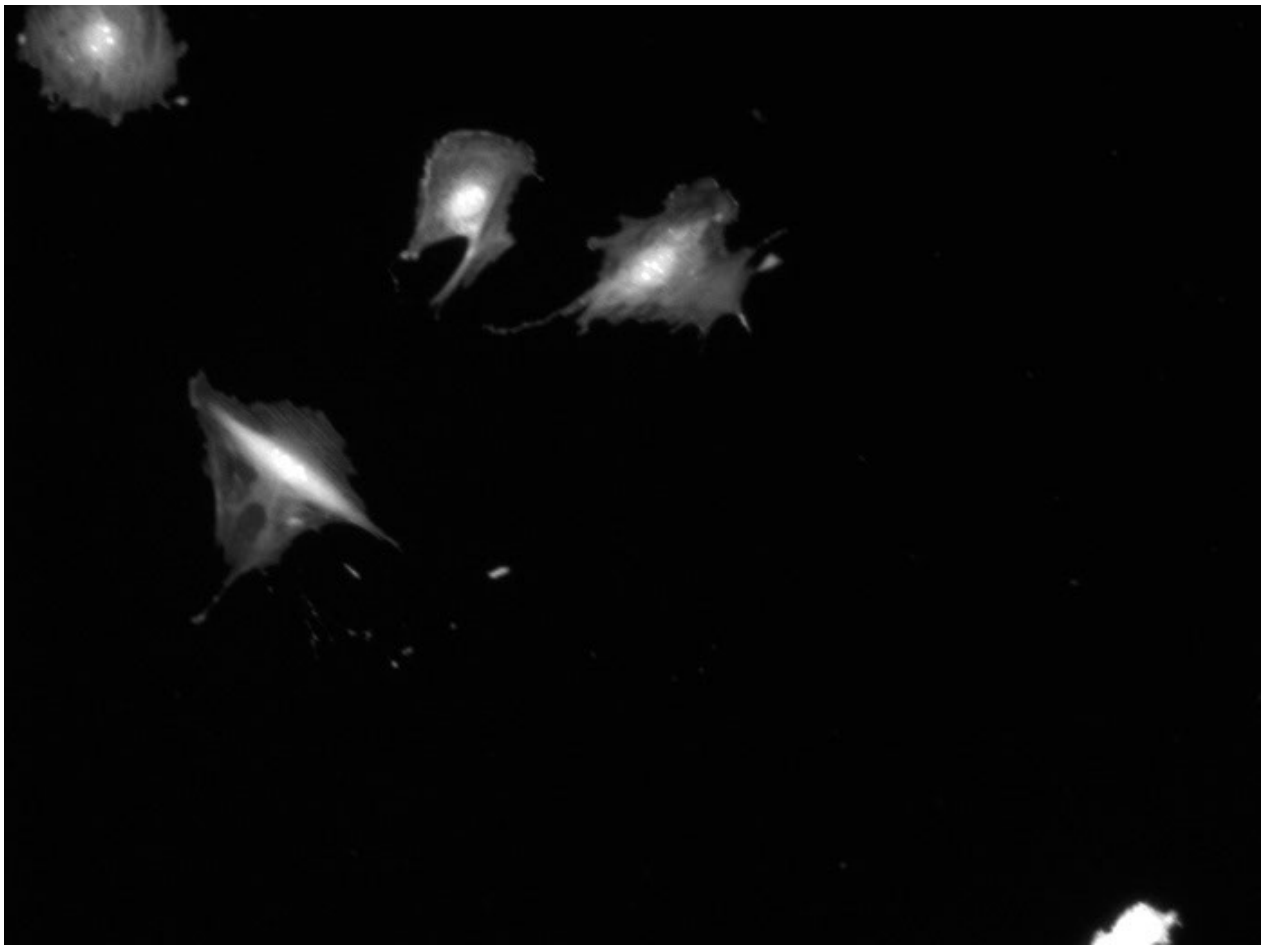

IWFCE_A10MedOptWell2_0014.png

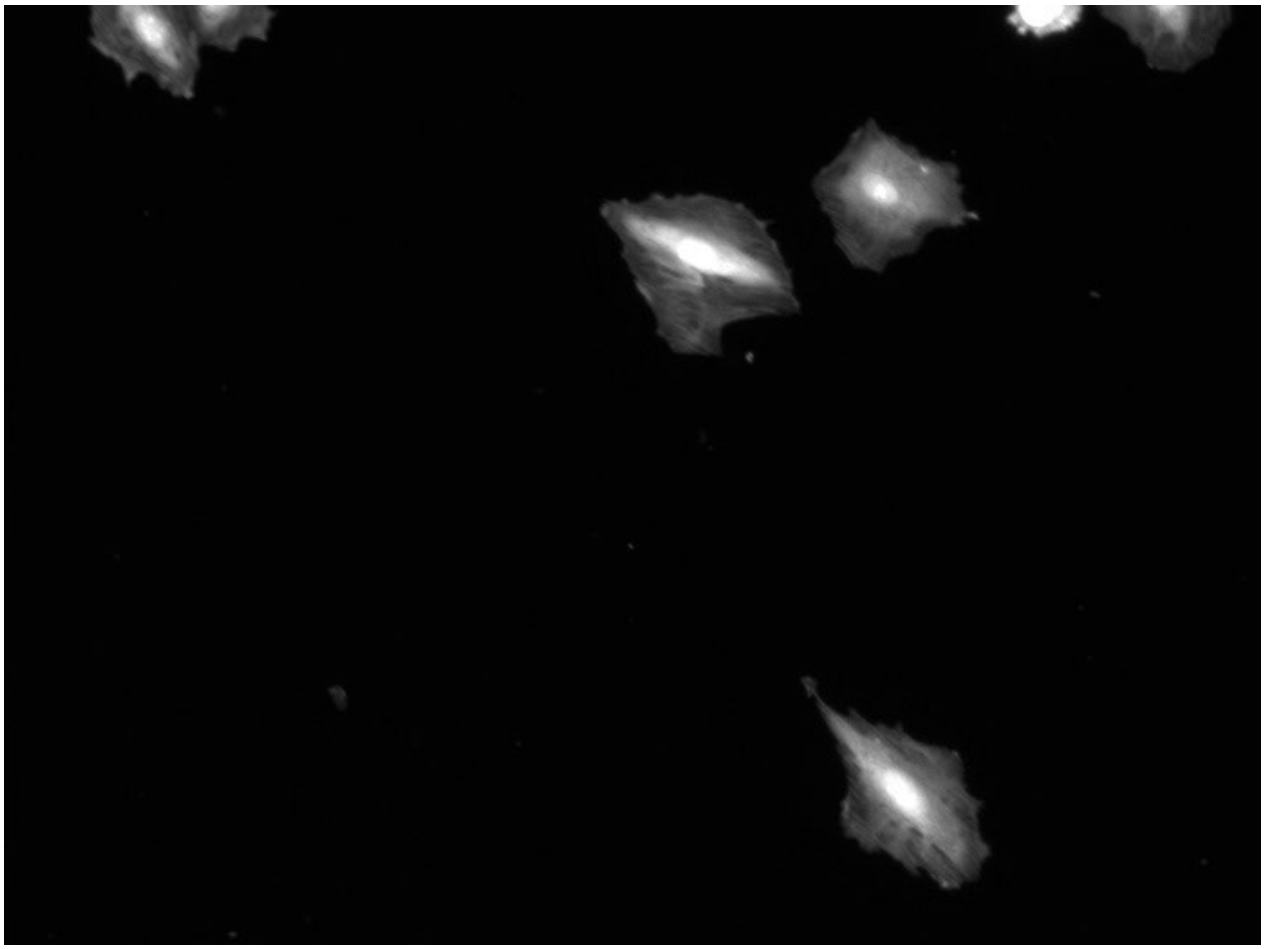

IWFCE_A10MedOptWell2_0015.png

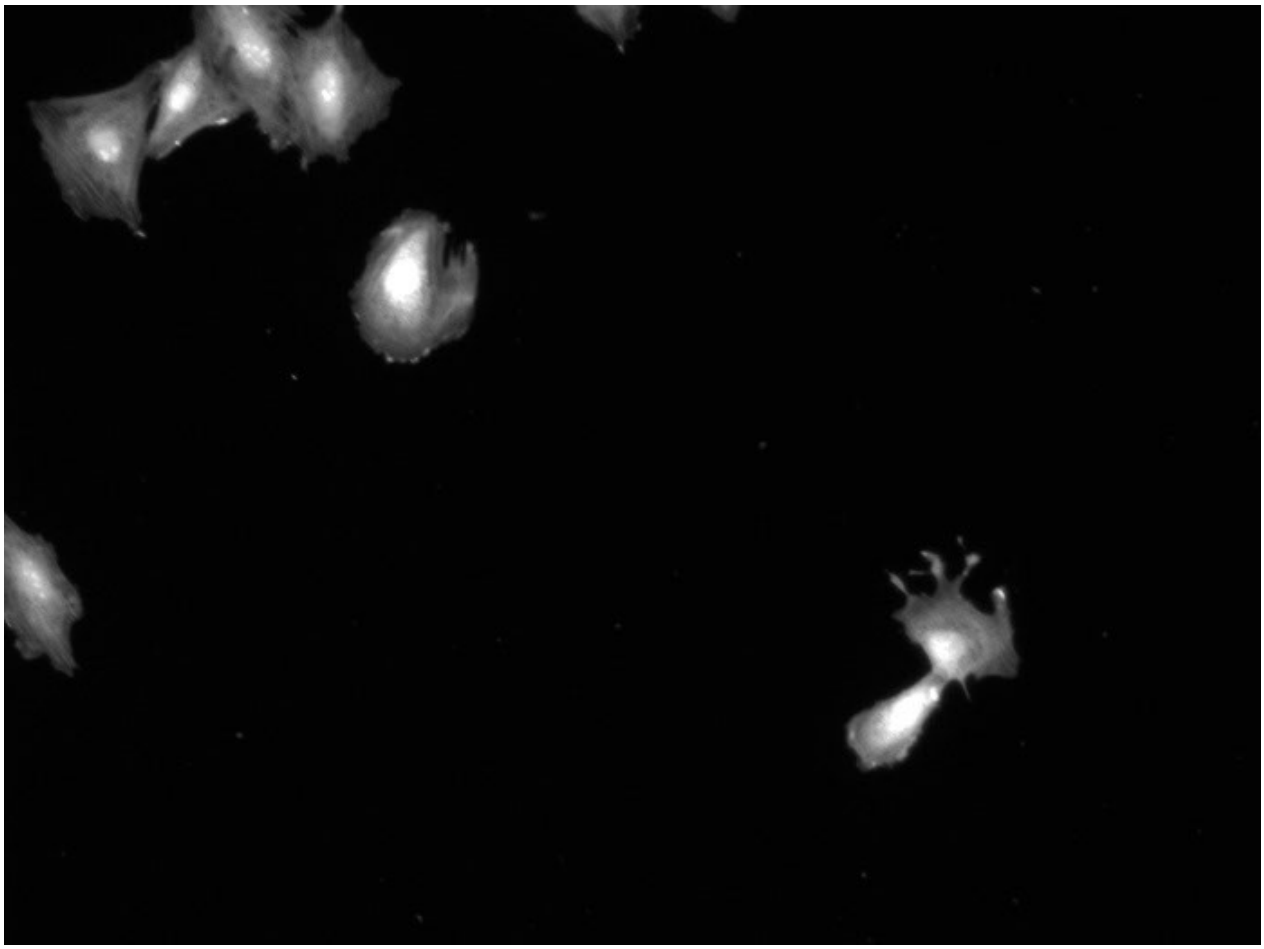

IWFCE_A10MedOptWell2_0016.png

IWFCE_A10MedOptWell2_0017.png

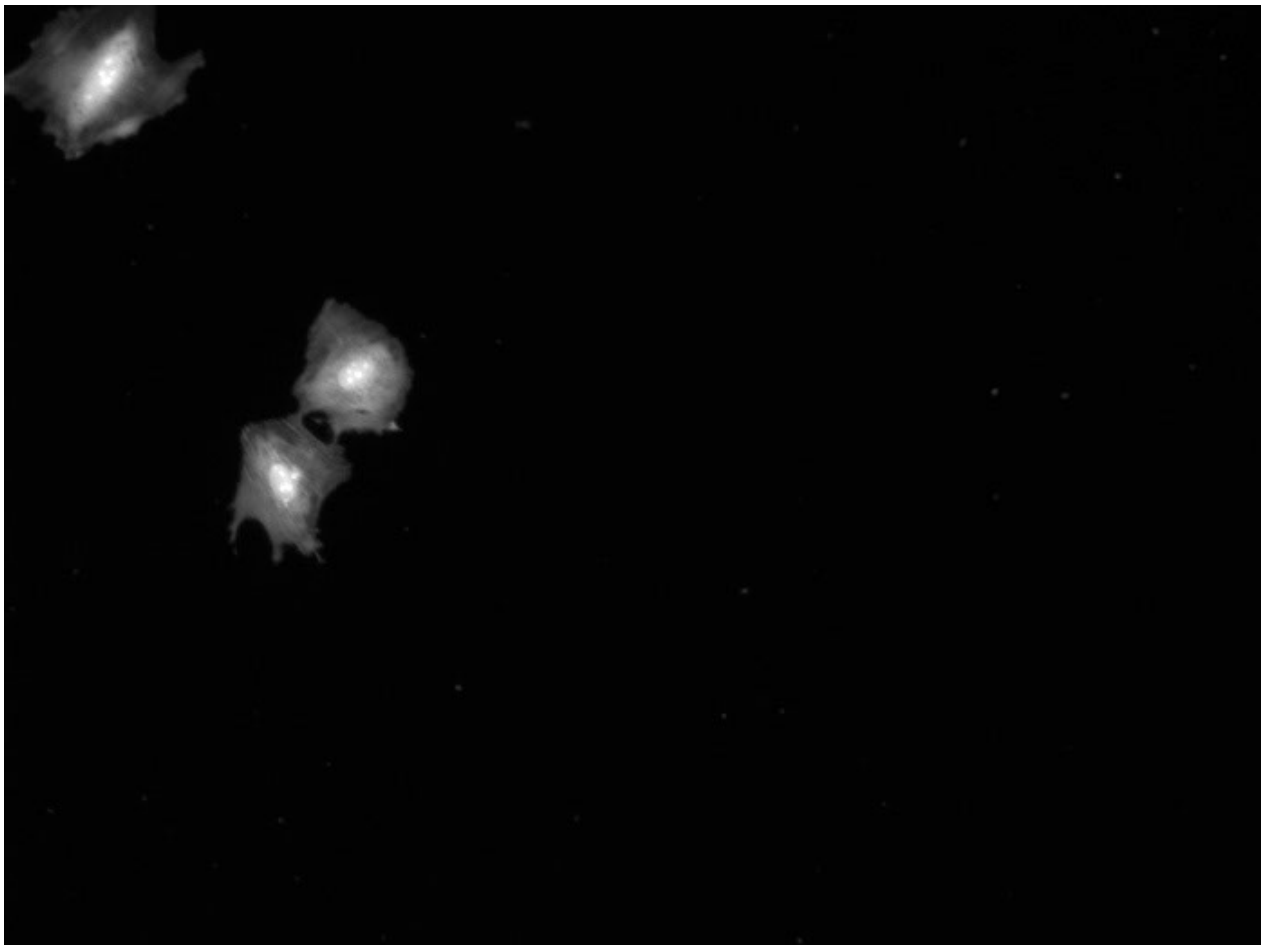

IWFCE_A10MedOptWell2_0018.png

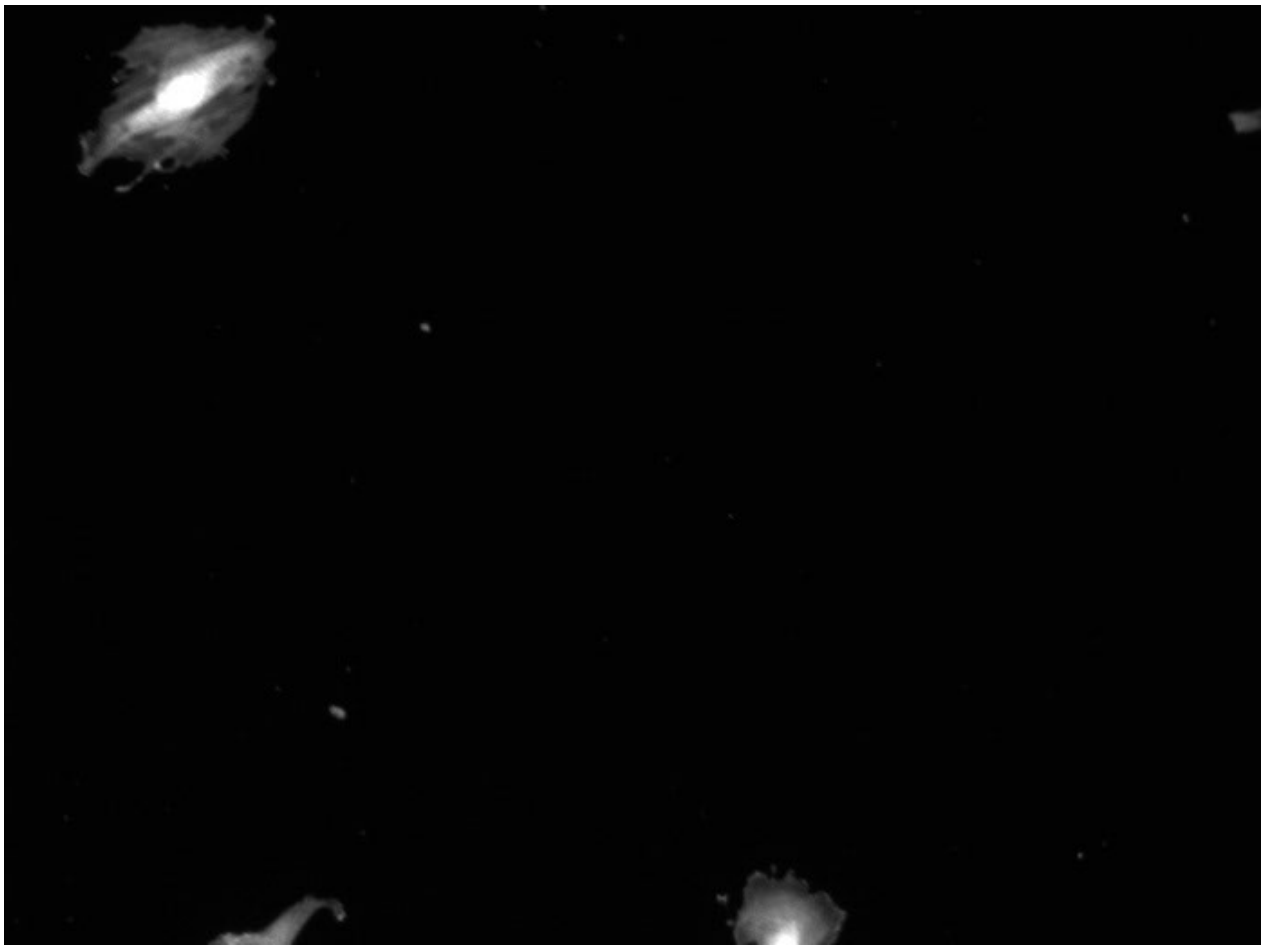

IWFCE_A10MedOptWell2_0019.png

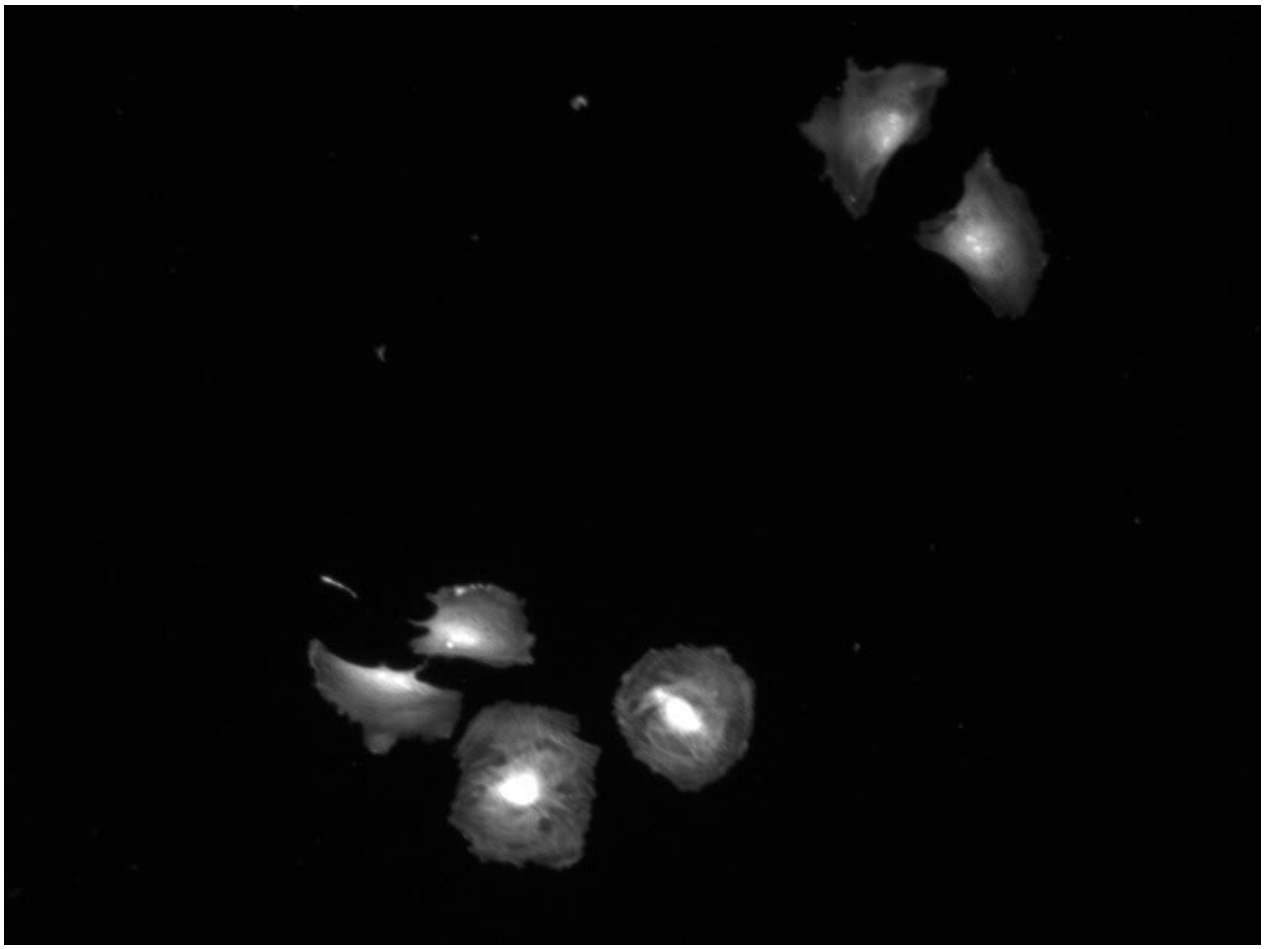

IWFCE_A10MedOptWell2_0020.png

IWFCE_A10MedOptWell2_0021.png

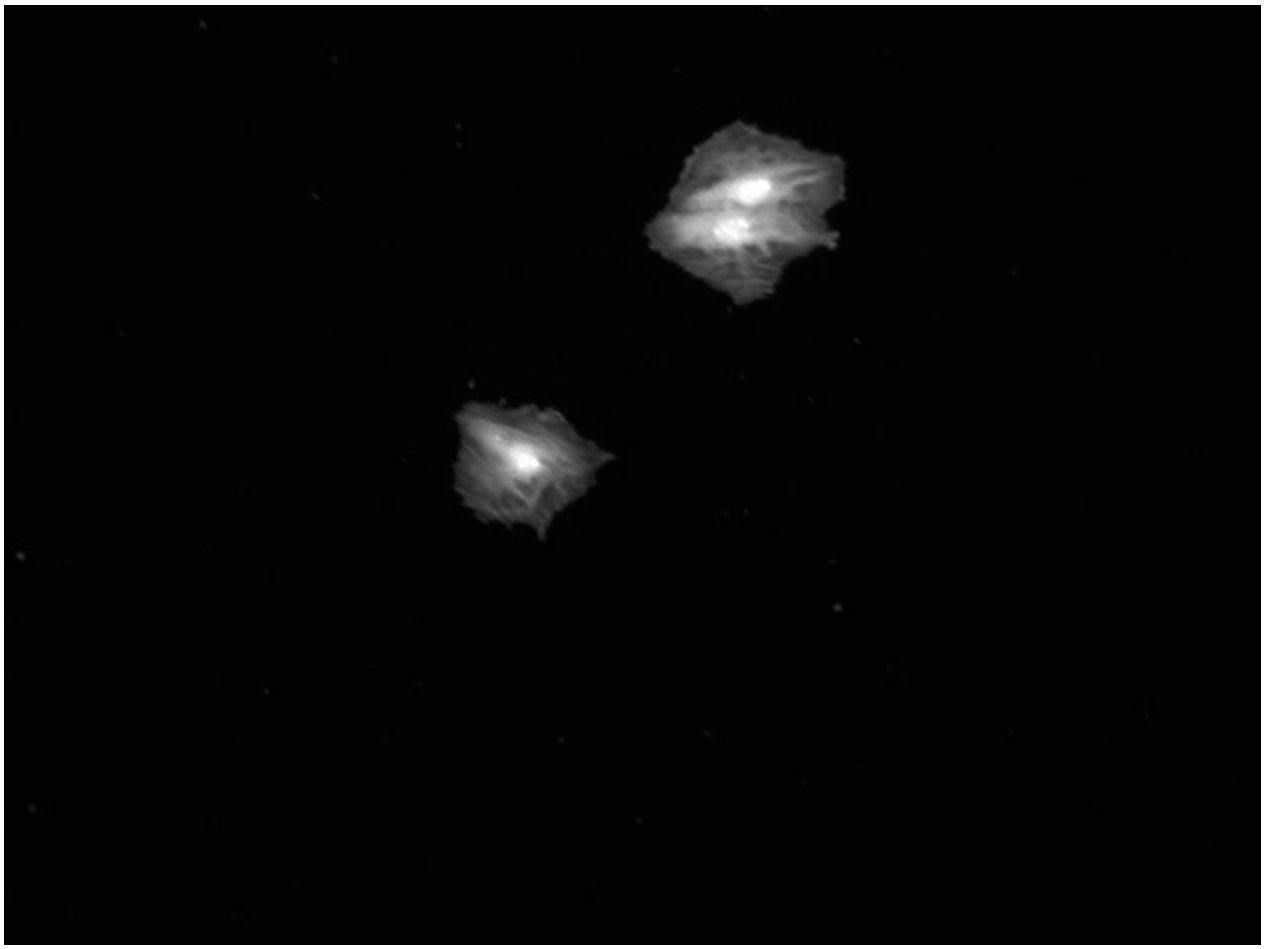

IWFCE_A10MedOptWell2_0022.png

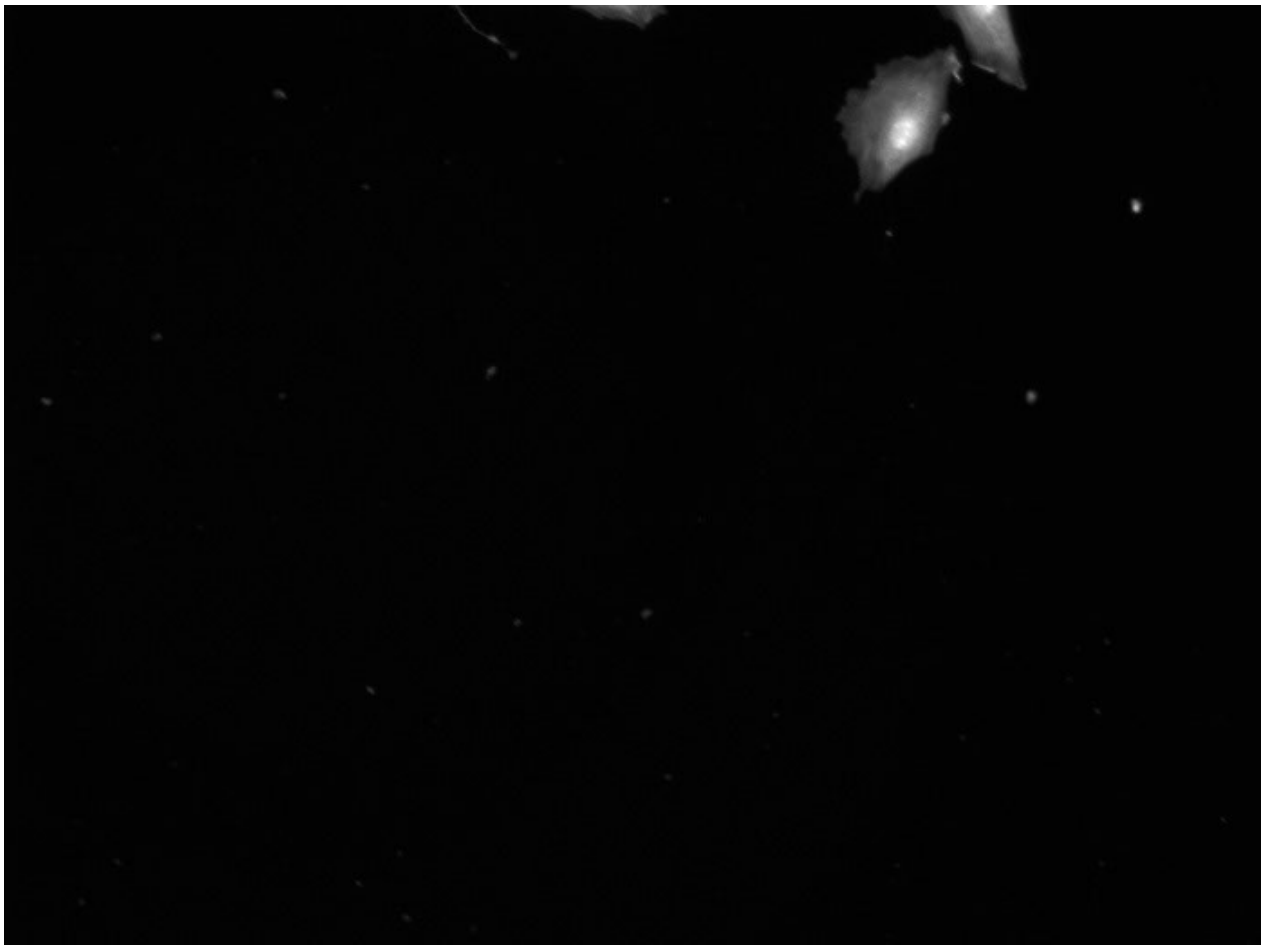

IWFCE_A10MedOptWell2_0023.png

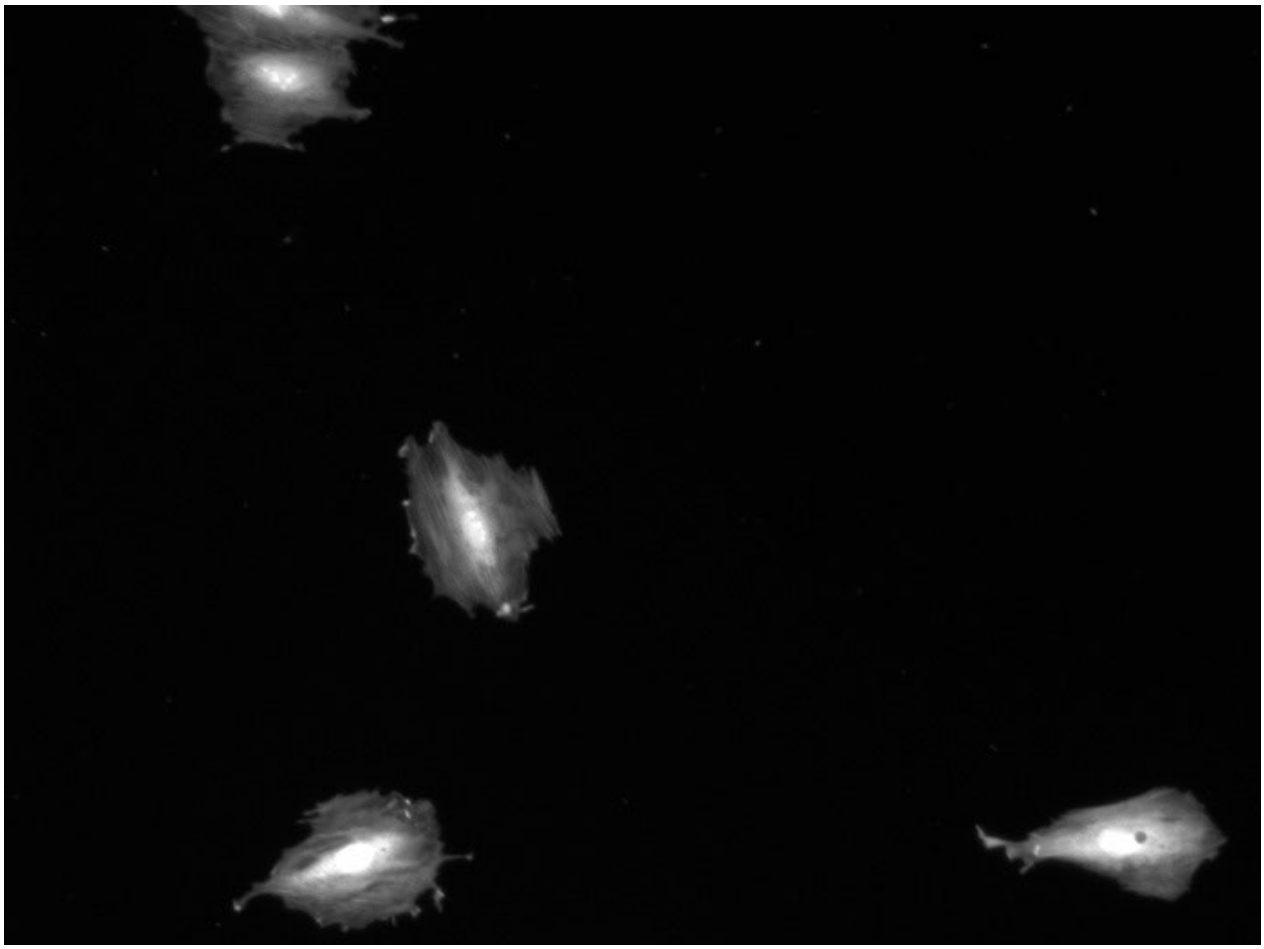

IWFCE_A10MedOptWell2_0024.png

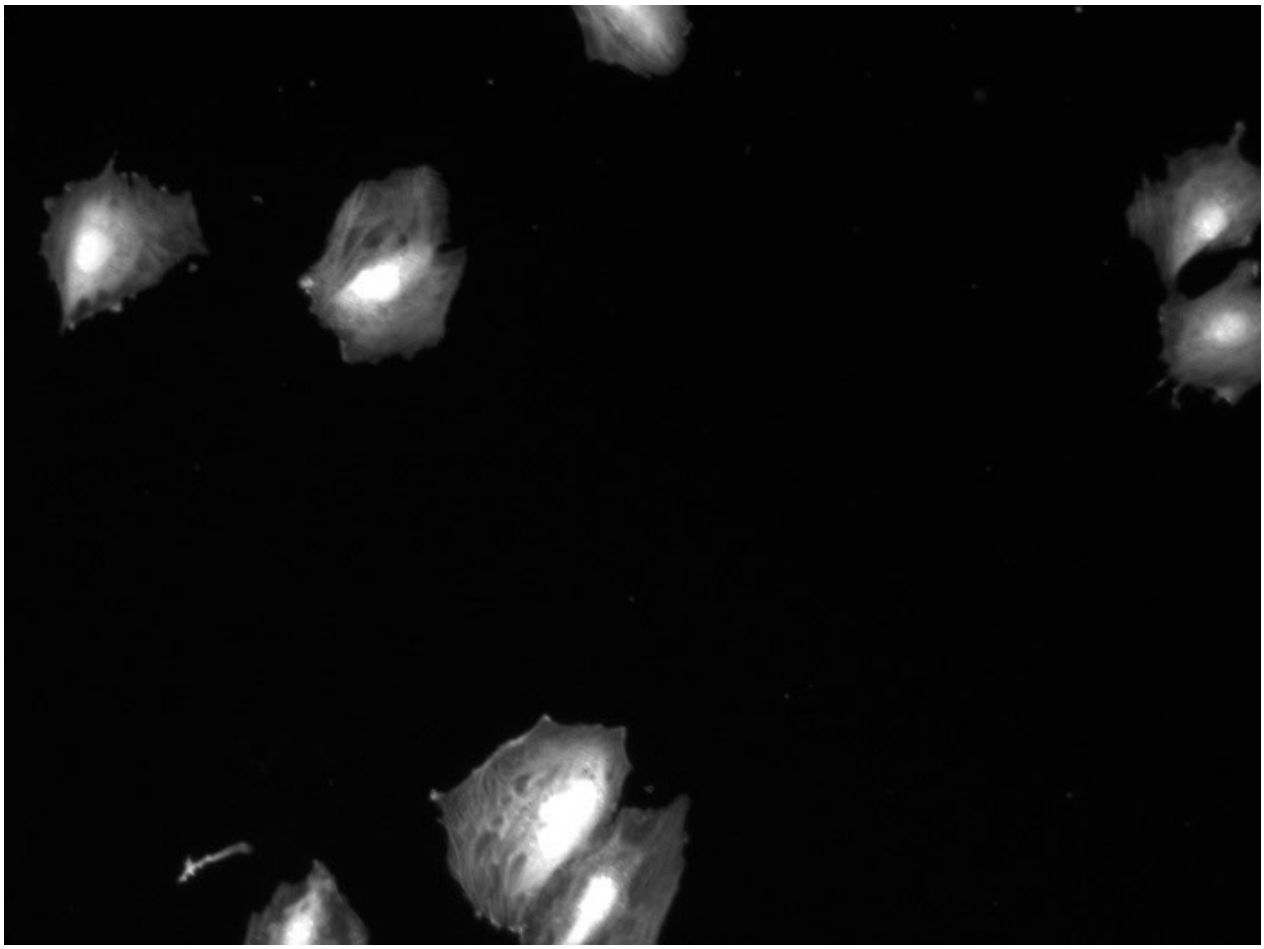

IWFCE_A10MedOptWell2_0025.png

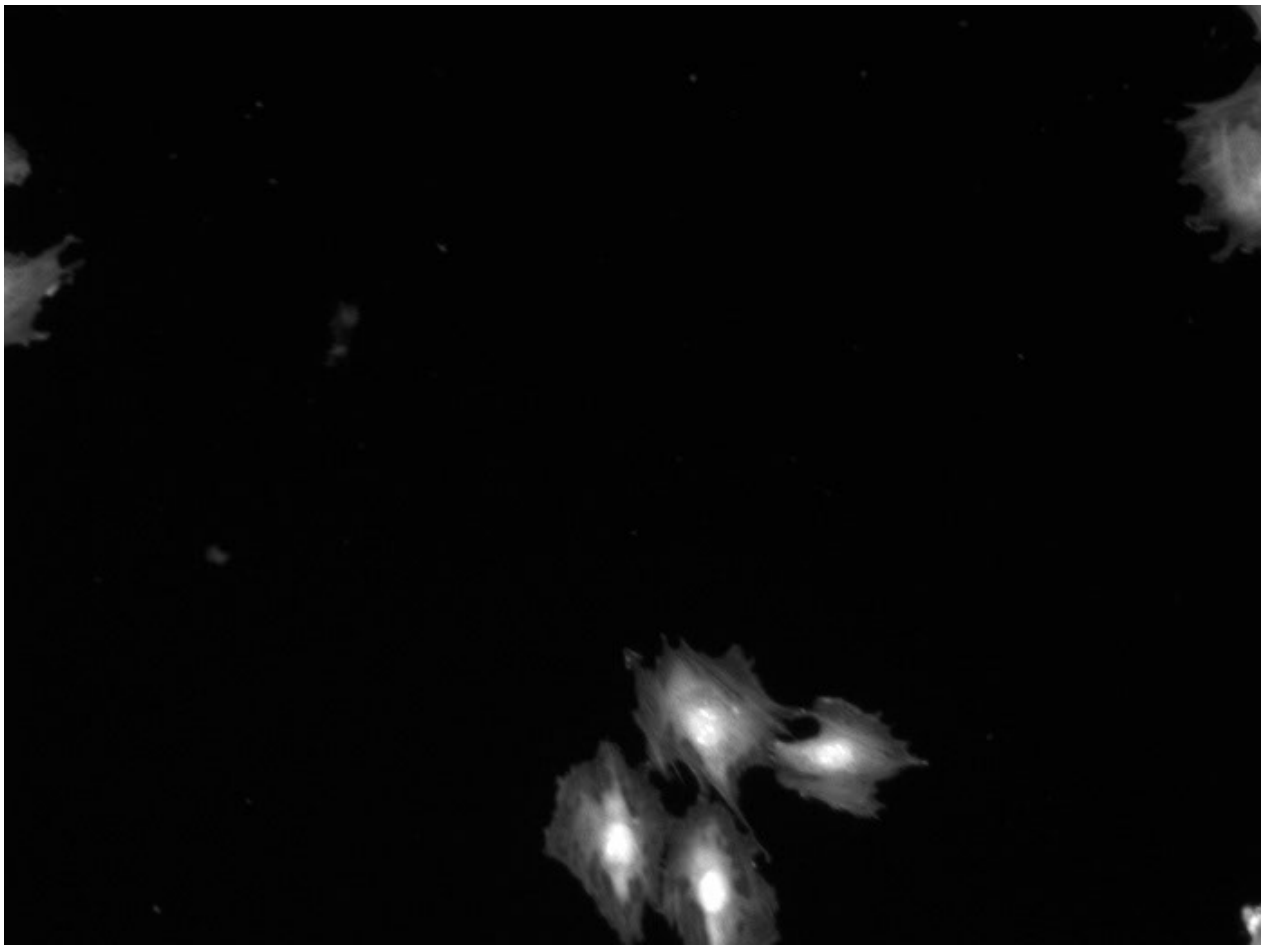

IWFCE_A10MedOptWell2_0026.png

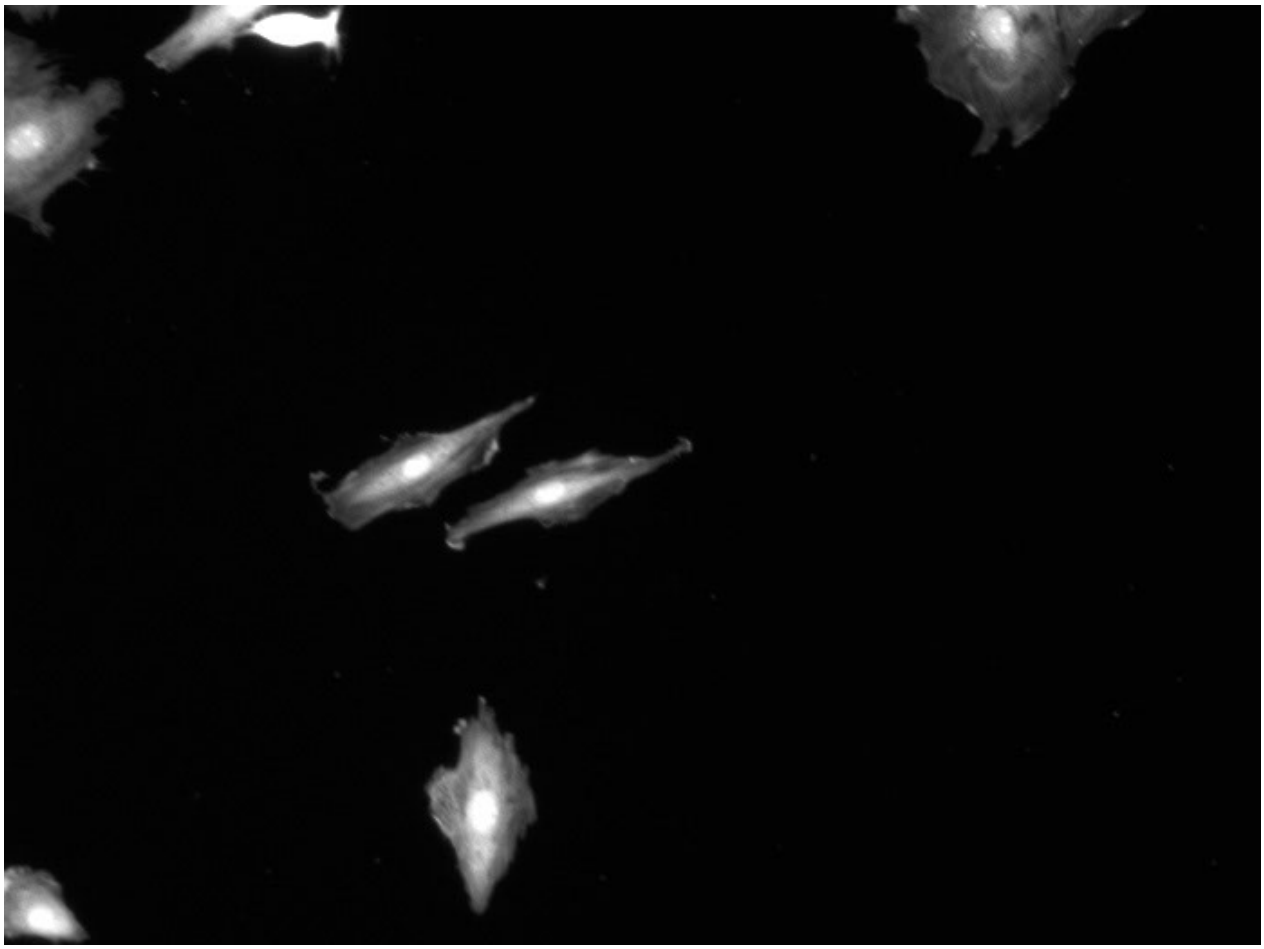

IWFCE_A10MedOptWell2_0027.png

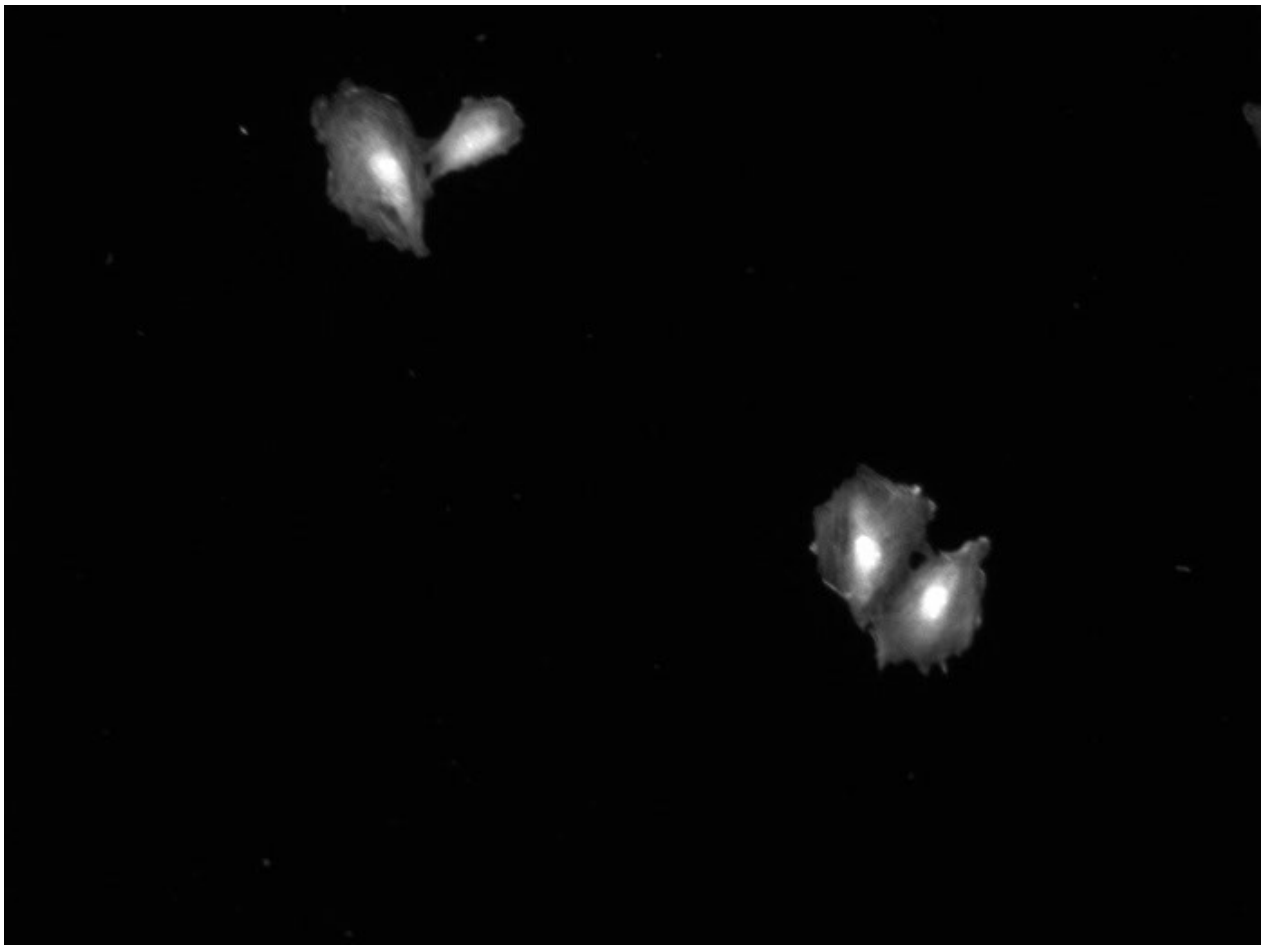

IWFCE_A10MedOptWell2_0028.png

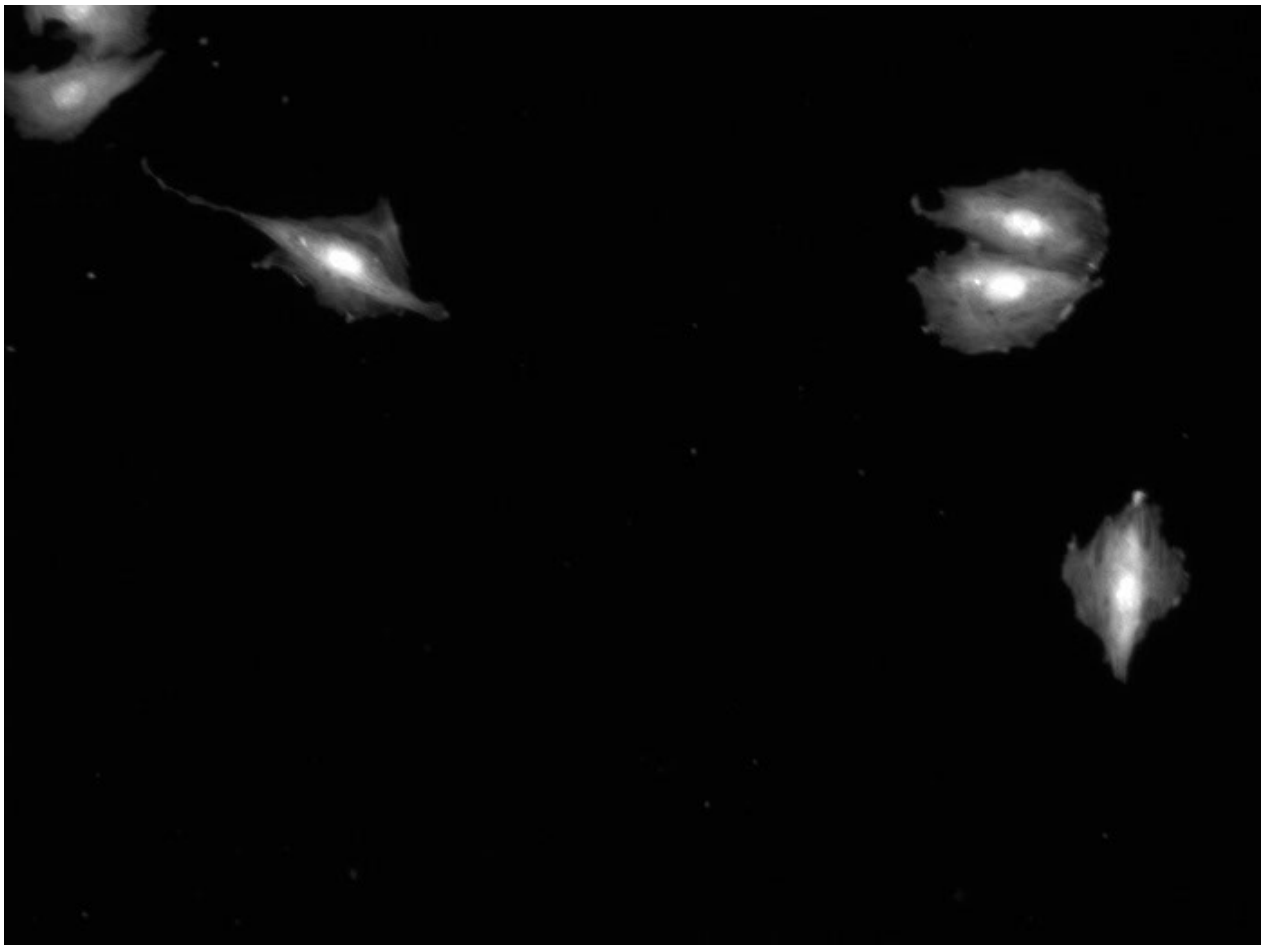

IWFCE_A10MedOptWell2_0029.png

IWFCE_A10MedOptWell2_0030.png

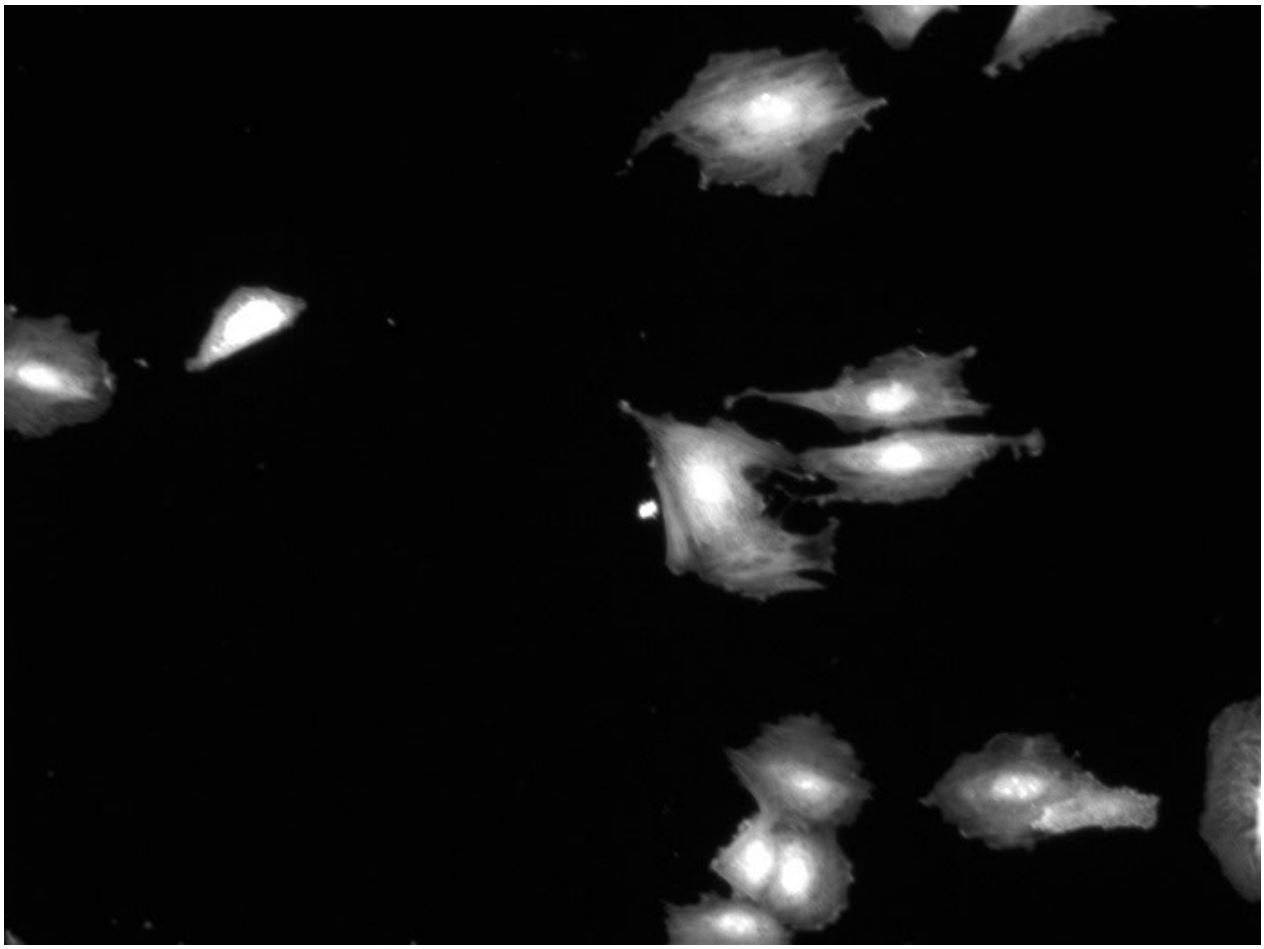

IWFCE_A10MedOptWell2_0031.png

IWFCE_A10MedOptWell2_0032.png

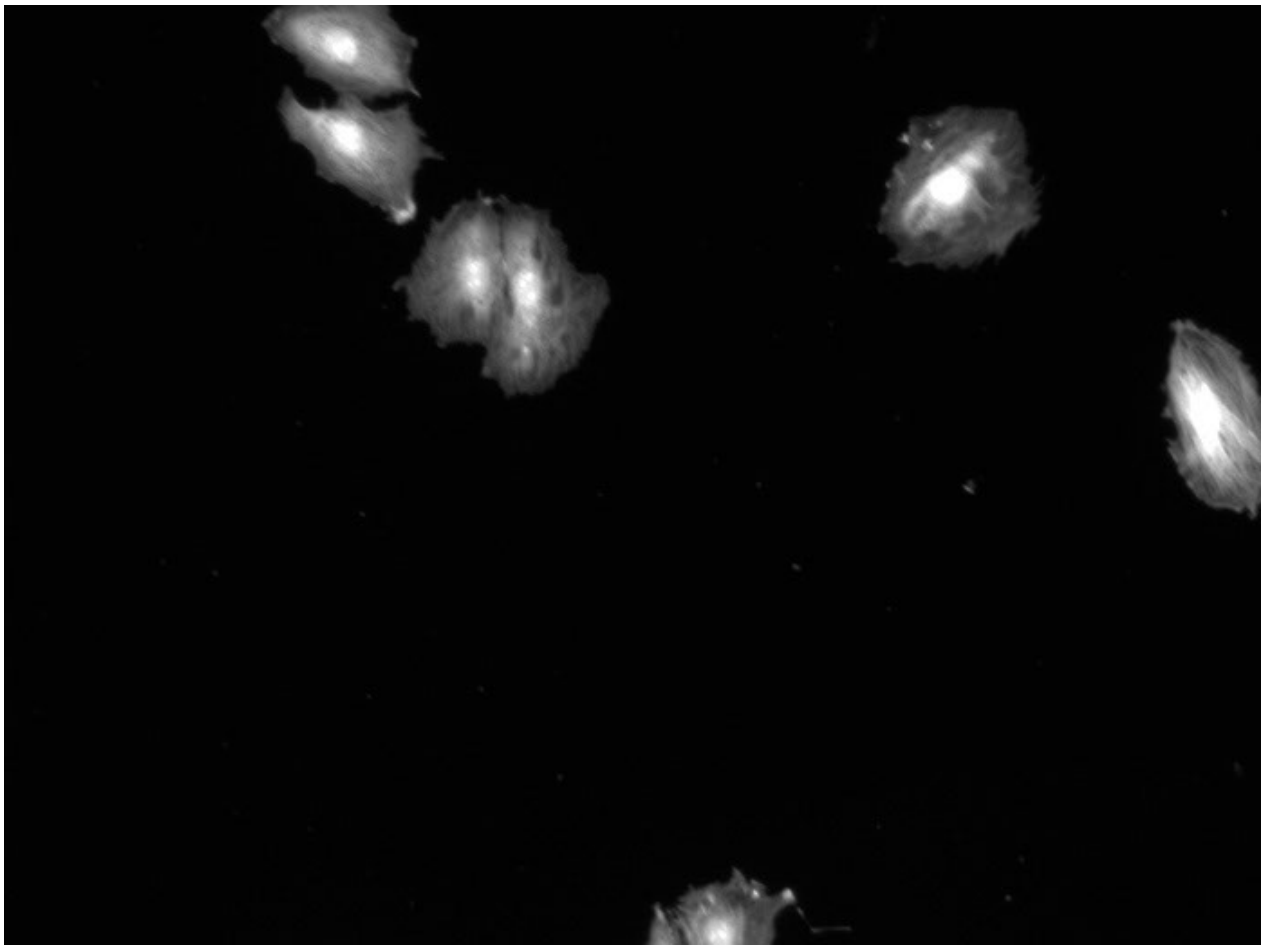

IWFCE_A10MedOptWell2_0033.png

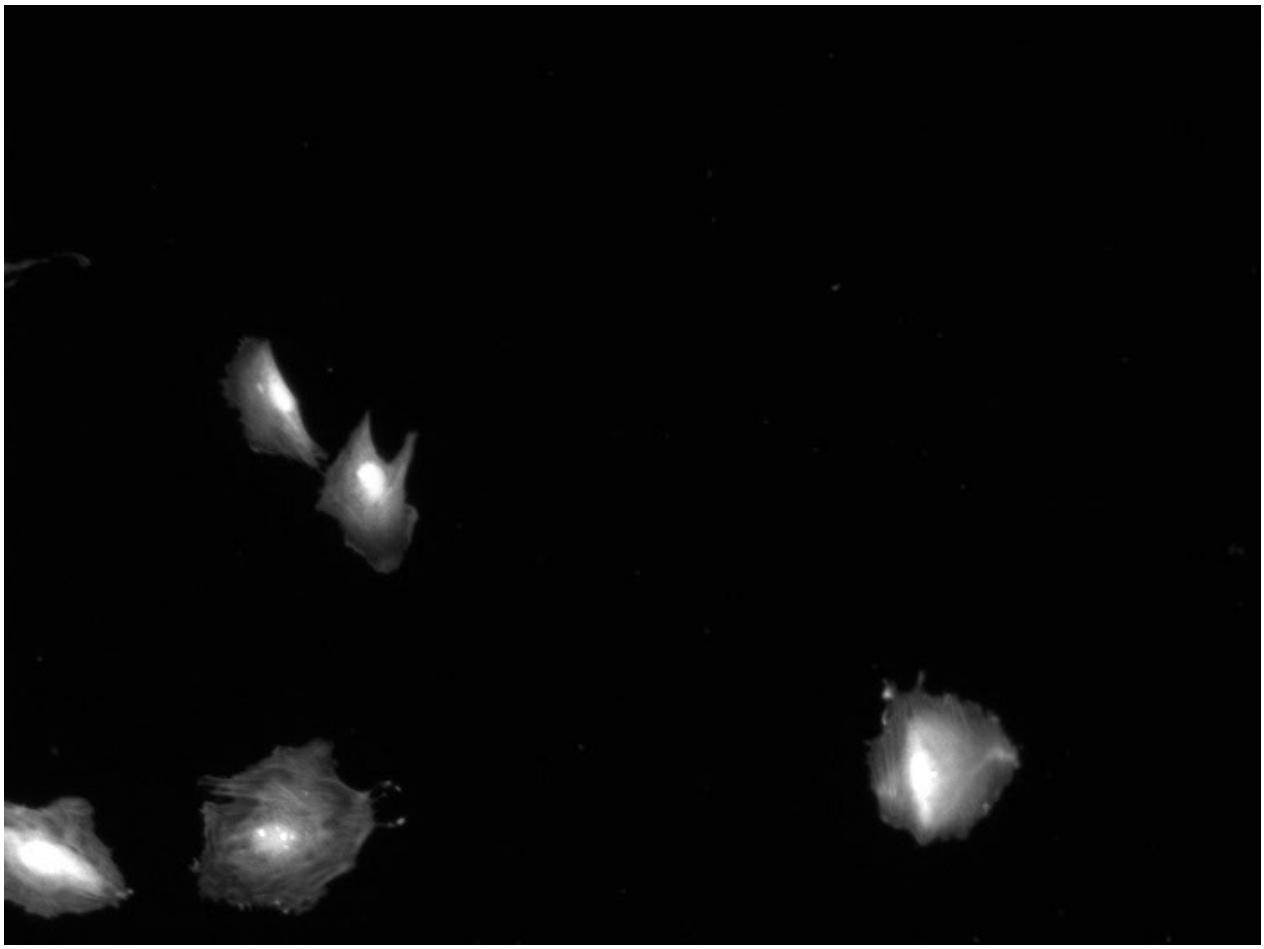

IWFCE_A10MedOptWell2_0034.png

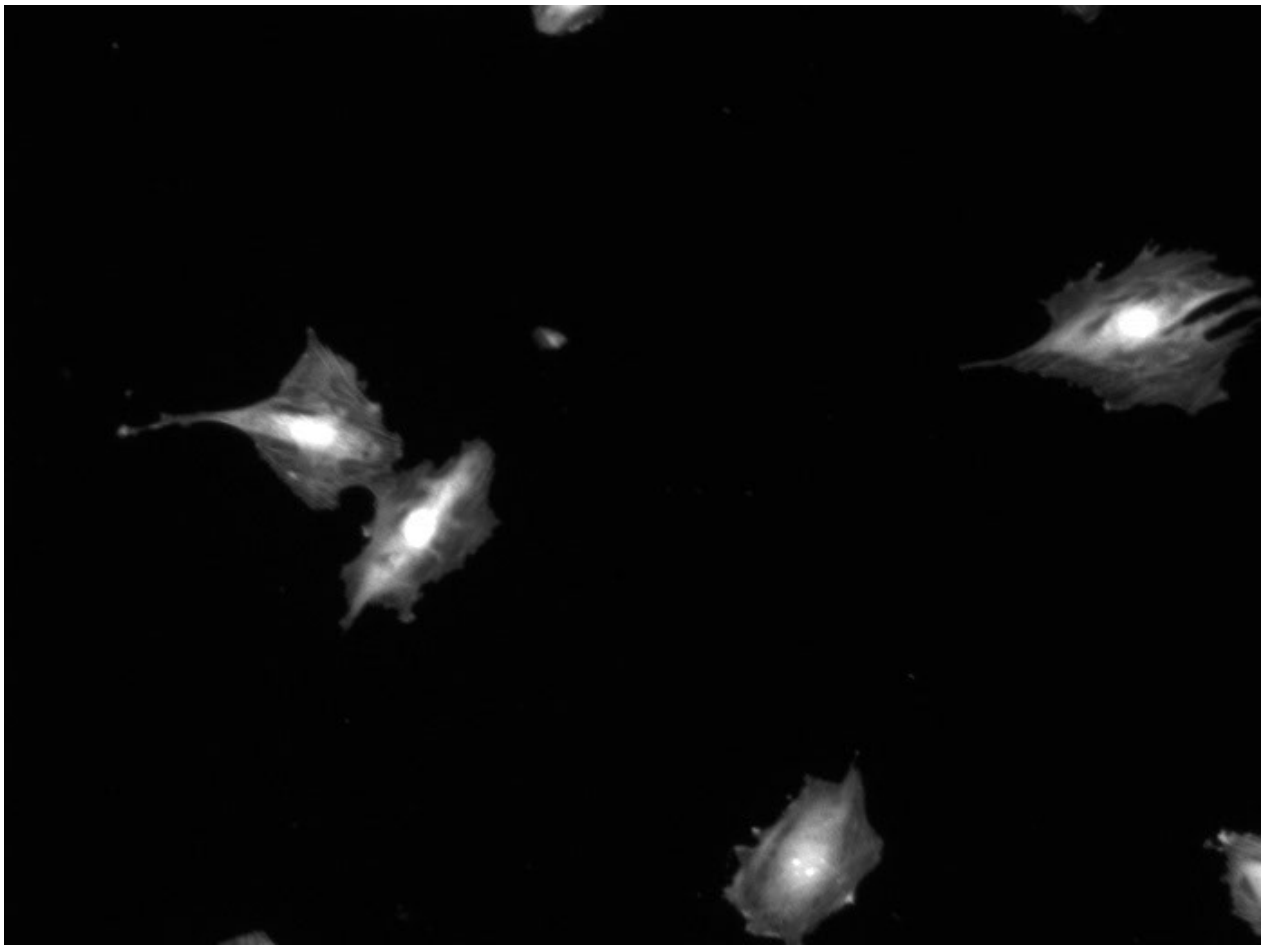

IWFCE_A10MedOptWell2_0035.png

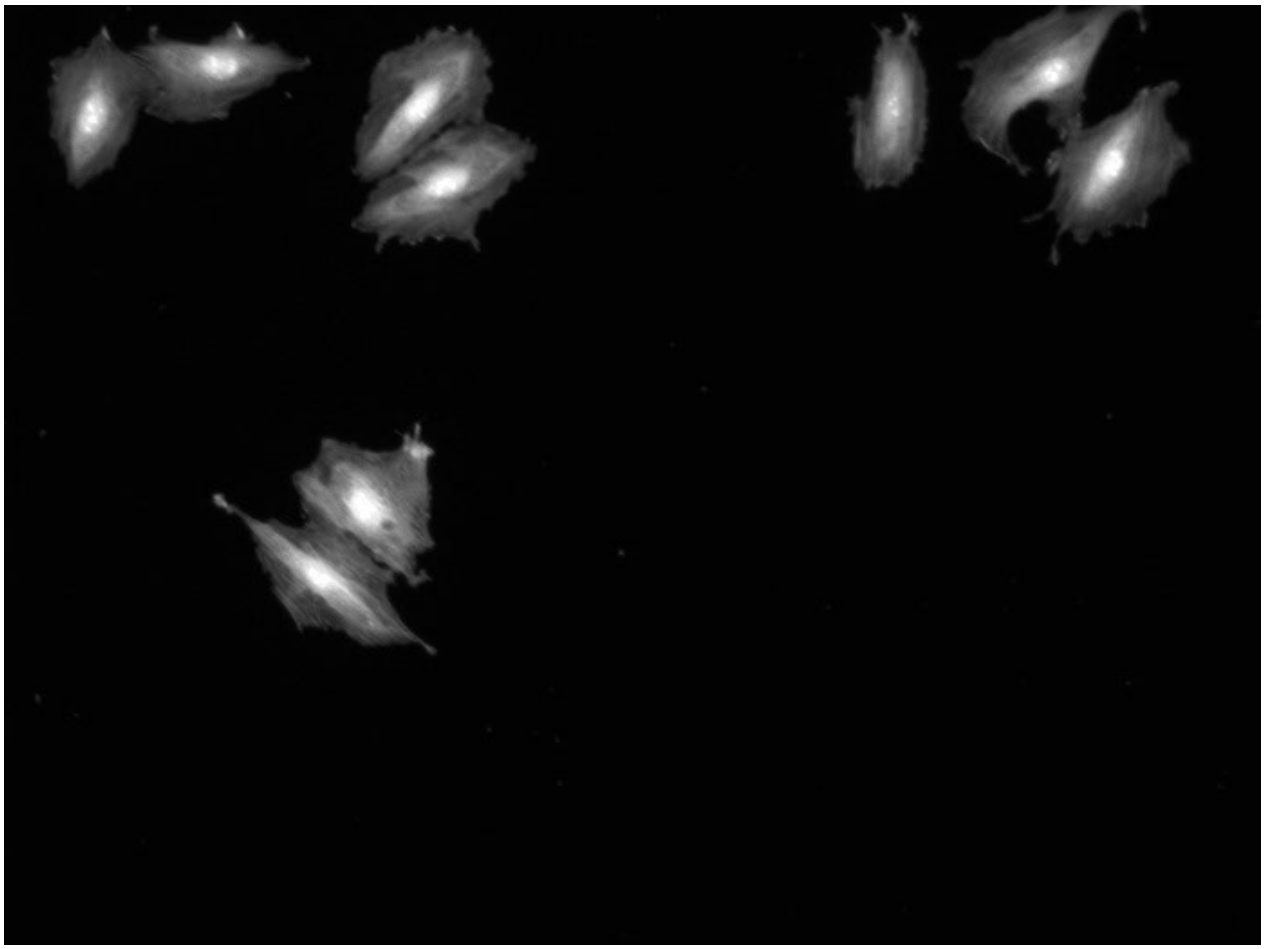

IWFCE_A10MedOptWell2_0036.png

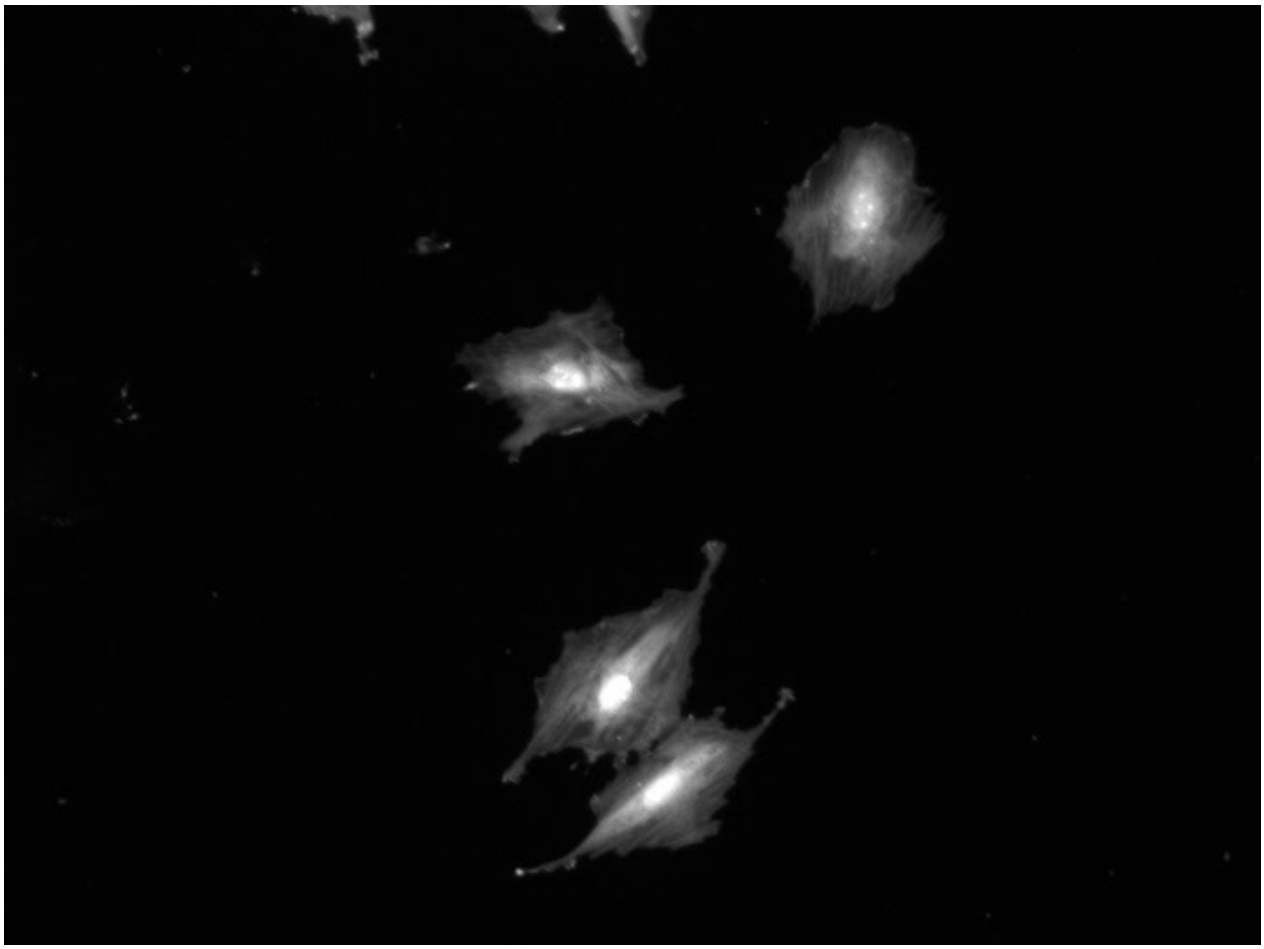

IWFCE_A10MedOptWell2_0037.png

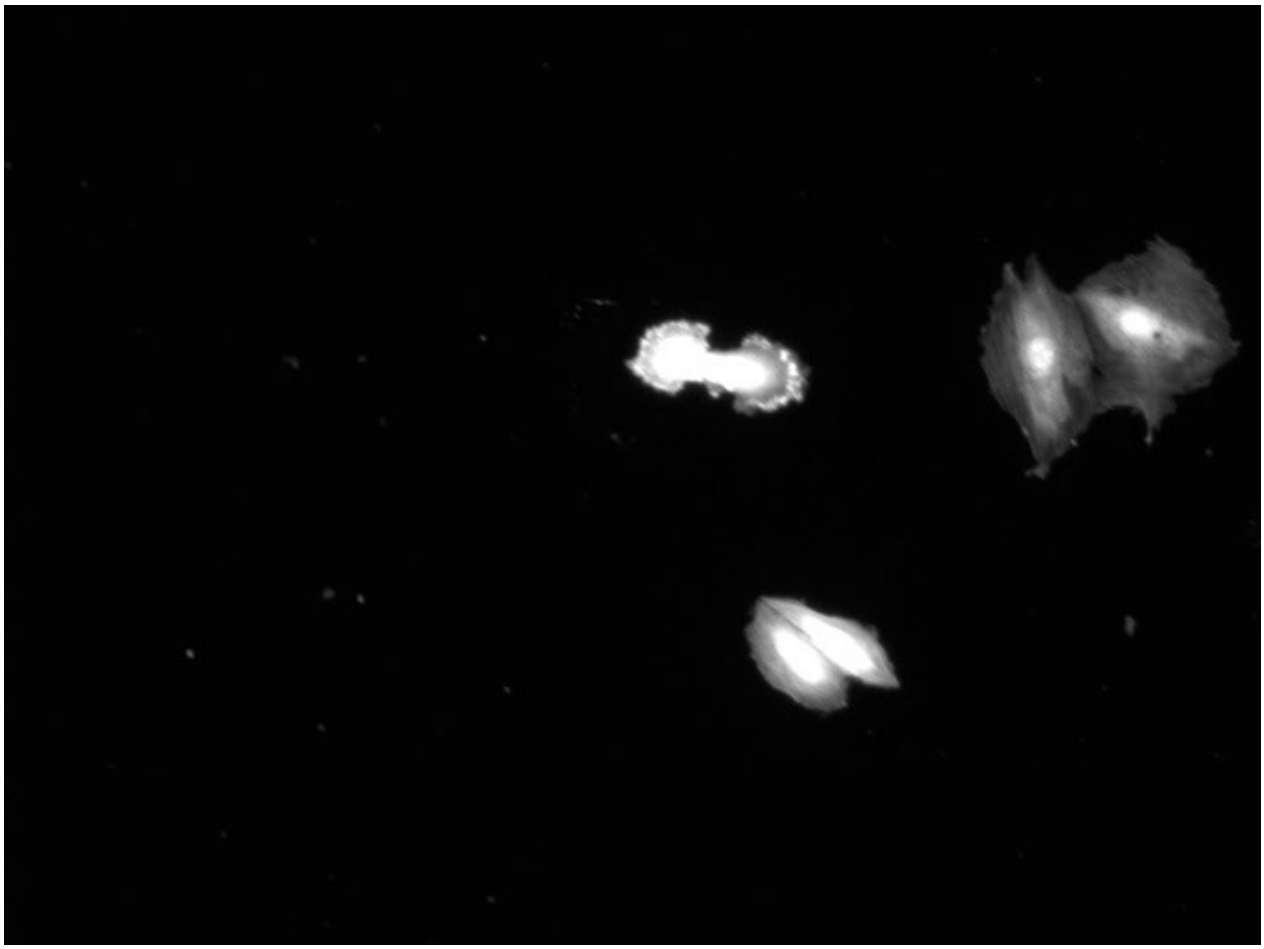

IWFCE_A10MedOptWell2_0038.png

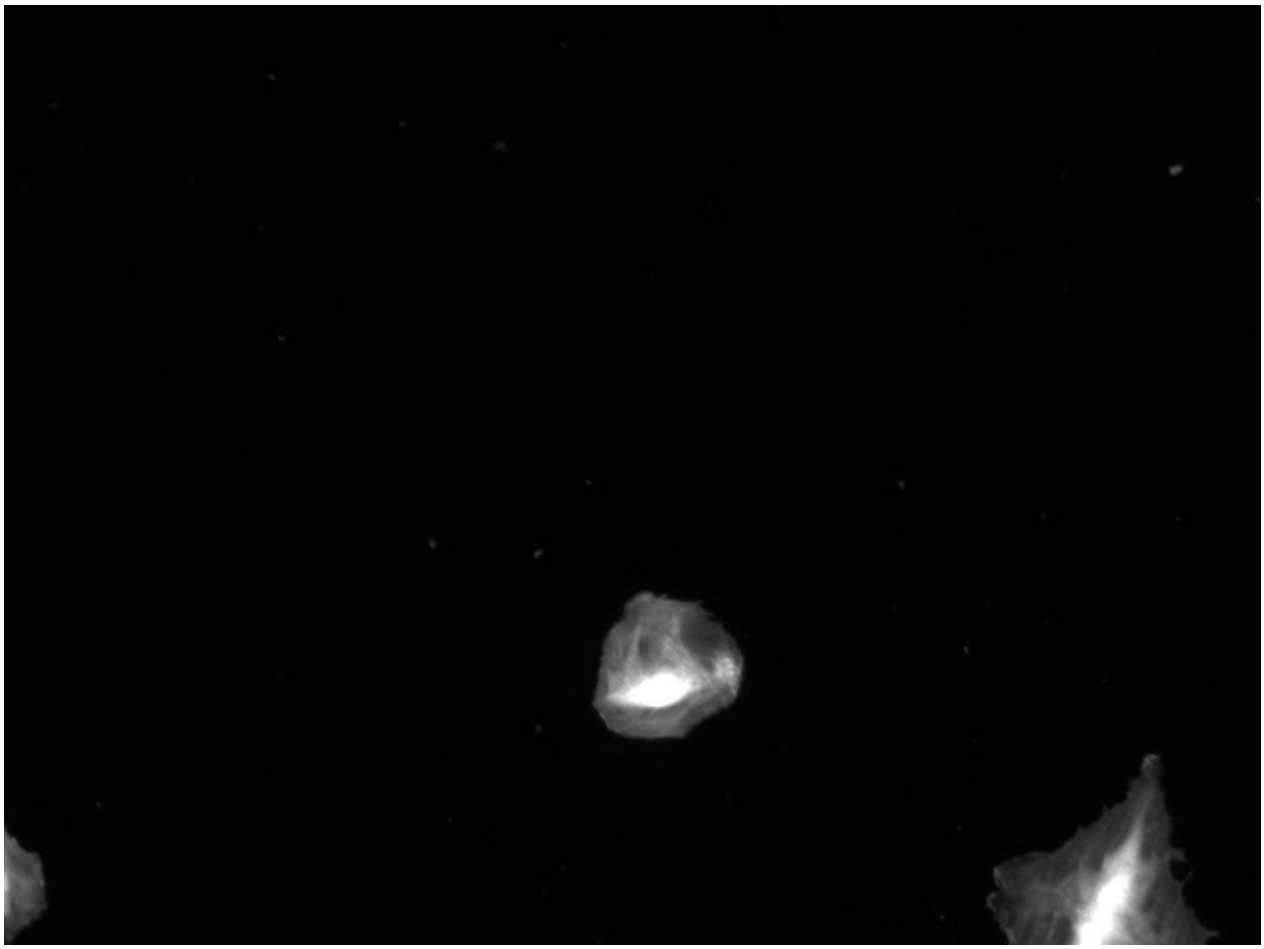

IWFCE_A10MedOptWell2_0039.png

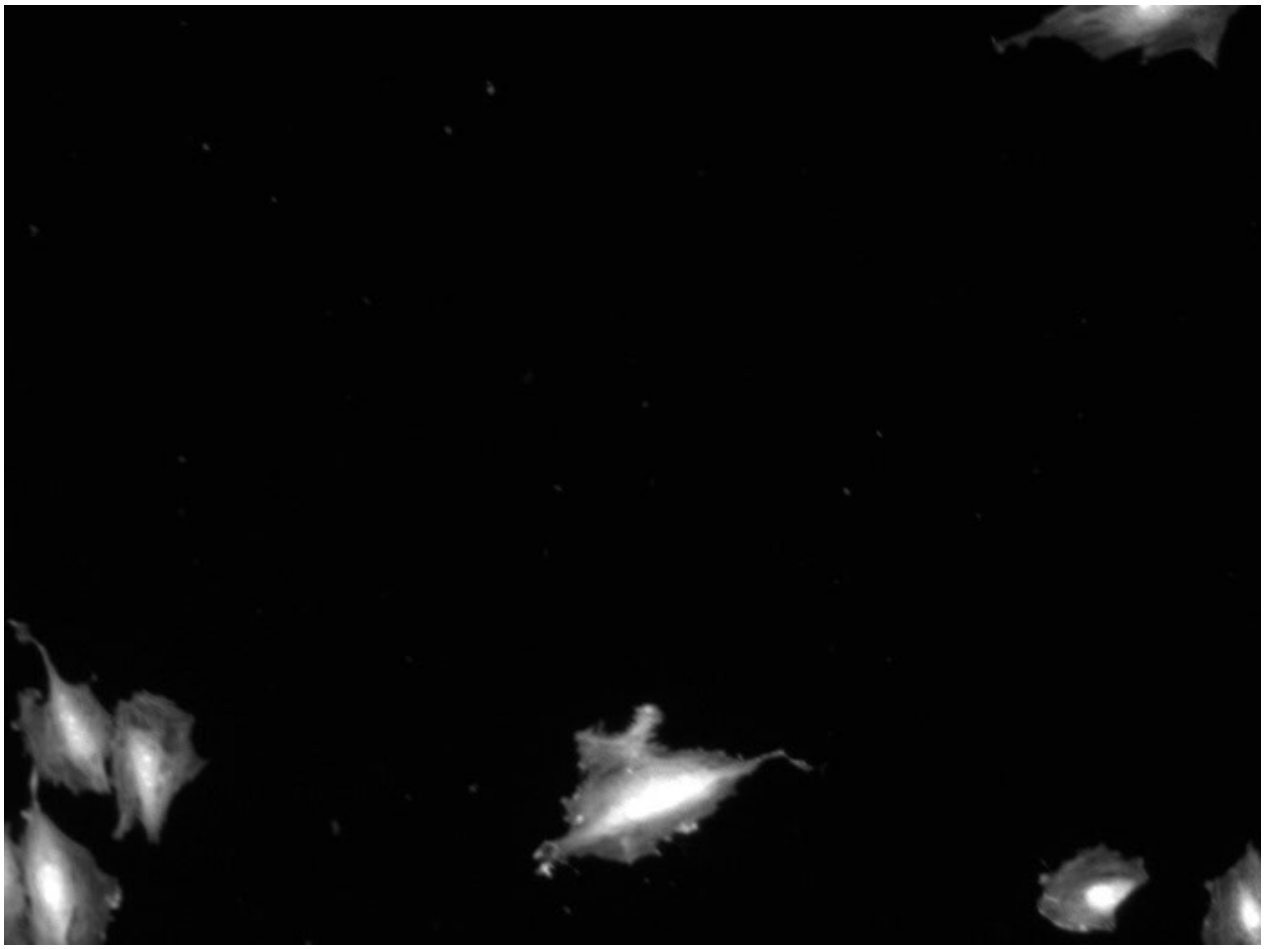

IWFCE_A10MedOptWell2_0040.png

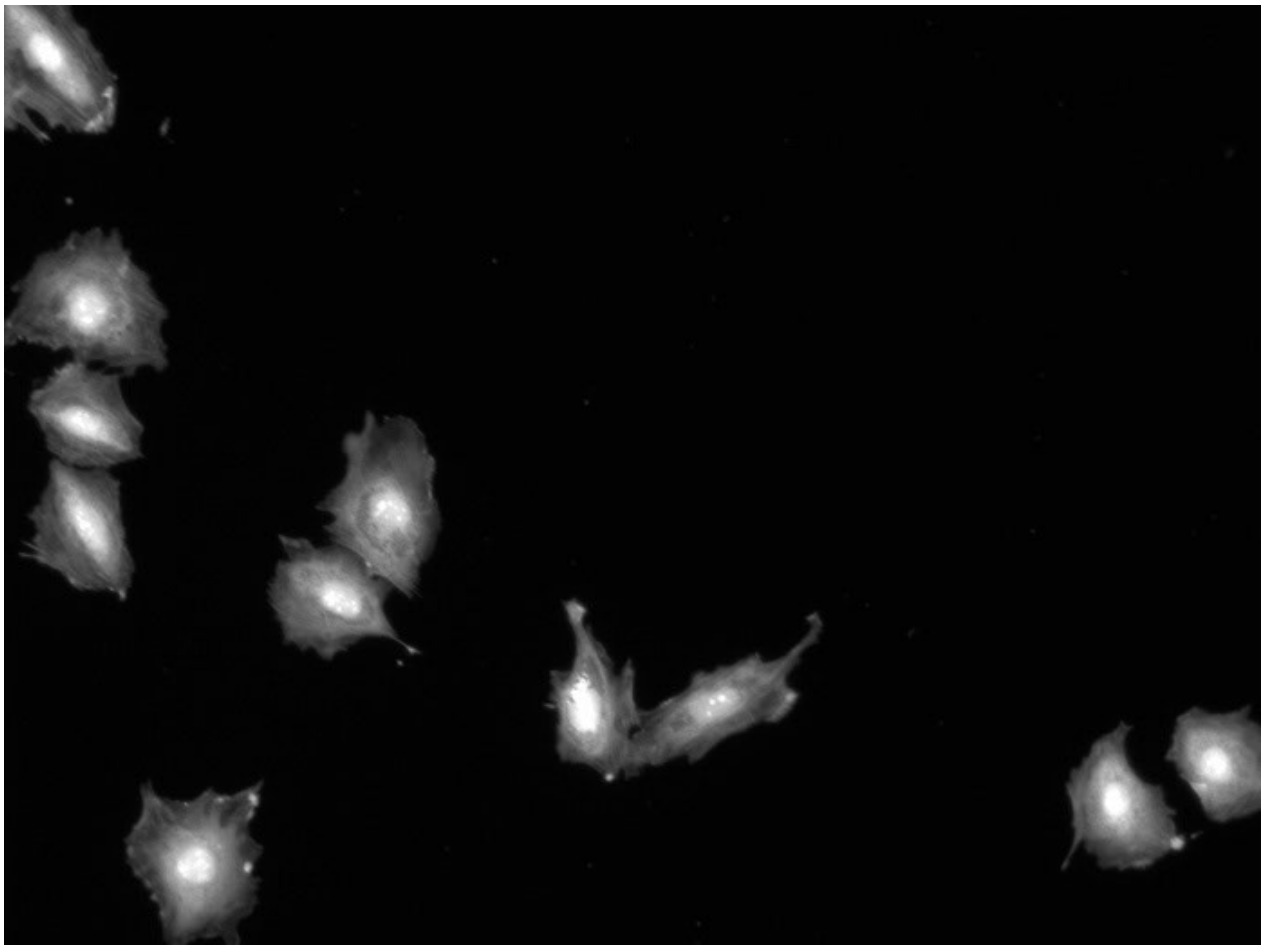

IWFCE_A10MedOptWell2_0041.png

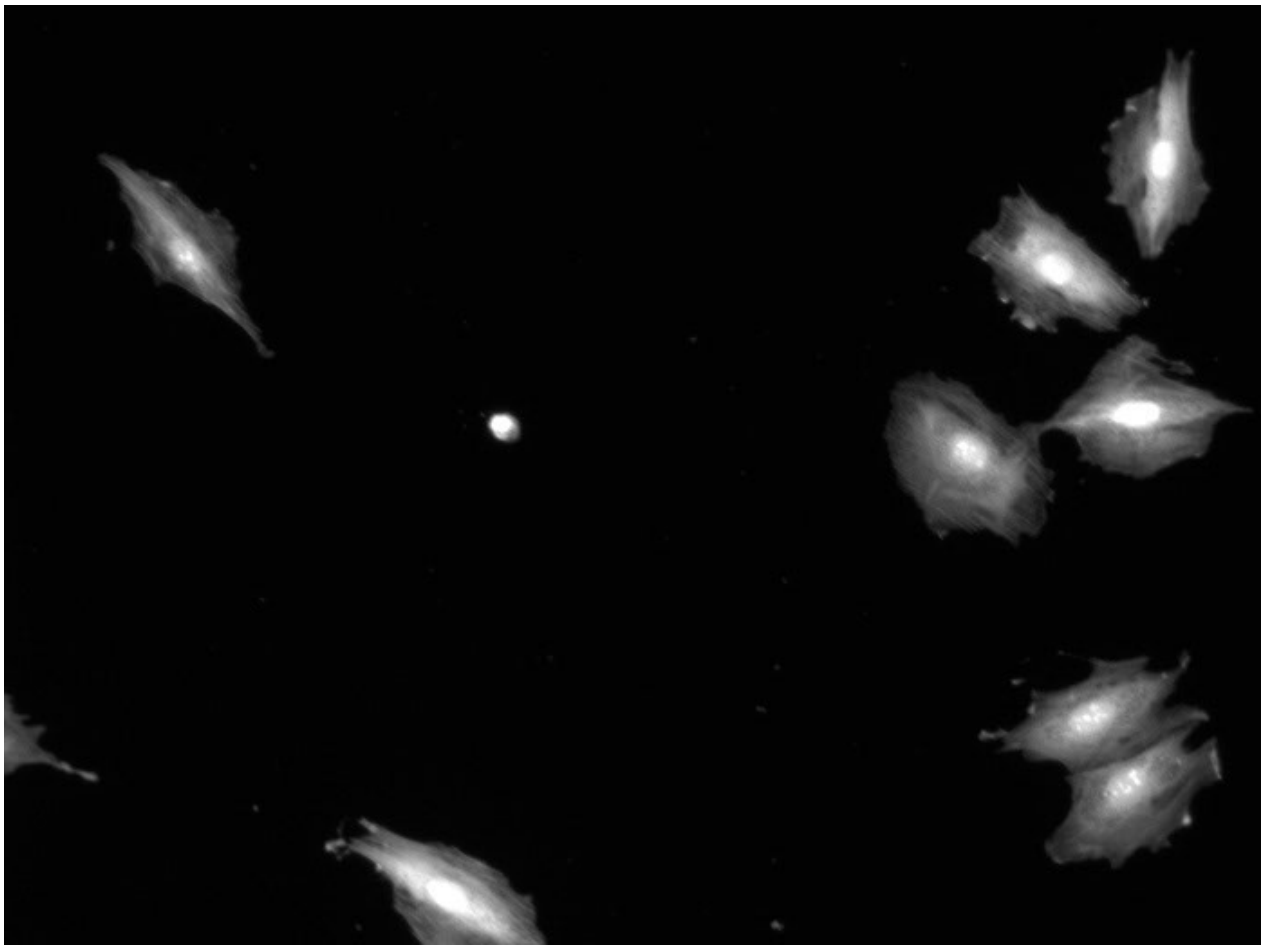

IWFCE_A10MedOptWell2_0042.png

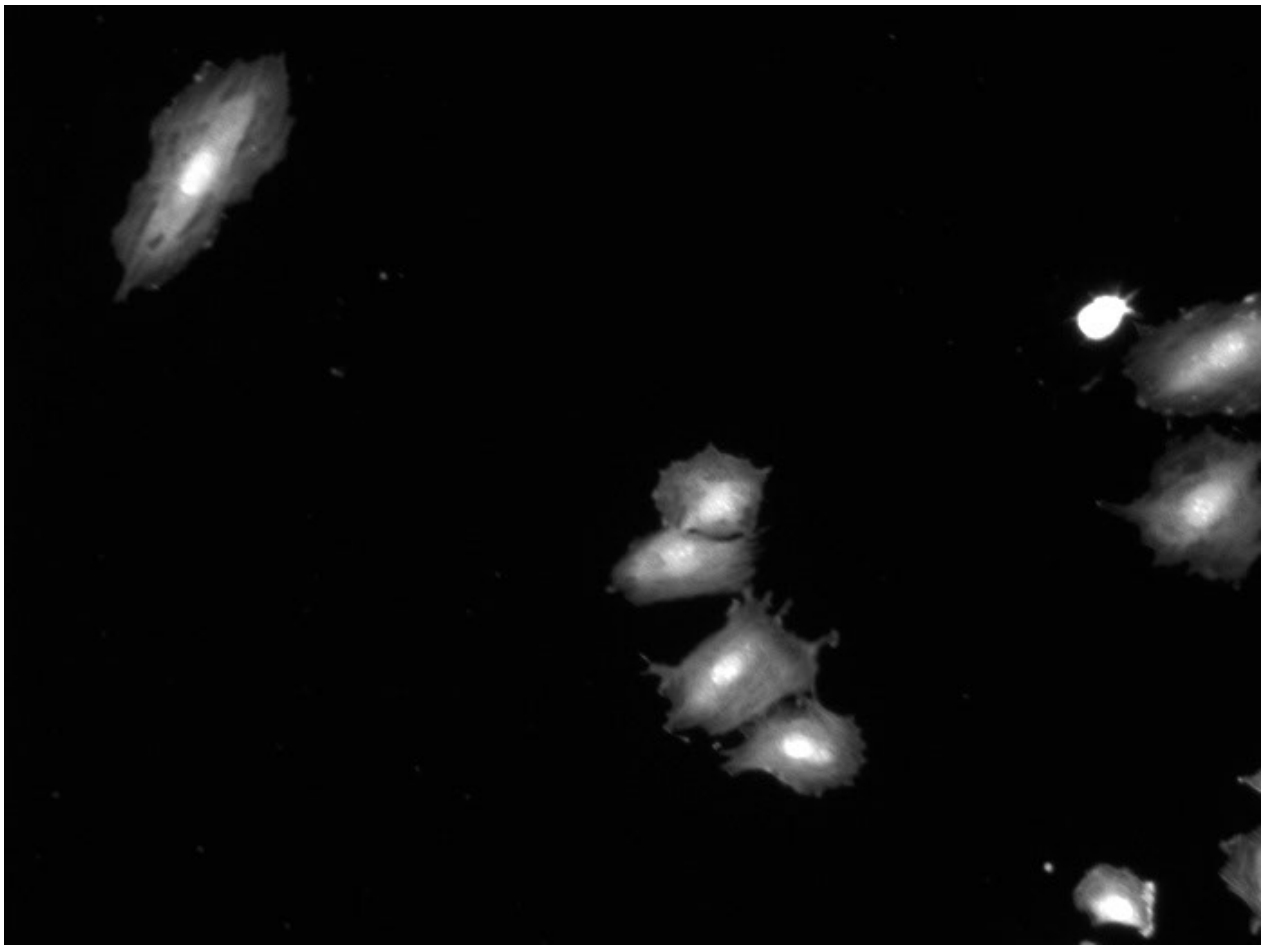

IWFCE_A10MedOptWell2_0043.png

IWFCE_A10MedOptWell2_0044.png

IWFCE_A10MedOptWell2_0045.png

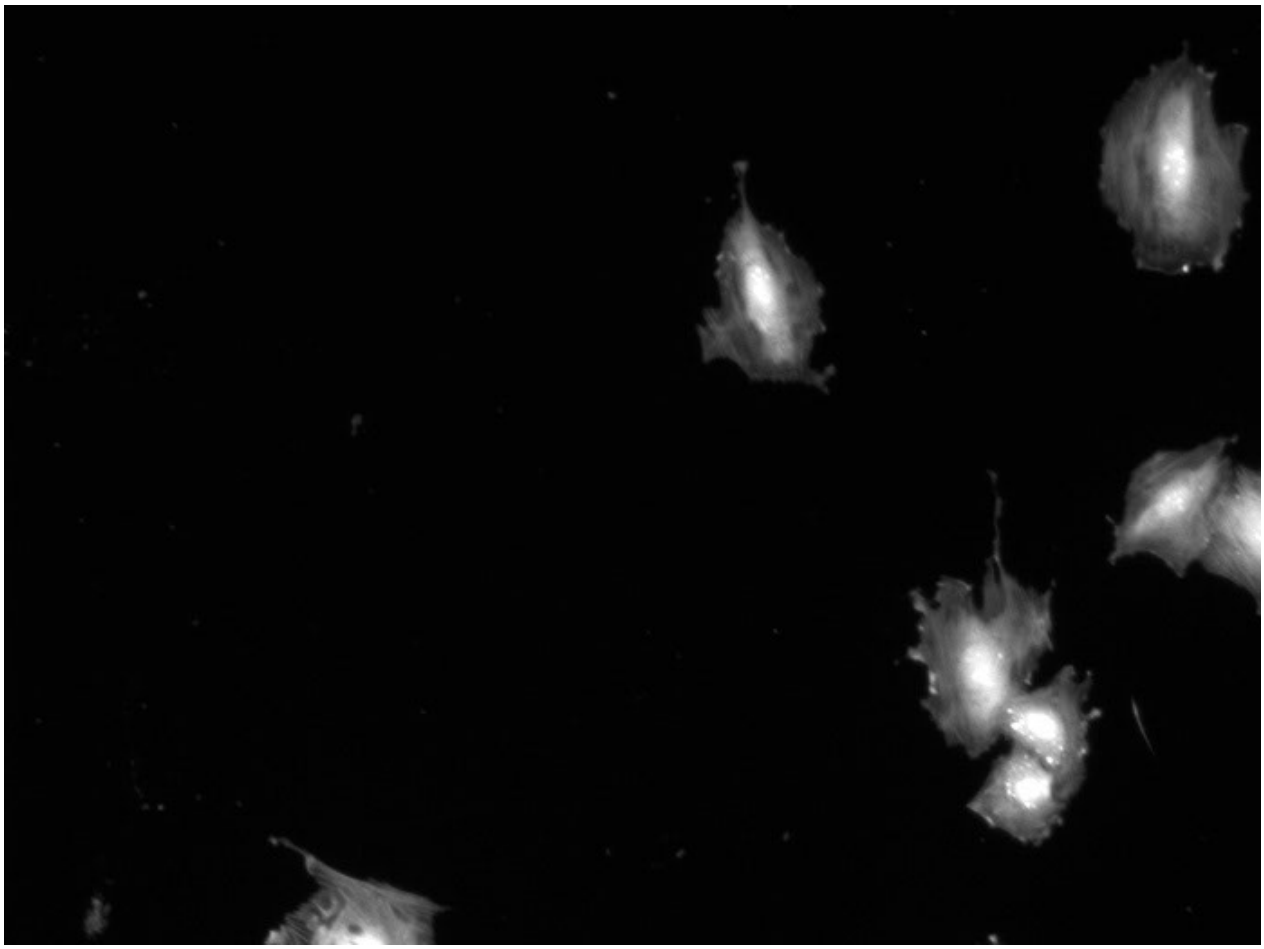

IWFCE_A10MedOptWell2_0046.png

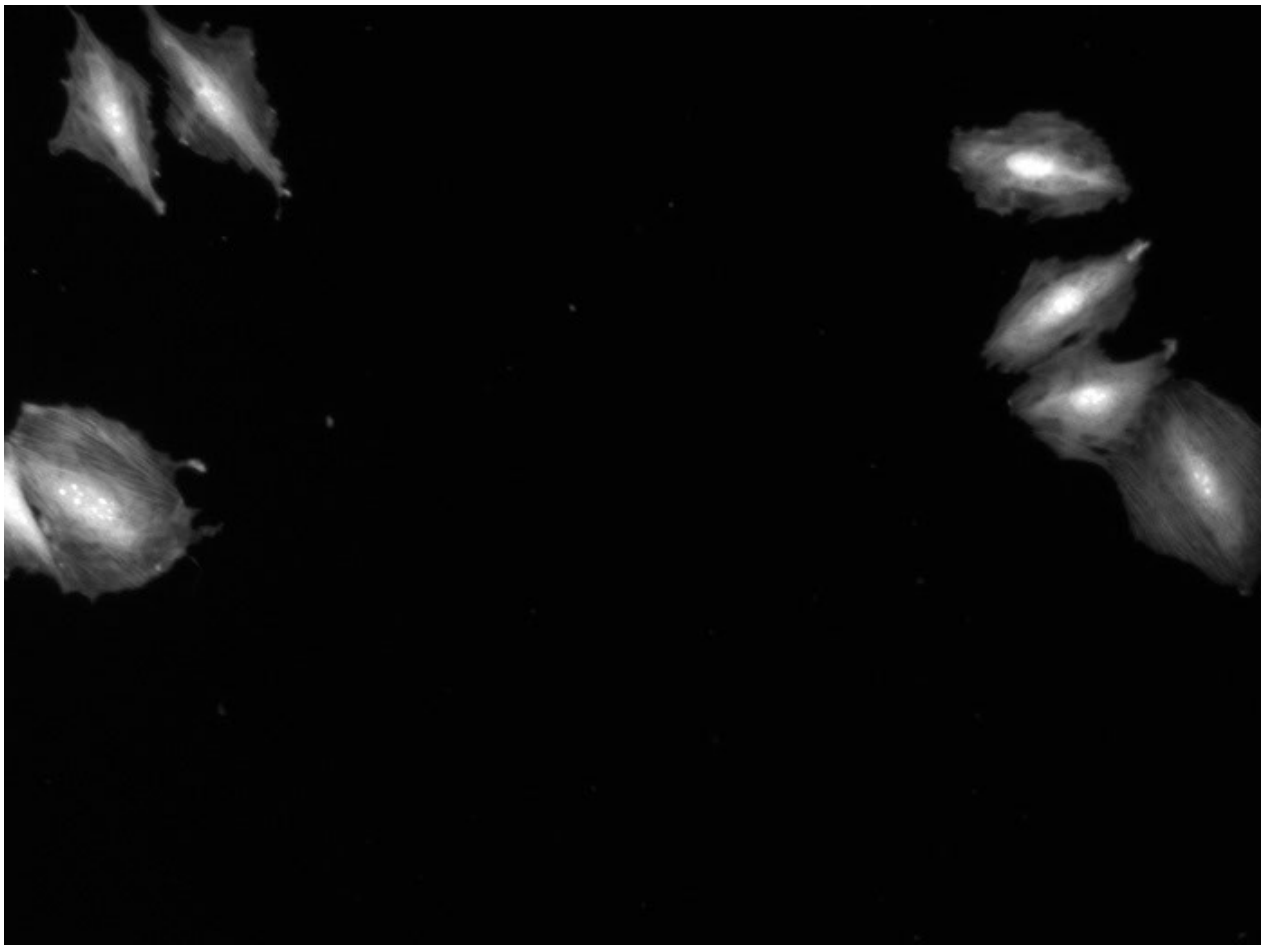

IWFCE_A10MedOptWell2_0047.png

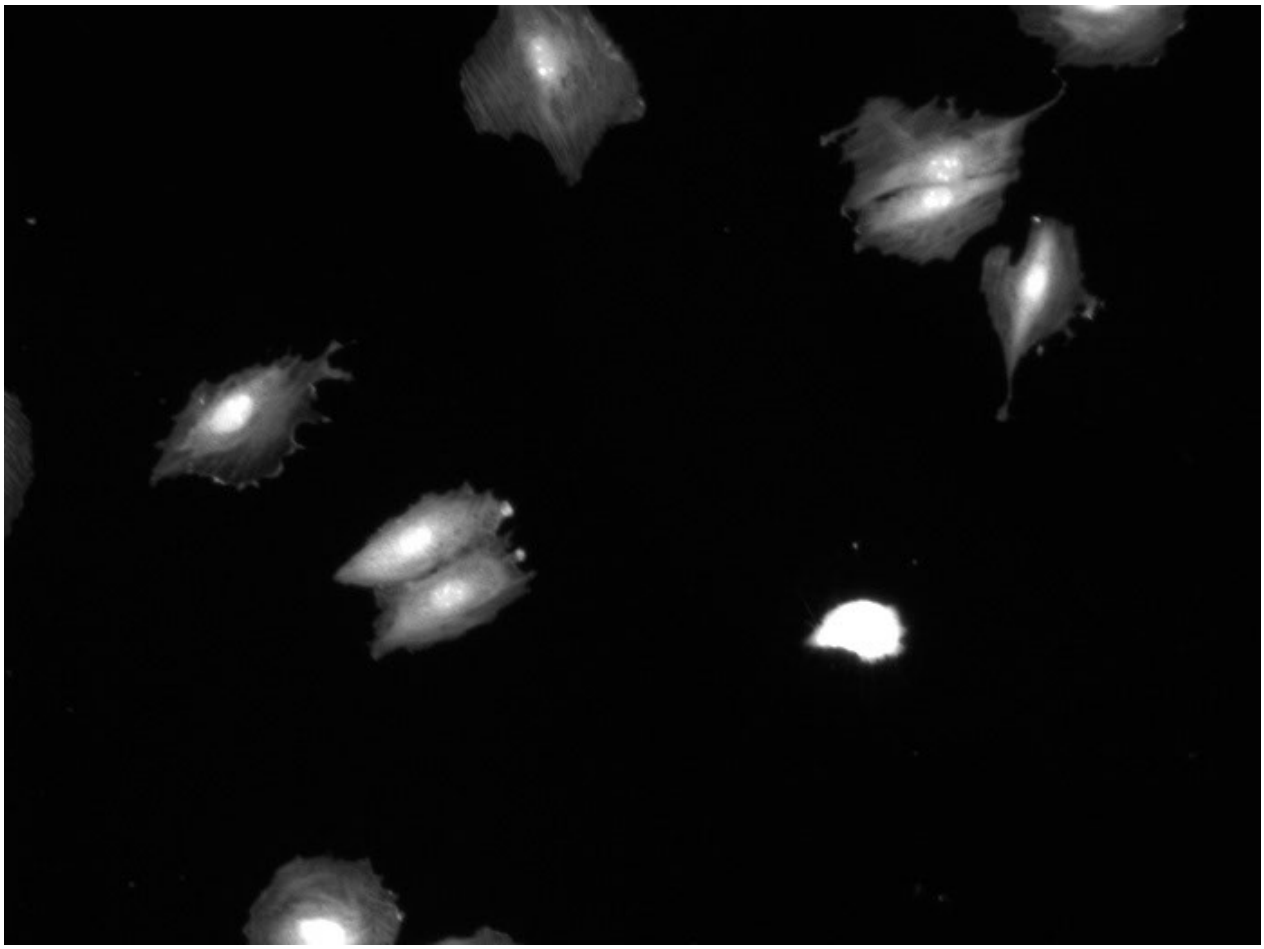

IWFCE_A10MedOptWell2_0048.png

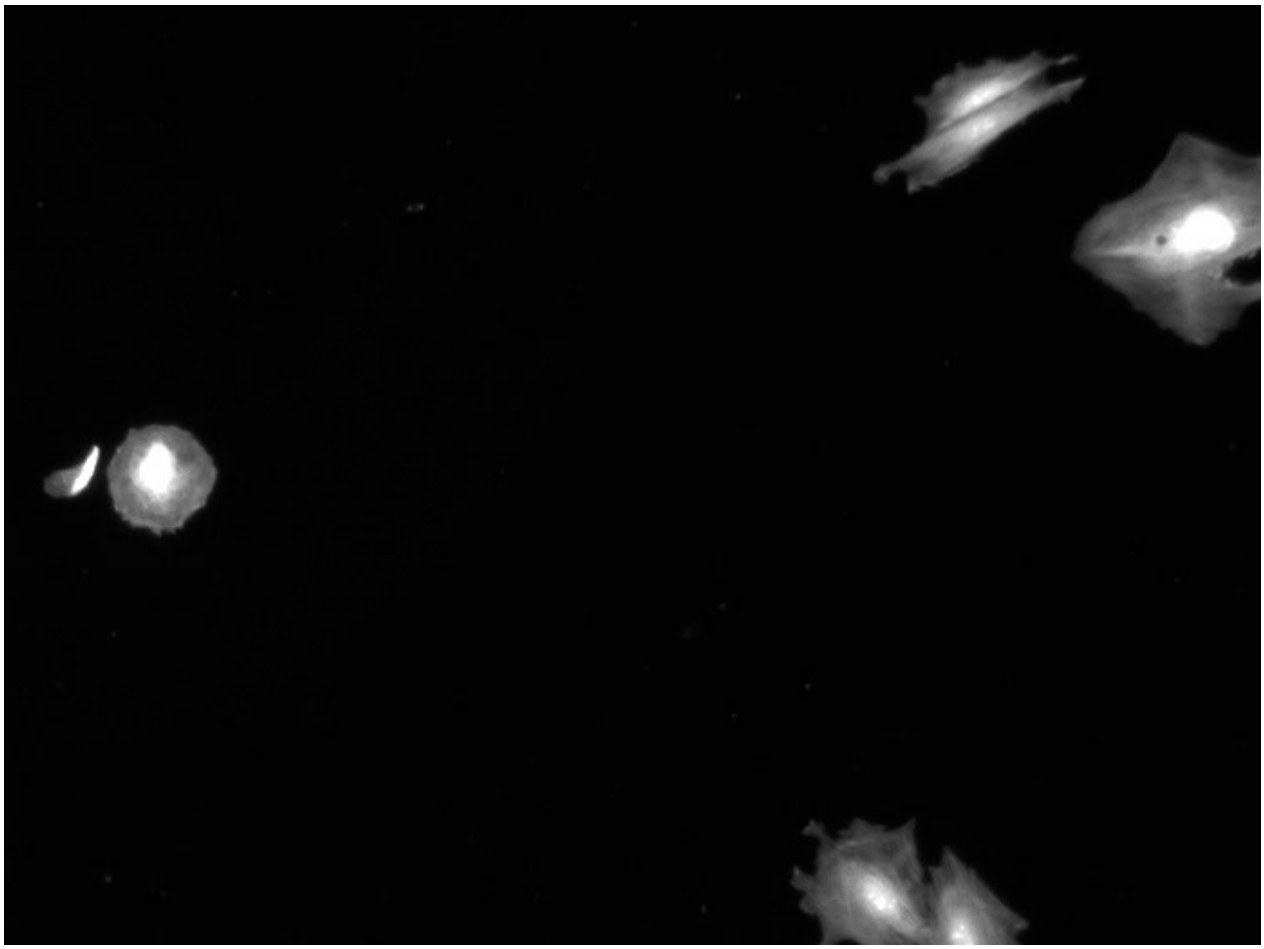

IWFCE_A10MedOptWell2_0049.png

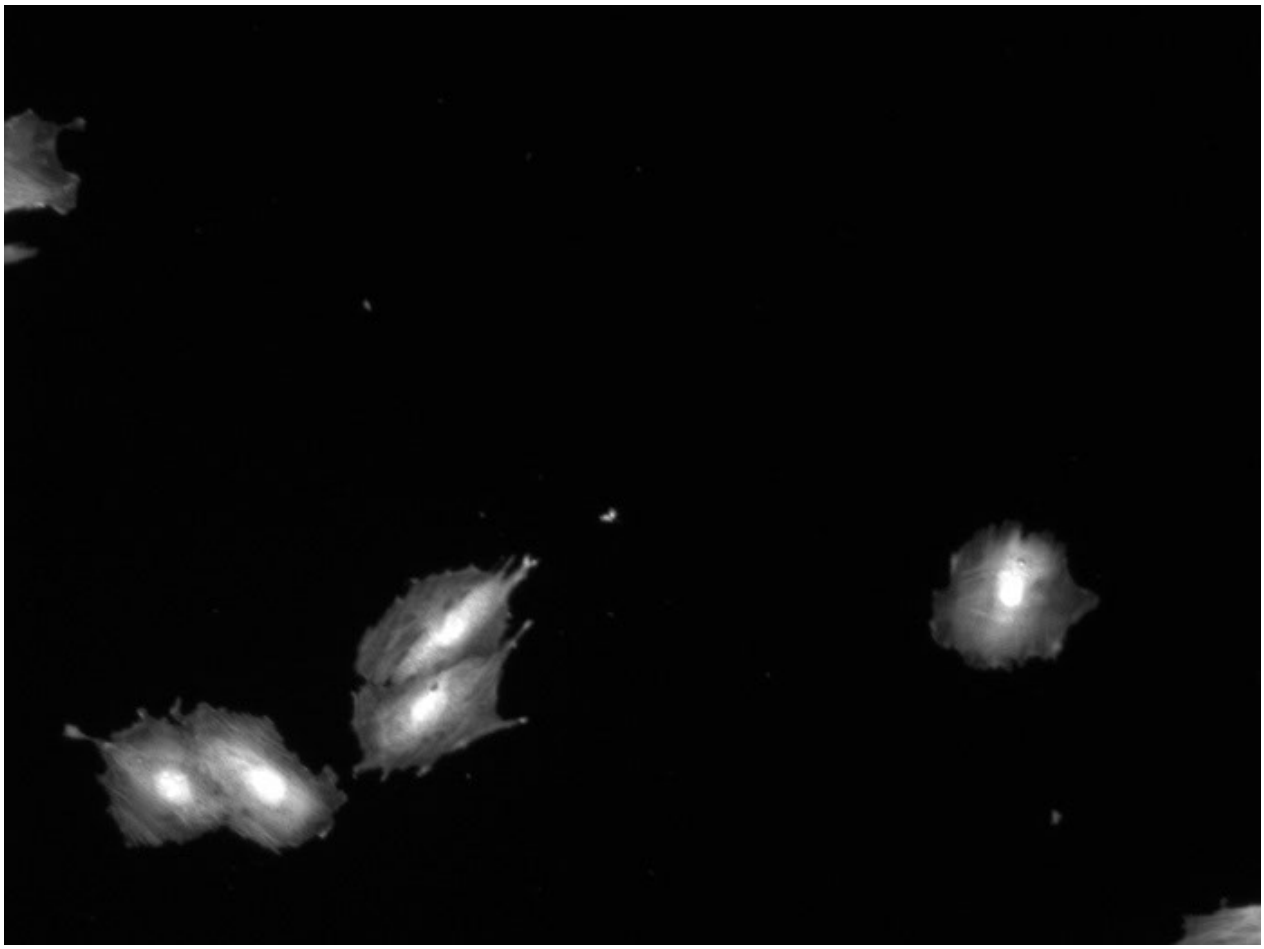

IWFCE_A10MedOptWell2_0050.png